

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° W19-547583

165865

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e) Matricule : 2069 Société : RAM

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre : RETRAITE

Nom & Prénom : Mr. SOUMMANE ABDESSADEQ

Date de naissance : 01-01-1949

Adresse : Habitude

Tél : 0766 60 67 89

Consultation 300 + Pharmacie 1557 + Parapharmacie Total des frais engagés : 2000 - TOTAL : 3947,00 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Ghita MAMOU
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie Maladies Métaboliques
Nutrition
Espace Reudani 230 Bd. Reudani 4ème Etage N° 19
Casablanca - Tél. : 05 22 23 70 71

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : SOUMMANE Abdesadeq Age : / /

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Affection endocrinienne

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca

Signature de l'adhérent(e) : Le : 17 / Mai / 2023

NB: formulaire de "Maladie longue durée" déjà déposé au près de Mupras.

والله اعلم

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17/05/2023	Spécialiste en Diabétologie Métabolique	1	11800 DH	INP : 1091027117

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
--	------	-----------------------

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
---	------	------------------------------	------------------------

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
	17/05/23					20800 DH

sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Ain Sebaâ Casablanca
Lantus Solostar 100U/ml inj B5
P.P.V. : 744DH00




Le praticien
Important :
Veuillez joindre les radiographies

SOINS DENTAIRES

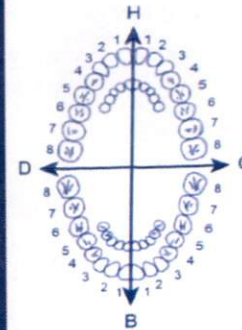

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

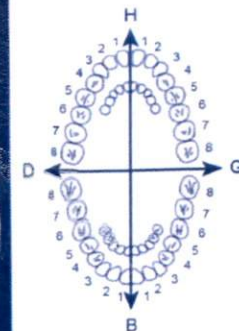

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Ain Sebaâ Casablanca
Lantus Solostar 100U/ml inj b1 Sty 3ml
P.P.V. : 152,50 DH



DETERMINATION DU CCEFFI MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
D	00000000	00000000
G	00000000	00000000
B	35533411	11433553

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Ain Sebaâ Casablanca
Amarel 4 mg, cp b 30
P.P.V. : 68,80 DH



VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

NOCOL® 20 mg
60 comprimés pelliculés



PPV 188DH50

Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés



PPV 28.00D

Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés



PPV 28.00DH

Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés



PPV 28.00DH

Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés



PPV 28.00DH

Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés



PPV 28.00DH

Dr. Ghita MAMOU

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,
Maladies métaboliques et Nutrition

Diabète, Cholestérol, Obésité, Thyroïde, Goitre
Troubles de la croissance et de la puberté
Pathologies surrénaliennes et hypophysaires



الدكتورة غيثة مامو

أخصائية في أمراض الغدد و السكري
أمراض الأيض وطب التغذية

مرض السكري، الكوليستيرول، السمنة
الغدة الدرقية، اختلالات النمو، الغدة النخامية

Casablanca, le : 17/5/23

Nom : Dr. Soummam Abdelaziz

30 Digulles Clith Linn

150+ Bande litte glycem

1005 Lanette
2050,00

x 6/0



th 2mm

Dr. Ghita MAMOU
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie Maladies Métaboliques
Nutrition
Espace Roudani 230 Bd. Roudani 4ème étage - N° 19
Casablanca - Tél. : 05 22 23 70 71

Dr. Ghita MAMOU

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,
Maladies métaboliques et Nutrition

Diabète, Cholestérol, Obésité, Thyroïde, Goitre
Troubles de la croissance et de la puberté
Pathologies surrénaliennes et hypophysaires



الدكتورة غيثة مامو

أخصائية في أمراض الغدد و السكري
أمراض الأيض وطب التغذية

مرض السكري، الكوليستيرول، السمنة
الغدة الدرقية، اختلالات النمو، الغدة النخامية

Casablanca, le: 15/5/23

Nom : Abdelmajid

97,20

Nocel 20

1 p/j le m

188,5

Amaral 4

1 p le matin

28,00 x 6

Glucophage 1g

1 p 2/j

Galvus 50

PHARMACIE Nu 2 MARS
Mme. EL ALAOUI Aïcha
575, Av. du 2 Mars Andalous 1
Tél : 05.22.28.57.84 - Casablanca
INPE: 092000421

3mm

744,00 1 p/j

Lantus soliste

152,50


20VI

le m

152,50

Dr. Ghita MAMOU
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie Maladies Métaboliques
Nutrition
Espace Roudani 230 Bd Roudani 4ème Etage N° 19
Casablanca Tél : 05 22 23 70 71

INSTRUCTIONS FOR USE:

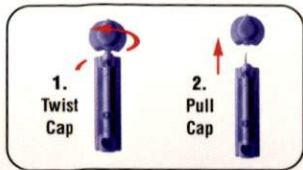

1. Wash hands with soap and warm water. Dry thoroughly.
2. Select fingertip site, slightly off-center.
3. Remove protective lancet cover; above (steps 1 & 2).
If seal is already broken discard lancet.
4. Insert lancet into lancing device, use to puncture skin.
5. Apply drop of blood to test strip, wipe excess from finger.
6. Recap lancet, discard in appropriate container.

CE 0123



STERILE R



Lancets

LOT : 211018T



: 2026-10-17

WARNING:

Needle is sterile if cap is unopened and undamaged.
Do not use lancet if protective cap have been previously removed.
Do not reuse lancets.
Do not store lancet in lancing device.

100 Sterile Single Use Lancets

Code No: TL30100



Lancets

- Tri bevel tip for a more comfortable sampling
- Universal design fits most lancing devices
- Not made with natural rubber latex

30G

Universal Design
Use Once and Destroy

100 Sterile Single Use Lancets



Lancets


Single Use Only
Sterile Tip

30G

100 Sterile Single Use Lancets



INSTRUCTIONS FOR USE:

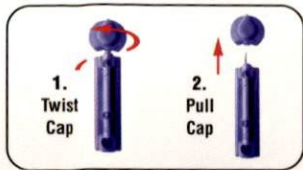

1. Wash hands with soap and warm water. Dry thoroughly.
2. Select fingertip site, slightly off-center.
3. Remove protective lancet cover; above (steps 1 & 2).
If seal is already broken discard lancet.
4. Insert lancet into lancing device, use to puncture skin.
5. Apply drop of blood to test strip, wipe excess from finger.
6. Recap lancet, discard in appropriate container.

CE 0123



STERILE R



Lancets

LOT : 211018T



: 2026-10-17

WARNING:

Needle is sterile if cap is unopened and undamaged.
Do not use lancet if protective cap have been previously removed.
Do not reuse lancets.
Do not store lancet in lancing device.

100 Sterile Single Use Lancets

Code No: TL30100



Lancets

- Tri bevel tip for a more comfortable sampling
- Universal design fits most lancing devices
- Not made with natural rubber latex

30G

Universal Design
Use Once and Destroy

100 Sterile Single Use Lancets



Lancets


Single Use Only
Sterile Tip

30G

100 Sterile Single Use Lancets



INSTRUCTIONS FOR USE:

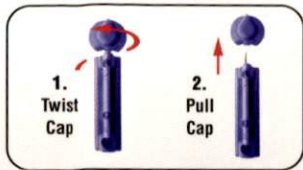

1. Wash hands with soap and warm water. Dry thoroughly.
2. Select fingertip site, slightly off-center.
3. Remove protective lancet cover; above (steps 1 & 2).
If seal is already broken discard lancet.
4. Insert lancet into lancing device, use to puncture skin.
5. Apply drop of blood to test strip, wipe excess from finger.
6. Recap lancet, discard in appropriate container.

CE 0123



STERILE R



Lancets

LOT : 211018T



: 2026-10-17

WARNING:

Needle is sterile if cap is unopened and undamaged.
Do not use lancet if protective cap have been previously removed.
Do not reuse lancets.
Do not store lancet in lancing device.

100 Sterile Single Use Lancets

Code No: TL30100



Lancets

- Tri bevel tip for a more comfortable sampling
- Universal design fits most lancing devices
- Not made with natural rubber latex

30G

Universal Design
Use Once and Destroy

100 Sterile Single Use Lancets



Lancets


Single Use Only
Sterile Tip

30G

100 Sterile Single Use Lancets



INSTRUCTIONS FOR USE:

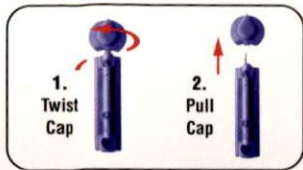

1. Wash hands with soap and warm water. Dry thoroughly.
2. Select fingertip site, slightly off-center.
3. Remove protective lancet cover; above (steps 1 & 2).
If seal is already broken discard lancet.
4. Insert lancet into lancing device, use to puncture skin.
5. Apply drop of blood to test strip, wipe excess from finger.
6. Recap lancet, discard in appropriate container.

CE 0123



STERILE R



Lancets

LOT : 211018T



: 2026-10-17

WARNING:

Needle is sterile if cap is unopened and undamaged.
Do not use lancet if protective cap have been previously removed.
Do not reuse lancets.
Do not store lancet in lancing device.

100 Sterile Single Use Lancets

Code No: TL30100



Lancets

- Tri bevel tip for a more comfortable sampling
- Universal design fits most lancing devices
- Not made with natural rubber latex

30G

Universal Design
Use Once and Destroy

100 Sterile Single Use Lancets



Lancets


Single Use Only
Sterile Tip

30G

100 Sterile Single Use Lancets



INSTRUCTIONS FOR USE:

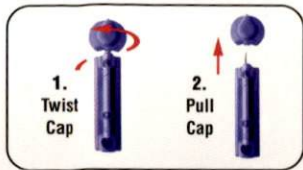

1. Wash hands with soap and warm water. Dry thoroughly.
2. Select fingertip site, slightly off-center.
3. Remove protective lancet cover; above (steps 1 & 2).
If seal is already broken discard lancet.
4. Insert lancet into lancing device, use to puncture skin.
5. Apply drop of blood to test strip, wipe excess from finger.
6. Recap lancet, discard in appropriate container.

CE 0123



STERILE R



Lancets

LOT : 211018T



: 2026-10-17

WARNING:

Needle is sterile if cap is unopened and undamaged.
Do not use lancet if protective cap have been previously removed.
Do not reuse lancets.
Do not store lancet in lancing device.

100 Sterile Single Use Lancets

Code No: TL30100



Lancets

- Tri bevel tip for a more comfortable sampling
- Universal design fits most lancing devices
- Not made with natural rubber latex

30G

Universal Design
Use Once and Destroy

100 Sterile Single Use Lancets



Lancets

Single Use Only
Sterile Tip

30G

100 Sterile Single Use Lancets



Verification du fonctionnement du dispositif

1. Eliminez l'air.
2. Avant de procéder à la vérification du fonctionnement, assurez-vous que la Stylo à Insuline contient suffisamment d'insuline.
3. Installez correctement le couvre-aiguille externe sur l'aiguille à découvert.
4. Tenez le dispositif à la verticale, en pointant l'aiguille vers le bas, et administrez d'insuline.
5. La partie intérieure du couvre-aiguille externe devrait être remplie d'insuline, à défaut, revérifiez le fonctionnement avec une nouvelle aiguille.

Mode d'emploi

Enlevez et jetez l'aiguille immédiatement après chaque injection. N'utilisez pas une aiguille dont le capot de protection est manquant ou endommagé. Prenez garde à ne pas courber ou endommager l'aiguille avant utilisation. Pour usage unique, Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Dispositif stérile garanti si le sceau de l'aiguille est intact.

Les aiguilles Ibrafine ont été spécialement conçues pour être utilisées avec les Stylos à Insuline et les dispositifs d'injection d'insuline (Le système intégré)

BDM



CODE: I23105

LOT: 862A63

01/2020

01/2025



STERILE EO



Single Use
Pen Needles
Sterile
Non Toxic
Non Pyrogenic

4

Ibrafine

x 50

Aiguille Stylo Insuline

Compatible avec tous les stylos d'insuline



CE
1984



4

mm
32G 0.23mm

ΣΘΟ.ΚΣΙ%



Exelle Medic sari



Distributor:

Rue Al Khansaa Immeuble 59 2eme étage
Quartier Palmier Casablanca 20100 Maroc
Tél: +212 5 22 47 01 05 - Mobile: +212 6 61 14 35 72

CEDM N°: 2804/2016/DMP/20/DM

Manufactured By: Medisec Tıbbi Cihaz ve Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Başpınar (Organize) O.S.B. Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Celal Doğan Blv. No:40
Şehitkamil / GAZİANTEP / TÜRKİYE
www.medisec.com.tr Tel: +90 342 337 88 75 Fax: +90 342 337 88 76

Verification du fonctionnement du dispositif

1. Eliminez l'air.
2. Avant de procéder à la vérification du fonctionnement, assurez-vous que la Stylo à Insuline contient suffisamment d'insuline.
3. Installez correctement le couvre-aiguille externe sur l'aiguille à découvert.
4. Tenez le dispositif à la verticale, en pointant l'aiguille vers le bas, et administrez d'insuline.
5. La partie intérieure du couvre-aiguille externe devrait être remplie d'insuline, à défaut, revérifiez le fonctionnement avec une nouvelle aiguille.

Mode d'emploi

Enlevez et jetez l'aiguille immédiatement après chaque injection. N'utilisez pas une aiguille dont le capot de protection est manquant ou endommagé. Prenez garde à ne pas courber ou endommager l'aiguille avant utilisation. Pour usage unique, Stérilisé à l'oxyde d'éthylène.

Dispositif stérile garanti si le sceau de l'aiguille est intact.

Les aiguilles Ibrafine ont été spécialement conçues pour être utilisées avec les Stylos à Insuline et les dispositifs d'injection d'insuline (Le système intégré)

BDM



CODE: I23105

LOT: 862A63

01/2020

01/2025



STERILE EO



Single Use
Pen Needles
Sterile
Non Toxic
Non Pyrogenic

4

Ibrafine

x 50

Aiguille Stylo Insuline

Compatible avec tous les stylos d'insuline



CE
1984



4

mm
32G 0.23mm

ΣΘΟ.ΚΣΙ%



Exelle Medic sari



Distributor:

Rue Al Khansaa Immeuble 59 2eme étage
Quartier Palmier Casablanca 20100 Maroc
Tél: +212 5 22 47 01 05 - Mobile: +212 6 61 14 35 72

CEDM N°: 2804/2016/DMP/20/DM

Manufactured By: Medisec Tıbbi Cihaz ve Ürünleri İth. İhr. San. ve Tic. Ltd. Şti.

Başpınar (Organize) O.S.B. Mahallesi O.S.B. 2. Bölge Celal Doğan Blv. No:40
Şehitkamil / GAZİANTEP / TÜRKİYE
www.medisec.com.tr Tel: +90 342 337 88 75 Fax: +90 342 337 88 76

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Codefree™

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT 1033BE1AC1

2022-11-14

2024-11-13

(01) 08809319399308

(11) 221114

(17) 241113

(10) 1033BE1AC1




8 809319 399308

- EN**
- Replace cap immediately.
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- ES**
- Tape de inmediato después de utilizar.
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- CZ**
- Po otevření ihned uzavřete.
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

MB03CF1 MLR6
Issue date: 2020.12

- PT**
- Substitua imediatamente a cápsula.
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- FR**
- Refermer immédiatement le bouchon.
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- NL**
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- RU**
- незамедлительно закройте крышку после использования.
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- DE**
- Deckel sofort wieder schliessen.
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- IT**
- Richiudere immediatamente il coperchio.
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Per autocontrollo.

- RO**
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
 - Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
 - Se folosește pentru autotestare.

- TR**
- Kutunun kapagını hemen kapatınız.
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine test için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

Σ 25 X 2 TEST

REF 01GS11

Cat. No.: 01GS11

Manufactured by SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Codefree™

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT 1033BE1AC1

2022-11-14

2024-11-13

(01) 08809319399308

(11) 221114

(17) 241113

(10) 1033BE1AC1



8 809319 399308

- EN**
- Replace cap immediately.
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- ES**
- Tape de inmediato después de utilizar.
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- CZ**
- Po otevření ihned uzavřete.
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

CE 0123 IVD i



MB03CF1 MLR6
Issue date: 2020.12

- PT**
- Substitua imediatamente a cápsula.
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- FR**
- Refermer immédiatement le bouchon.
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- NL**
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- RU**
- незамедлительно закройте крышку после использования.
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- DE**
- Deckel sofort wieder schliessen.
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- IT**
- Richiudere immediatamente il coperchio.
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Per autocontrollo.

- RO**
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
 - Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
 - Se folosește pentru autotestare.

- TR**
- Kutunun kapagini hemen kapatınız.
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine test için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

Σ 25 X 2 TEST

REF 01GS11

Cat. No.: 01GS11

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Codefree™

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT 1033BE1AC1

2022-11-14

2024-11-13

(01) 08809319399308

(11) 221114

(17) 241113

(10) 1033BE1AC1



8 809319 399308

- EN**
- Replace cap immediately.
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- ES**
- Tape de inmediato después de utilizar.
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- CZ**
- Po otevření ihned uzavřete.
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

CE 0123 IVD i



MB03CF1 MLR6
Issue date: 2020.12

- PT**
- Substitua imediatamente a cápsula.
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- FR**
- Refermer immédiatement le bouchon.
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- NL**
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- RU**
- незамедлительно закройте крышку после использования.
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- DE**
- Deckel sofort wieder schliessen.
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- IT**
- Richiudere immediatamente il coperchio.
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Per autocontrollo.

- RO**
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
 - Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
 - Se folosește pentru autotestare.

- TR**
- Kutunun kapagini hemen kapatınız.
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine test için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

Σ 25 X 2 TEST

REF 01GS11

Cat. No.: 01GS11

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Codefree™

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT 1033BE1AC1

2022-11-14

2024-11-13

(01) 08809319399308

(11) 221114

(17) 241113

(10) 1033BE1AC1



8 809319 399308

- EN**
- Replace cap immediately.
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- ES**
- Tape de inmediato después de utilizar.
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- CZ**
- Po otevření ihned uzavřete.
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

CE 0123 IVD i



MB03CF1 MLR6
Issue date: 2020.12

- PT**
- Substitua imediatamente a cápsula.
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- FR**
- Refermer immédiatement le bouchon.
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- NL**
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- RU**
- незамедлительно закройте крышку после использования.
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- DE**
- Deckel sofort wieder schliessen.
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- IT**
- Richiudere immediatamente il coperchio.
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Per autocontrollo.

- RO**
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
 - Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
 - Se folosește pentru autotestare.

- TR**
- Kutunun kapagini hemen kapatınız.
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine test için uygundur
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

Σ 25 X 2 TEST

REF 01GS11

Cat. No.: 01GS11

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Codefree™

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT 1033BE1AC1

2022-11-14

2024-11-13

(01) 08809319399308

(11) 221114

(17) 241113

(10) 1033BE1AC1



8 809319 399308

- EN**
- Replace cap immediately.
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- ES**
- Tape de inmediato después de utilizar.
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- CZ**
- Po otevření ihned uzavřete.
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

CE 0123 IVD i



MB03CF1 MLR6
Issue date: 2020.12

- PT**
- Substitua imediatamente a cápsula.
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- FR**
- Refermer immédiatement le bouchon.
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- NL**
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- RU**
- незамедлительно закройте крышку после использования.
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- DE**
- Deckel sofort wieder schliessen.
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- IT**
- Richiudere immediatamente il coperchio.
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Per autocontrollo.

- RO**
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
 - Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
 - Se folosește pentru autotestare.

- TR**
- Kutunun kapagını hemen kapatınız.
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine test için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

Σ 25 X 2 TEST

REF 01GS11

Cat. No.: 01GS11

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Codefree™

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT 1033BE1AC1

2022-11-14

2024-11-13

(01) 08809319399308

(11) 221114

(17) 241113

(10) 1033BE1AC1



8 809319 399308

- EN**
- Replace cap immediately.
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- ES**
- Tape de inmediato después de utilizar.
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- CZ**
- Po otevření ihned uzavřete.
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

CE 0123 IVD i



MB03CF1 MLR6
Issue date: 2020.12

- PT**
- Substitua imediatamente a cápsula.
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- FR**
- Refermer immédiatement le bouchon.
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- NL**
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- RU**
- незамедлительно закройте крышку после использования.
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- DE**
- Deckel sofort wieder schliessen.
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- IT**
- Richiudere immediatamente il coperchio.
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Per autocontrollo.

- RO**
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
 - Băndețele de testare se păstrează în recipientul original.
 - Se folosește pentru autotestare.

- TR**
- Kutunun kapagını hemen kapatınız.
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine test için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

Σ 25 X 2 TEST

REF 01GS11

Cat. No.: 01GS11

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Codefree™

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT 1033BE1AC1

2022-11-14

2024-11-13

(01) 08809319399308

(11) 221114

(17) 241113

(10) 1033BE1AC1



8 809319 399308

- EN**
- Replace cap immediately.
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- ES**
- Tape de inmediato después de utilizar.
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- CZ**
- Po otevření ihned uzavřete.
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

CE 0123 IVD i



MB03CF1 MLR6
Issue date: 2020.12

- PT**
- Substitua imediatamente a cápsula.
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- FR**
- Refermer immédiatement le bouchon.
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- NL**
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- RU**
- незамедлительно закройте крышку после использования.
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- DE**
- Deckel sofort wieder schliessen.
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- IT**
- Richiudere immediatamente il coperchio.
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Per autocontrollo.

- RO**
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
 - Băndețele de testare se pastrează în recipientul original.
 - Se folosește pentru autotestare.

- TR**
- Kutunun kapagını hemen kapatınız.
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine test için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

Σ 25 X 2 TEST

REF 01GS11

Cat. No.: 01GS11

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Codefree™

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT 1033BE1AC1

2022-11-14

2024-11-13

(01) 08809319399308

(11) 221114

(17) 241113

(10) 1033BE1AC1




8 809319 399308

- EN**
- Replace cap immediately.
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- ES**
- Tape de inmediato después de utilizar.
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- CZ**
- Po otevření ihned uzavřete.
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

MB03CF1 MLR6
Issue date: 2020.12

- PT**
- Substitua imediatamente a cápsula.
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- FR**
- Refermer immédiatement le bouchon.
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- NL**
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- RU**
- незамедлительно закройте крышку после использования.
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- DE**
- Deckel sofort wieder schliessen.
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- IT**
- Richiudere immediatamente il coperchio.
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Per autocontrollo.

- RO**
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
 - Băndețele de testare se păstrează în recipientul original.
 - Se folosește pentru autotestare.

- TR**
- Kutunun kapagını hemen kapatınız.
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine test için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

Σ 25 X 2 TEST

REF 01GS11

Cat. No.: 01GS11

Manufactured by SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Codefree™

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT 1033BE1AC1

2022-11-14

2024-11-13

(01) 08809319399308

(11) 221114

(17) 241113

(10) 1033BE1AC1



8 809319 399308

- EN**
- Replace cap immediately.
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- ES**
- Tape de inmediato después de utilizar.
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- CZ**
- Po otevření ihned uzavřete.
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

CE 0123 IVD i



MB03CF1 MLR6
Issue date: 2020.12

- PT**
- Substitua imediatamente a cápsula.
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- FR**
- Refermer immédiatement le bouchon.
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- NL**
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- RU**
- незамедлительно закройте крышку после использования.
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- DE**
- Deckel sofort wieder schliessen.
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- IT**
- Richiudere immediatamente il coperchio.
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Per autocontrollo.

- RO**
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
 - Băndețele de testare se pastrează în recipientul original.
 - Se folosește pentru autotestare.

- TR**
- Kutunun kapagını hemen kapatınız.
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine test için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

Σ 25 X 2 TEST

REF 01GS11

Cat. No.: 01GS11

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Codefree™

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT 1033BE1AC1

2022-11-14

2024-11-13

(01) 08809319399308

(11) 221114

(17) 241113

(10) 1033BE1AC1



8 809319 399308

- EN**
- Replace cap immediately.
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- ES**
- Tape de inmediato después de utilizar.
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- CZ**
- Po otevření ihned uzavřete.
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

CE 0123 IVD i



MB03CF1 MLR6
Issue date: 2020.12

- PT**
- Substitua imediatamente a cápsula.
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- FR**
- Refermer immédiatement le bouchon.
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- NL**
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- RU**
- незамедлительно закройте крышку после использования.
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- DE**
- Deckel sofort wieder schliessen.
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- IT**
- Richiudere immediatamente il coperchio.
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Per autocontrollo.

- RO**
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
 - Bandelele de testare se pastrează în recipientul original.
 - Se folosește pentru autotestare.

- TR**
- Kutunun kapagini hemen kapatınız.
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine test için uygundur
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

Σ 25 X 2 TEST

REF 01GS11

Cat. No.: 01GS11

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021