



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° W19-547155

272048

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2069 Société : Royal Air Maroc

☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☒ Autre : Retraité

Nom & Prénom : Mr SOUMMLANE ABDESSADEQ

Date de naissance : 01.01.1949

Adresse : Habiuelle

Tél. : 0766606789 Total des frais engagés : Consultation + Pharmacie + Parapharmacie
300 + 1746,30 + 2090 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr Ghita MAMOU
Spécialiste Endocrinologie
Diabétologie Maladies Métaboliques
Nutrition
Espace Roudani 200 Bd. Roudani 4ème Etage N° 19
Casablanca - Tél. : 05 22 23 70 11

Date de consultation : / /

Nom et prénom du malade : SOUMMLANE ABDESSADEQ Age : 74

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Affection endocrinienne

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : Maladie longue durée.

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pl confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca Le : 08/10/2023

Signature de l'adhérent(e) : et le 08/10/2023

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
18/12/23			300 DMs	INP : 09102155
9/18/2023	CH			

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
Pharmacie El Anassir Mme. EL ANASSIR 575, Av. du 2 Mars Andalou Tél : 05 22 28 57 84 INPE: 092000444	9/18/23	1746,30

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
Pharmacie El Anassir 05 22 85 09 39 Tél: 05 22 856 727 Casablanca AV 2 Mars N° 514 Andalou 2	9/18/23					2000,00

sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Ain Sebaâ 20250 - Casablanca
LANTUS SOLOSTAR 100U/ML SOL INJ B5
P.P.V. : 74,40 DH

NOCOL® 20 mg
60 comprimés pelliculés

Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés


Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Ain Sebaâ Casablanca
Lantus Solostar 100U/ml inj
b1 Sty 3ml
P.P.V. : 152,50 DH

PRV: 188DH50
NOCOL® 20 mg
30 comprimés pelliculés

PPV 28.00DH
Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés

PPV 28.00DH
Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés

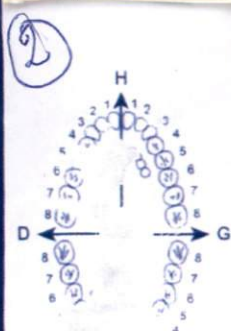

PPV 188 DH 50

97,60

②

PPV
TA et
code barre

Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés

Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Amarel 4 mg, cp b 30
P.P.V. : 68,80 DH

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Amarel 4 mg, cp b 30
P.P.V. : 68,80 DH

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

319334

Tardyferon® 80mg
30 comprimés pelliculés

PPV : 40,50 DH

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat -R.P.1,
Ain sebaâ Casablanca
Amarel 4 mg, cp b 30
P.P.V. : 68,80 DH

D-CURE FORTE

D-CURE FORTE

D-CURE FORTE

PPV:49,60 DH

PPV:49,60 DH

PPV:49,60 DH

6 118001 320103

6 118001 320103

6 118001 320103

③

Dr. Ghita MAMOU

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,
Maladies métaboliques et Nutrition

Diabète, Cholestérol, Obésité, Thyroïde, Goitre
Troubles de la croissance et de la puberté
Pathologies surrénaliennes et hypophysaires



الدكتورة غيثة مامو

أخصائية في أمراض الغدد والسكري
أمراض الأيض وطب التغذية

مرض السكري، الكوليستيرول، السمنة
الغدة الدرقية، اختلالات النمو، الغدة النخامية

Casablanca, le : 9/8/23

Nom : M. Soummane Abdelkader

28,00 x 6
Glucophage (S.V.)

68,80 x 3
Amar (S.V.)

Galvus 50

744,00
Lantus Solostar (S.V.)

152,50
97,60
Nocol (S.V.)

188,50

Tardyferon (S.V.)
40,50

D Cure forte (S.V.)
49,60 x 3

1 amp / 15 j x 2 mois
puis 1 amp / mois x 4 mois

1 p x 4 j

1 p / j le matin

1 p x 2 j

18 U

1 p / j 6 mi

1 p / j

3 mois

Dr. Ghita MAMOU
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie Maladies Métaboliques
Nutrition
Espace Roudani 230 Bd. Roudani - 4ème étage - N° 19 - Casablanca - Tél.: 05 22 23 70 71

فضاء الروداني. 230 شارع الروداني (طريق الجديدة سابقا) - الطابق الرابع - رقم 19 - الدار البيضاء - الهاتف : 05 22 23 70 71

Espace Roudani. 230 Bd. Roudani (ex Route d'El Jadida) - 4ème étage - N° 19 - Casablanca - Tél.: 05 22 23 70 71
GSM : 0678 93 68 96 - E-mail : mamoughita@gmail.com

Dépliller SVP

Soumane M^e 2069



Dr. Ghita MAMOU

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,
Maladies métaboliques et Nutrition

Diabète, Cholestérol, Obésité, Thyroïde, Goitre
Troubles de la croissance et de la puberté
Pathologies surrénaliennes et hypophysaires



مكتورة غيثة مامو

صائية في أمراض الغدد و السكري
أمراض الأيض وطب التغذية

مرض السكري، الكوليستيرول، السمنة
الغدة الدرقية، اختلالات النمو، الغدة النخامية

Casablanca, le : 9/8/23

Nom : N° SoummANE Abdessadeq

Aiguilles Verfine 4mm

1/5

Lancettes

+

Bandes lctes

x 3/5



et 3 mois

2090,00

Dr. Ghita MAMOU

Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie Maladies Métaboliques
Nutrition
Espace Roudani 230 Bd. Roudani 4ème Etage N° 19
Casablanca - Tél. : 05 22 23 70 71

FACTURE N° :2300090

Date :

09/08/2023

SOUMMANE ABDESSADEQ

CASABLANCA

Condition de paiement :

REF	DESIGNATION	QTE	PU T.T.C (Dhs)	Total T.T.C (Dhs)
	SD Bandelette CODE FREE (50U)	10	150,00	1 500,00
	Aiguilles pour stylo à insuline 4mm (bte100U)	1	90,00	90,00
	Lancettes boîte (100U)	5	100,00	500,00

Montant TTC 2 090,00

Arrêtée la présente Facture à la somme de (T.T.C) :
Deux mille quatre vingt dix dirhams



SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT 1033C71AC1

2022-12-07

2024-12-06

(01) 08809319399308

(11) 221207

(17) 241206

(10) 1033C71AC1



8 809319 399308

10/10

- Replace cap immediately.
- Always store strips in container.
- Suitable for self-testing.


EN

- Tape de inmediato después de utilizar.
- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

ES

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

CZ



10% RH 93% RH 32°C (90°F) 2°C (36°F)



MB03CF1MLR6
Issue date: 2020.12

- Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

PT

- Refermer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- Незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Per autocontrollo.

IT

- Inchideti recipientul imediat dupa utilizare.
- Bandetele de testare se pastreaza in recipientul original.
- Se foloseste pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine test için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbî tani.

TR

25 X 2 TEST

REF 01GS11

Cat. No.: 01GS11

=50

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 155beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT 1033C71AC1

2022-12-07

2024-12-06

(01) 08809319399308

(11) 221207

(17) 241206

(10) 1033C71AC1



10
/
10

- Replace cap immediately.
- Always store strips in container.
- Suitable for self-testing.


EN

- Tape de inmediato después de utilizar.
- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

ES

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

CZ



10% RH 93% RH 32°C (90°F) 2°C (36°F)



MB03CF1MLR6
Issue date: 2020.12

- Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

PT

- Refermer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- Незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Per autocontrollo.

IT

- Inchideti recipientul imediat dupa utilizare.
- Bandetele de testare se pastreaza in recipientul original.
- Se foloseste pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine test için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

TR

25 X 2 TEST

REF 01GS11

Cat. No.: 01GS11

=50

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT 1033C71AC1

2022-12-07

2024-12-06

(01) 08809319399308

(11) 221207

(17) 241206

(10) 1033C71AC1



10
/
10

- Replace cap immediately.
- Always store strips in container.
- Suitable for self-testing.


EN

- Tape de inmediato después de utilizar.
- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

ES

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

CZ



10% RH 93% RH 32°C (90°F) 2°C (36°F)



MB03CF1MLR6
Issue date: 2020.12

- Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

PT

- Refermer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- Незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Per autocontrollo.

IT

- Inchideti recipientul imediat dupa utilizare.
- Bandetele de testare se pastreaza in recipientul original.
- Se foloseste pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine test için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

TR

25 X 2 TEST

REF 01GS11

Cat. No.: 01GS11

=50

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT 1033C71AC1

2022-12-07

2024-12-06

(01) 08809319399308

(11) 221207

(17) 241206

(10) 1033C71AC1



10
/
10

- Replace cap immediately.
- Always store strips in container.
- Suitable for self-testing.


EN

- Tape de inmediato después de utilizar.
- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

ES

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

CZ



10% RH 93% RH 32°C (90°F) 2°C (36°F)



MB03CF1MLR6
Issue date: 2020.12

- Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

PT

- Refermer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- Незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Per autocontrollo.

IT

- Inchideti recipientul imediat dupa utilizare.
- Bandetele de testare se pastreaza in recipientul original.
- Se foloseste pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine test için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

TR

25 X 2 TEST

REF 01GS11

Cat. No.: 01GS11

=50

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT 1033C71AC1

2022-12-07

2024-12-06

(01) 08809319399308

(11) 221207

(17) 241206

(10) 1033C71AC1



10
/
10

- Replace cap immediately.
- Always store strips in container.
- Suitable for self-testing.


EN

- Tape de inmediato después de utilizar.
- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

ES

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

CZ



10% RH 93% RH 32°C (90°F) 2°C (36°F)



MB03CF1MLR6
Issue date: 2020.12

- Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

PT

- Refermer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- Незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Per autocontrollo.

IT

- Inchideti recipientul imediat dupa utilizare.
- Bandetele de testare se pastreaza in recipientul original.
- Se foloseste pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine test için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbî tani.

TR

25 X 2 TEST

REF 01GS11

Cat. No.: 01GS11

=50

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 155beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

LOT 1033C71AC1

2022-12-07

2024-12-06

(01) 08809319399308

(11) 221207

(17) 241206

(10) 1033C71AC1



10/10

- Replace cap immediately.
- Always store strips in container.
- Suitable for self-testing.


EN

- Tape de inmediato después de utilizar.
- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

ES

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

CZ



10% RH 93% RH 32°C (90°F) 2°C (36°F)



MB03CF1MLR6
Issue date: 2020.12

- Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

PT

- Refermer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- Незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Per autocontrollo.

IT

- Inchideti recipientul imediat dupa utilizare.
- Bandetele de testare se pastreaza in recipientul original.
- Se foloseste pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine test için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbî tanı.

TR

25 X 2 TEST

REF 01GS11

Cat. No.: 01GS11

=50

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 155beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR



LOT 1033C71AC1
2022-12-07
2024-12-06
(01) 08809319399308
(11) 221207
(17) 241206
(10) 1033C71AC1



8 809319 399308

10
/
10

- Replace cap immediately.
- Always store strips in container.
- Suitable for self-testing.

EN


- Tape de inmediato después de utilizar.
- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

ES

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

CZ

CE 0123 IVD i



MB03CF1MLR6
Issue date: 2020.12

- Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

PT

- Refermer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- Незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Per autocontrollo.

IT

- Inchideti recipientul imediat dupa utilizare.
- Bandelele de testare se pastreaza in recipientul original.
- Se foloseste pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine test için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbî tanı.

TR

25 X 2 TEST

REF 01GS11
Cat. No.: 01GS11

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 155beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR



LOT 1033C71AC1
2022-12-07
2024-12-06
(01) 08809319399308
(11) 221207
(17) 241206
(10) 1033C71AC1



8 809319 399308

10
/
10

- Replace cap immediately.
- Always store strips in container.
- Suitable for self-testing.

EN


- Tape de inmediato después de utilizar.
- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

ES

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

CZ

CE 0123 IVD i



MB03CF1MLR6
Issue date: 2020.12

- Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

PT

- Refermer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- Незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Per autocontrollo.

IT

- Inchideti recipientul imediat dupa utilizare.
- Bandelele de testare se pastreaza in recipientul original.
- Se foloseste pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine test için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbî tanı.

TR

25 X 2 TEST

REF 01GS11
Cat. No.: 01GS11

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 155beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR



LOT 1033C71AC1
2022-12-07
2024-12-06
(01) 08809319399308
(11) 221207
(17) 241206
(10) 1033C71AC1



8 809319 399308

10
/
10

- Replace cap immediately.
- Always store strips in container.
- Suitable for self-testing.

EN


- Tape de inmediato después de utilizar.
- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

ES

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

CZ

CE 0123 IVD i



MB03CF1MLR6
Issue date: 2020.12

- Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

PT

- Refermer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- Незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Per autocontrollo.

IT

- Inchideti recipientul imediat dupa utilizare.
- Bandetele de testare se pastreaza in recipientul original.
- Se foloseste pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine test için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbî tanı.

TR

25 X 2 TEST

REF 01GS11
Cat. No.: 01GS11

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 155beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip

GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR



LOT 1033C71AC1
2022-12-07
2024-12-06
(01) 08809319399308
(11) 221207
(17) 241206
(10) 1033C71AC1



8 809319 399308

10
/
10

- Replace cap immediately.
- Always store strips in container.
- Suitable for self-testing.

EN


- Tape de inmediato después de utilizar.
- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

ES

- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

CZ

CE 0123 IVD i



MB03CF1MLR6
Issue date: 2020.12

- Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

PT

- Refermer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

FR

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

NL

- Незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

RU

- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

DE

- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Per autocontrollo.

IT

- Inchideti recipientul imediat dupa utilizare.
- Bandetele de testare se pastreaza in recipientul original.
- Se foloseste pentru autotestare.

RO

- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine test için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbî tanı.

TR

25 X 2 TEST

REF 01GS11
Cat. No.: 01GS11

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 155beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

Code No: TL

Lancets

- Tri bevel tip for a more comfortable sampling
- Universal design fits most lancing devices
- Not made with natural rubber latex

30G

Universal Design
Use Once and Destroy

100 Sterile Single Use Lancets



Lancets


Single Use Only
Sterile Tip

30G

100 Sterile Single Use Lancets



INSTRUCTIONS FOR USE:



1. Wash hands with soap and warm water. Dry thoroughly.
2. Select fingertip site, slightly off-center.
3. Remove protective lancet cover, above (steps 1 & 2).
If seal is already broken discard lancet.
4. Insert lancet into lancing device, use to puncture skin.
5. Apply drop of blood to test strip, wipe excess from finger.
6. Recap lancet, discard in appropriate container.

CE 0123



STERILE R



Lancets

LOT : 211018T

EXP : 2026-10-17

WARNING:

Needle is sterile if cap is unopened and undamaged.
Do not use lancet if protective cap have been previously removed.
Do not reuse lancets.
Do not store lancet in lancing device.

100 Sterile Single Use Lancets

5/5

Code No: TL

Lancets

- Tri bevel tip for a more comfortable sampling
- Universal design fits most lancing devices
- Not made with natural rubber latex

30G

Universal Design
Use Once and Destroy

100 Sterile Single Use Lancets



Lancets


Single Use Only
Sterile Tip

30G

100 Sterile Single Use Lancets



INSTRUCTIONS FOR USE:



1. Wash hands with soap and warm water. Dry thoroughly.
2. Select fingertip site, slightly off-center.
3. Remove protective lancet cover, above (steps 1 & 2).
If seal is already broken discard lancet.
4. Insert lancet into lancing device, use to puncture skin.
5. Apply drop of blood to test strip, wipe excess from finger.
6. Recap lancet, discard in appropriate container.

CE 0123



STERILE R



Lancets

LOT : 211018T

EXP : 2026-10-17

WARNING:

Needle is sterile if cap is unopened and undamaged.
Do not use lancet if protective cap have been previously removed.
Do not reuse lancets.
Do not store lancet in lancing device.

100 Sterile Single Use Lancets

5/5

Code No: TL

Lancets

- Tri bevel tip for a more comfortable sampling
- Universal design fits most lancing devices
- Not made with natural rubber latex

30G

Universal Design
Use Once and Destroy

100 Sterile Single Use Lancets



Lancets


Single Use Only
Sterile Tip

30G

100 Sterile Single Use Lancets



INSTRUCTIONS FOR USE:



1. Wash hands with soap and warm water. Dry thoroughly.
2. Select fingertip site, slightly off-center.
3. Remove protective lancet cover, above (steps 1 & 2).
If seal is already broken discard lancet.
4. Insert lancet into lancing device, use to puncture skin.
5. Apply drop of blood to test strip, wipe excess from finger.
6. Recap lancet, discard in appropriate container.

CE 0123



STERILE R



Lancets

LOT : 211018T

EXP : 2026-10-17

WARNING:

Needle is sterile if cap is unopened and undamaged.
Do not use lancet if protective cap have been previously removed.
Do not reuse lancets.
Do not store lancet in lancing device.

100 Sterile Single Use Lancets

5/5

Code No: 1L

Lancets

- Tri bevel tip for a more comfortable sampling
- Universal design fits most lancing devices
- Not made with natural rubber latex

30G

Universal Design
Use Once and Destroy

100 Sterile Single Use Lancets



Lancets


Single Use Only
Sterile Tip

30G

100 Sterile Single Use Lancets



INSTRUCTIONS FOR USE:



1. Wash hands with soap and warm water. Dry thoroughly.
2. Select fingertip site, slightly off-center.
3. Remove protective lancet cover, above (steps 1 & 2).
If seal is already broken discard lancet.
4. Insert lancet into lancing device, use to puncture skin.
5. Apply drop of blood to test strip, wipe excess from finger.
6. Recap lancet, discard in appropriate container.

CE 0123



STERILE R



Lancets

LOT : 211018T

EXP : 2026-10-17

WARNING:

Needle is sterile if cap is unopened and undamaged.
Do not use lancet if protective cap have been previously removed.
Do not reuse lancets.
Do not store lancet in lancing device.

100 Sterile Single Use Lancets

5/5

Code No: 1L

Lancets

- Tri bevel tip for a more comfortable sampling
- Universal design fits most lancing devices
- Not made with natural rubber latex

30G

Universal Design
Use Once and Destroy

100 Sterile Single Use Lancets



Lancets


Single Use Only
Sterile Tip

30G

100 Sterile Single Use Lancets



INSTRUCTIONS FOR USE:



1. Wash hands with soap and warm water. Dry thoroughly.
2. Select fingertip site, slightly off-center.
3. Remove protective lancet cover, above (steps 1 & 2).
If seal is already broken discard lancet.
4. Insert lancet into lancing device, use to puncture skin.
5. Apply drop of blood to test strip, wipe excess from finger.
6. Recap lancet, discard in appropriate container.

CE 0123



STERILE R



Lancets

LOT : 211018T

EXP : 2026-10-17

WARNING:

Needle is sterile if cap is unopened and undamaged.
Do not use lancet if protective cap have been previously removed.
Do not reuse lancets.
Do not store lancet in lancing device.

100 Sterile Single Use Lancets

5/5

PPV: 90.00 DHS

Compatible avec les stylos d'insuline

2. Injectez à angle droit, pour éviter la torsion de l'aiguille, et maintenez l'aiguille sous la peau pendant 10 secondes.



1. Faites perler l'insuline (2 unités) en tenant le stylo vers le haut pour éliminer les bulles d'air.



Vérification du bon fonctionnement du dispositif :



MediGlobal®

Pour votre bien être

Paroi fine

Sans douleurs

Non toxique

Sans latex

Aiguilles pour stylo d'insuline

إبر قلم الأنسولين

Pen needles

Medi Fine®

4 mm

32GX100pcs