

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien et du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE REGIONALE Dr. Saad BEN JELLOUN Tél. : 05 20 71 18 70 LA PHARMACIE Imm. 94, Lot N° 4 DERC Dr. Saad BEN JELLOUN Tél. : 05 20 71 18 70	10/04/24 20/04/24	1161,30 350,02

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

O.D.F
PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

[Création, remont, adjonction]

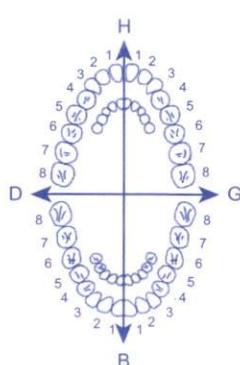

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr. Hamza JAMI

OMNIPRACTICIEN

Lauréat de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie Casablanca

Ancien Médecin Interne au CHP Ben M'sik

الدكتور حمزة جامي

الطب العام

خريج كلية الطب والصيدلة الدار البيضاء
طبيب داخلي سابق
بالمراكز الإستشفائية ابن امسيك



Deroua, le : 20/04/2021 الدروة، هي :

1161.30

GATAOU TAX

ASDEWATH

S.V.

56 X2

Glymoc m 2

- - 1 - 1 3 mg

S.V.

10/12/15 15

S.V.

3 mg

Cardiasp

- 0 - 0

S.V.

3

1161.30

Lpa + hyl 160

- 0 - 1

S.V.

3

الطابق الأول تجربة الوحدة 2 أيام مختبر التحاليلات الدروة 252

252 1er Etage , Lot. ALWAHDA 2 en Face du Labo d'Analyses Médicales Deroua

الهاتف : 05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

05 22 636 000

Laboratoires MAPHAR
Boulevard ALKIMIA N°6
Quartier Industriel,
Sidi Bernoussi - Casablanca
Maroc

P.P.V. : 116,80 DH

6 118001 181636

501353 b

→ 457,00

42

42

Cardioaspirine 100 mg/30cpls
Acide acetylsalicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.

6 118001 090280

2009/09/02 21:05:17
ANNA FR 501353 b
NNP

6 118001 130313
TRIPLIXAM 10mg/2,5mg/5 mg
30 comprimés pelliculés
PPV : 164,70 Dh
Servier Maroc - Casablanca

2009/09/02 21:05:17
ANNA FR 501353 b
NNP

6 118001 130313
TRIPLIXAM 10mg/2,5mg/5 mg
30 comprimés pelliculés
PPV : 164,70 Dh
Servier Maroc - Casablanca

56,80

56,80

Laboratoires MAPHAR
Boulevard ALKIMIA N°6
Quartier Industriel,
Sidi Bernoussi - Casablanca
Maroc

P.P.V. : 116,80 DH


6 118001 181636

Dr. Hamza JAMI

OMNIPRACTICIEN

Lauréat de la Faculté de Médecine
et de Pharmacie Casablanca

Ancien Médecin Interne au CHP Ben M'sik



الدكتور حمزة جامي

الطب العام

خريج كلية الطب والصيدلة الدار البيضاء
طبيب داخلي سابق
بالمراكز الإستشفائية ابن امسيك

Deroua, le :

20/04/2023

الدروة ، في :

Dr. HAMZA JAMI
Médecin Généraliste
252 1er étage, Lot. ALWAHDA
Deroua Tél: 0522036000

1) 70,00 x 5
Bandelettes pour glucosette
350,00

LA PHARMACIE RÉGIONALE
Dr. S. BENJELLOUN
Imm. 94, Lot. WAHADIA N°4-DEROUA
Tél: 0522514707

Dr. Hamza JAMI
Médecin Généraliste
252 1er étage, Lot. ALWAHDA
Deroua Tél: 0522036000

252 ، الطابق الأول تجربة الوحدة 2 أمام مختبر التحاليلات الدروة

252 1er Etage , Lot. ALWAHDA 2 en Face du Labo d'Analyses Médicales Deroua

الهاتف : 05 22 036 000

LA PHARMACIE REGIONALE DEROUA

FACTURE

Pour Mr : A B D L W A H A B G H A O U A

Facture N° : 176788

Date : 20/04/24

Art	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant
1	Biandelettes RIG HTEST	5	70,00	350,00

LA PHARMACIE REGIONALE
Dr. S. S. BENJELLOUN
Imm. 94, Lot NAIT N° 4-DEROUA
Tél: 05 22 51 47 07

LA PHARMACIE REGIONALE
Dr. S. S. BENJELLOUN
Imm. 94, Lot NAIT N° 4-DEROUA
Tél: 05 22 51 47 07

Montant	117,00
T.V.A	1,00
TOTAL T.T	118,00

Arrête la présente facture à la somme de :



RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de
glycémie

Utilisation facile



1 Insérez la bandelettes-test et
l'appareil de mesure effectuera
automatiquement le cryptage
automatique.



2 Appliquez une petite goutte de
sang lorsque le symbole de la
goutte de sang clignote.

BIONIME



20360 CASABLANCA, MAROC

QUARTIER DES HOPITALUX

N° 25 RDC, RUE LACHENI EL ARJOUNE



RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre

RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan

Tel: +886 4 23692388

Fax: +886 4 22617586

Email: info@bionime.com

www.bionime.com



bionime.com

EC REP

Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

Email: EmergoVigilance@ul.com



0197

1
2024-09-18

LOT

2122A0403

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

R

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de
glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)



BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un
usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

30°C
4°C
IVD
10%
90%

101-2GS260-0R0
FR(MA)



N° 25 RDC, RUE LAHCEN EL ARJOUNE
QUARTIER DES HOPITAUX
20360 CASABLANCA, MAROC



BIOMIMÉ

Appliquez une petite goutte de sang clignote.



Insérez la bandelette-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement



Glycémie
Bandelettes-test de



RIGHTEST™

2026-02-20
LOT 212430803

RIGHTEST™

GS260
Bandelettes-test de glycémie

FRIMA
101-2GS260-0R0

GS260
RIGHTEST™
Bandelettes-test de glycémie
Destiné aux épreuves diagnostiques in vitro.
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.
Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%.
Ne pas congeler.
Laissez la notice incluse dans l'emballage avant d'ouvrir le flacon.
Utiliser les bandelettes dans les 3 mois suivant leur fabrication.
Ne pas utiliser après la date d'expiration.
Éliminez les bandeslettes-test correctement après usage unique.

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie
À utiliser avec le glucomètre
RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com



bionime.com

 EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigilance@ul.com



0197



RIGHTEST™

GS260
Bandelettes-test de
glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)



BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie
À utiliser avec le glucomètre
RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com



bionime.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsesgracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigilance@ul.com



0197



RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de
glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)



70,00

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique



101-2GS260-0R0
FR(MA)



RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.



Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME



20360 CASABLANCA, MAROC
N° 25 RDC, RUE LACHENI EL AROUNE
QUARTIER DES HOPITALS





2026-02-20

LOT

212430803

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie



RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)



RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre

RIGHTEST GM260

 **BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan

Tel: +886 4 23692388

Fax: +886 4 22617586

Email: info@bionime.com

www.bionime.com



bionime.com

EC REP

Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

Email: EmergoVigilance@ul.com



0197

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique



101-2GS260-0R0
FR(MA)



RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.



Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME



20360 CASABLANCA, MAROC
N° 25 RDC, RUE LACHENI EL AROUNE
QUARTIER DES HOPITALS





2026-02-20

LOT

212430803

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie



RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)



RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre

RIGHTEST GM260

 **BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daqing St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan

Tel: +886 4 23692388

Fax: +886 4 22617586

Email: info@bionime.com

www.bionime.com



bionime.com

EC REP

Emergo Europe

Prinsessegracht 20

2514 AP The Hague

The Netherlands

Email: EmergoVigilance@ul.com



0197

BIONIME