

## RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

### **Conditions générales :**

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

### **Pharmacie :**

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

### **Radiologie et Biologie :**

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

### **Optique :**

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

### **Rééducation :**

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

### **Dentaire :**

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

### **Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :**

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

### **Adresses Mails utiles**

0 Réclamation

contact@mupras.com



## Déclaration de Maladie

N° W19-573794

66859

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Matricule 517

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

BENABDALLAH Abdelali

Date de naissance :

29/10/1946

Adresse :


76 Bd grande ceinture Aix  
817 B CASABLANCA

Télé. :

06591115586 Total des frais engagés : 4873 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

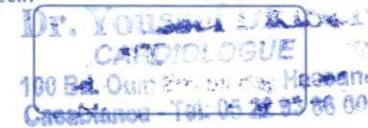

Date de consultation :

Nom et prénom du malade :

ALAOUI LEMRANI AHMED

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

HTN, STG

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA

Signature de l'adhérent(e) : C. moul

Le : 12/10/2021

## **RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES**

## **EXECUTION DES ORDONNANCES**

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>Pharmacie de l'U.P. Tél. 65-22-00 Date 08/04/2011</i>	<i>08/04/2011</i>	<i>44.13 M</i>

## **ANALYSES - RADIOGRAPHIES**

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
10/04/2021 LABORATOIRE KASSI Sidi'wa DE LA CHOUAIB Abdellah 141 Bd Sidi'wa Casablanca Hay El Hissam 1130 Fax: 05 22 94 84 39	20/04/2021	R = 130	160.00

## AUXILIAIRES MEDICAUX



Cachet et signature du Particien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

## RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### **Important :**

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

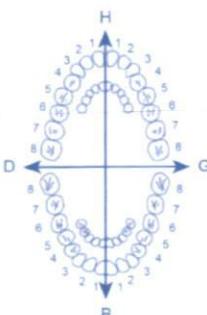SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	INP : <input type="text"/>
				
				COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DEBUT D'EXECUTION <input type="text"/>
				FIN D'EXECUTION <input type="text"/>
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 D 00000000 35533411	G 21433552 00000000 G 00000000 11433553	B	
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			COEFFICIENT DES TRAVAUX <input type="text"/>
				MONTANTS DES SOINS <input type="text"/>
				DATE DU DEVIS <input type="text"/>
				DATE DE L'EXECUTION <input type="text"/>

# Docteur Youssef DRISSI

Spécialiste des maladies  
du Coeur et des Vaisseaux

Ancien Médecin Interne  
des Hôpitaux de Paris

- Holter tensionnel
- Holter rythmique
- Epreuve d'effort
- Echo-doppler cardiaque couleur

LOT: 342  
PER: DEC 2023  
PPV: 89 DH 00

LOT: 342  
PER: DEC 2023  
PPV: 89 DH 00

الدكتور يوسف الديسي

اختصاصي في أمراض القلب

طبيب سابق بمستشفيات

الفحص بالصدى بالألوان

-الهولتر-

Casablanca, le 08.09.21

Cardioaspirine 100 mg/30cps

Acide acetyl/salicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.

Cardioaspirine 100 mg/30cps

Acide acetyl/salicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.

Cardioaspirine 100 mg/30cps

Acide acetyl/salicylique

P.P.V. : 27,70 DH

Bayer S.A.

6 118001 090280

001 090280

18001 090280

Almuni 59 Rami Ahmed

$$180,30 \times 5 = 901,50$$

⑤ Triglycérides 110

$$89 \times 2 = 178$$

⑥ Cholestérol 110

$$27,20 \times 3 = 81,60$$

③ Cardioaspirine 110

$$39,30 \times 4 = 157,20$$

④ Albuterol 110

$$97,60 \times 3 = 292,80$$

⑤ Motil 110

$$99 \times 4 = 396$$

⑥ Vedes 110

$$68,80 \times 3 = 206,40$$

⑦ Amarel 110

97,60

97,60

97,60

الأفق - الحسني - الدار البيضاء

100, bd. Oum Rabii - Résidence Al Ofoq (près de la Pol)  
Tél./Fax : 0522 93 86 00 - الهاتف : E-mail : ydrissi@hotmail.com

Sanofi-aventis Maroc  
Route de Rabat - R.P. 1,  
Aïn sebaâ Casablanca  
Amarel 4 mg, cp b.30  
P.P.V. : 68,80 DH

6 118001 081325  
Aïn sebaâ Casablanca  
Amarel 4 mg, cp b.30  
P.P.V. : 68,80 DH

6 18001 081325

6 18001 081325

⑧ Jamnmet

$$433 \times 4 = 1748$$

⑨ Bundelette glycose

$$150 \times 3 = 450$$

$$\text{TOTAL} = 4413 \text{ Dh}$$



LOT N° :

UT. AV. :

P.P.V

39,30

LOT N° :

UT. AV. :

P.P.V

39,30

09366132/4

LOT N° : 128 + 676

UT. AV. : 12 - 22

P.P.V

39,30

09366132/4

Distribué par MSD MAROC.  
AMM N° : 268/19/DMP/21/NRQ.

P.P.V: 437,00 DH.

Distribué par MSD MAROC.  
AMM N° : 268/19/DMP/21/NRQ.

P.P.V: 437,00 DH.

Distribué par MSD MAROC.  
AMM N° : 268/19/DMP/21/NRQ.  
P.P.V: 437,00 DH.

Distribué par MSD MAROC.  
AMM N° : 268/19/DMP/21/NRQ.  
P.P.V: 437,00 DH.



LOT 200711  
EXP 01/2023  
PPV 99.00DH  
LOT 200711  
EXP 01/2023  
PPV 99.00DH

LOT 200711  
EXP 01/2023  
PPV 99.00DH

LOT 200711  
EXP 01/2023  
PPV 99.00DH



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

للمزيد من المساعدة برجي مراجعة بيانات الاتصال الموجة  
في الصفحة الأخيرة من جهاز المختبر.  
برأي اصحابي بشير، لطالعه المعلومات اساساً في صفحه آخر  
راغباني كاريئر مراجعة تكنو

For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide.  
Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

Damoun Tajhiz Co.  
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,  
Val-e-Ast Ave.,  
Tehran, 1967865637  
Iran  
Phone : +98 21 26218306

ABIAGAIIT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED  
7, MORONU MADUGWU STREET, SURULERE, LAGOS,  
NIGERIA  
TELEPHONE: +2348033131500  
Email: ahs@abiaigait.com  
Website: www.abiaigait.com  
NAFDAC REG. NO: 03-2234

شركة CONTOUR (كونتور) ممثلة تجارية لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
تم تأسيسها في عام 2000

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel, Switzerland

[www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com)  
[www.patents.ascensia.com](http://www.patents.ascensia.com)



90004659

Rev. 10/19



Contour™ plus  
كونتور بلص / كنمور بلص

25

Test Strips

Bandelettes

réactives

شرابط اختبار

نوار تنس

For use with / À utiliser avec:  
للاستخدام مع آلة قياس / جهاز استئصال  
بالأشعة تحت الحمراء  
Contour™ Plus  
Mètres / lecteurs  
كونتور بلص (كونتور بلص)

REF 84627446

1

7635

Contour™ plus  
كونتور بلص / كنمور بلص

Blood Glucose Test Strips  
Bandelettes réactives du glycémie  
شرابط اختبار جلوكوز الدم  
نواراهي تست فند حون

25

Test Strips

Bandelettes

réactives

شرابط اختبار

نوار تنس

NO  
CODING  
SANS CODAGE



Contour™ plus  
كونتور بلص / كنمور بلص

Blood Glucose Test Strips  
Bandelettes réactives du glycémie  
شرابط اختبار جلوكوز الدم  
نواراهي تست فند حون  
For self-testing • Pour l'autosurveillance  
للاختبار الذاتي • جهت خود ياباني



2797



0°C



30°C



IVD



CONTROL | N 109-142 mg/dL

CONTROL | L 36-47 mg/dL

CONTROL | H 316-411 mg/dL

LOT DP9MQHC326

2019-12

2021-12

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

للمزيد من المساعدة برجي مراجعة بيانات الاتصال الموجة  
في الصفحة الأخيرة من جهاز المختبر.  
برأي اصحابي بشير، لطالعه المعلومات المنسوبة في مصحنه آخر  
راغبدي كاربر مراجعة تكتون

For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide.  
Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

Damoun Tajhiz Co.  
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,  
Vali-e-Asr Ave.,  
Tehran, 1967865637  
Iran  
Phone : +98 21 26218306

ABIAGAIIT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED  
7, MORONU MADUGWU STREET, SURULERE, LAGOS,  
NIGERIA  
TELEPHONE: +2348033131500  
Email: ahs@abiaigait.com  
Website: www.abiaigait.com  
NAFDAC REG. NO: 03-2234

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel, Switzerland

[www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com)  
مبيع في الهالن  
[www.patents.ascensia.com](http://www.patents.ascensia.com)

 ASCENSIA  
Diabetes Care

90004659

Rev. 10/19

Contour™  
plus  
كونتور بلص / كنتور بلس

25

Test Strips

Bandelettes  
réactives

شرابط اختبار

نوار تتس

For use with / À utiliser avec:  
للاستخدام مع آلة قياس / جهاز استئصال  
بالتجسس على قياس جلوكوز الدم  
Contour™ Plus  
Meters / lecteurs  
كونتور بلص (كونتور بلس)

REF 84627446

Contour™  
plus  
كونتور بلص / كنتور بلس

Blood Glucose Test Strips  
Bandelettes réactives du glycémie  
شرابط اختبار جلوكوز الدم  
نوارهای تست خود خود

25

Test Strips

Bandelettes  
réactives

شرابط اختبار

نوار تتس

NO  
CODING  
SANS CODAGE



7635

Contour™ plus  
كونتور بلص / كنتور بلس

Blood Glucose Test Strips  
Bandelettes réactives du glycémie  
شرابط اختبار جلوكوز الدم  
نوارهای تست خود خود  
For self-testing • Pour l'autosurveillance  
للاختبار الذاتي • جهت خود يابسني



2797



0°C



30°C



5 016003 763502

CONTROL | N 109-142 mg/dL

CONTROL | L 36-47 mg/dL

CONTROL | H 316-411 mg/dL

LOT DP9MQHC326

2019-12

2021-12

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

للمزيد من المساعدة برجي مراجعة بيانات الاتصال الموجة  
في الصفحة الأخيرة من جهاز المختبر.  
برأي اصحابي بشير، لطالعه المعلومات المنسوبة في مصحنه آخر  
راغبدي كاربر مراجعة تكتون

For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide.  
Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

Damoun Tajhiz Co.  
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,  
Vali-e-Asr Ave.,  
Tehran, 1967865637  
Iran  
Phone : +98 21 26218306

ABIAGAIIT HEALTHCARE SOLUTIONS LIMITED  
7, MORONU MADUGWU STREET, SURULERE, LAGOS,  
NIGERIA  
TELEPHONE: +2348033131500  
Email: ahs@abiaigait.com  
Website: www.abiaigait.com  
NAFDAC REG. NO: 03-2234

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel, Switzerland

[www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com)  
مبيع في الهالن  
[www.patents.ascensia.com](http://www.patents.ascensia.com)

 ASCENSIA  
Diabetes Care

90004659

Rev. 10/19

Contour™  
plus  
كونتور بلص / كنتور بلس

25

Test Strips

Bandelettes  
réactives

شرابط اختبار

نوار تتس

For use with / À utiliser avec:  
للاستخدام مع آلة قياس / جهاز استئصال  
بالتجسس على قياس جلوكوز الدم  
Contour™ Plus  
Meters / lecteurs  
كونتور بلص (كونتور بلس)

REF 84627446

Contour™  
plus  
كونتور بلص / كنتور بلس

Blood Glucose Test Strips  
Bandelettes réactives du glycémie  
شرابط اختبار جلوكوز الدم  
نوارهای تست خود خود

25

Test Strips

Bandelettes  
réactives

شرابط اختبار

نوار تتس

NO  
CODING  
SANS CODAGE



7635

Contour™ plus  
كونتور بلص / كنتور بلس

Blood Glucose Test Strips  
Bandelettes réactives du glycémie  
شرابط اختبار جلوكوز الدم  
نوارهای تست خود خود  
For self-testing • Pour l'autosurveillance  
للاختبار الذاتي • جهت خود يابسني



2797



0°C



30°C



5 016003 763502

CONTROL | N 109-142 mg/dL

CONTROL | L 36-47 mg/dL

CONTROL | H 316-411 mg/dL

LOT DP9MQHC326

2019-12

2021-12

# Docteur Youssef DRISSI

Spécialiste des maladies  
du Coeur et des Vaisseaux

Ancien Médecin Interne  
des Hôpitaux de Paris

- Holter tensionnel
- Holter rythmique
- Epreuve d'effort
- Echo-doppler
- cardiaque couleur



# الدكتور يوسف الإدريسي

اختصاصي في أمراض القلب والشرايين

طبيب سابق بمستشفيات باريس

الفحص بالصدى بالألوان

- الهولتر.

Casablanca, le ٢٠٠٤٢١

Dr. YOUSSEF DRISSI

① ٢٤٣٦٨١٦

② ٩٧٣٦٧٦٣

LABORATOIRE CASA ALFA  
Dr. YOUSSEF DRISSI  
141, Bd Sidi Abderrahmane  
Casablanca - Maroc  
Tél. : 0522 93 86 00 - Fax : 0522 93 86 00

Dr. YOUSSEF DRISSI  
141, Bd Sidi Abderrahmane  
Casablanca - Maroc  
Tél. : 0522 93 86 00 - Fax : 0522 93 86 00

100، شارع أم الربيع - إقامة الأفق - الحي الحسني - الدار البيضاء

100, bd. Oum Rabii - Résidence Al Ofoq (près de la Polyclinique CNSS) Hay Hassani - Casablanca  
Tél./Fax : 0522 93 86 00 - E-mail : ydrissi@hotmail.com - Urgences : 0661 08 02 82  
المستعجلات : 0661 08 02 82



# مختبر التحاليل الطبية البيضاء أنفا

## LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE CASA ANFA

Docteur Salwa LAHLOU KASSI  
Médecin biologiste

د. سلوى لحلو قصبي  
طبيبة إحيائية

### Compte rendu d'analyses

Demandé par Dr : DRISSI Youssef

100, Bd. Oum Rabii – Résidence Al Ofoq (près de la polyclinique CNSS) – Hay Hassani – Casablanca  
Tel : 05.22.93.86.00 Fax :

Casablanca  
Édité le : 10-04-2021

Mme ALAOUI LEMRANI Amina

Date de naissance :  
12-05-1949

Réf : 2104100002

Code Patient : 2104100002



Examen du : 10-04-2021

Heure Plvt : 07:54

Page : 1 / 1

### BIOCHIMIE SANGUINE

#### Glycémie à jeun

( Dosage Colorimétrique – INDIKO Plus – Thermo fisher )

1.40 g/l  
7.77 mmol/l

(0.70–1.10)  
(3.89–6.11)

#### Consensus :

- Taux normal : 0,70g/l – 1,10 g/l
- Diminution de la tolérance au glucose : 1,10g/l – 1,26 g/l
- Sujet diabétique: > 1,26g/l (sur deux prélèvements distincts)

Résultat contrôlé

#### Hémoglobine glyquée (HbA1c)

( Technique HPLC / D10 Biomed )

7.9 %

(4.6–6.3)

#### En cas de diabète :

- Diabète type 1: 7% < HbA1c < 7.5%
- Diabète type 2:
  - \*Sous antidiabétiques oraux : HbA1c < 6.5% ou 7% selon le type de traitement
  - \*Sous insuline : HbA1c < 7%
  - \*Sujet âgé : HbA1c < 8%


A interpréter en fonction de l'âge, du traitement et des facteurs de risques.

Validé par :Dr. LAHLOU KASSI Salwa

Maoz: Vigneswaran 07/04/2021

08/04/2021 12:17:44

59 bpm

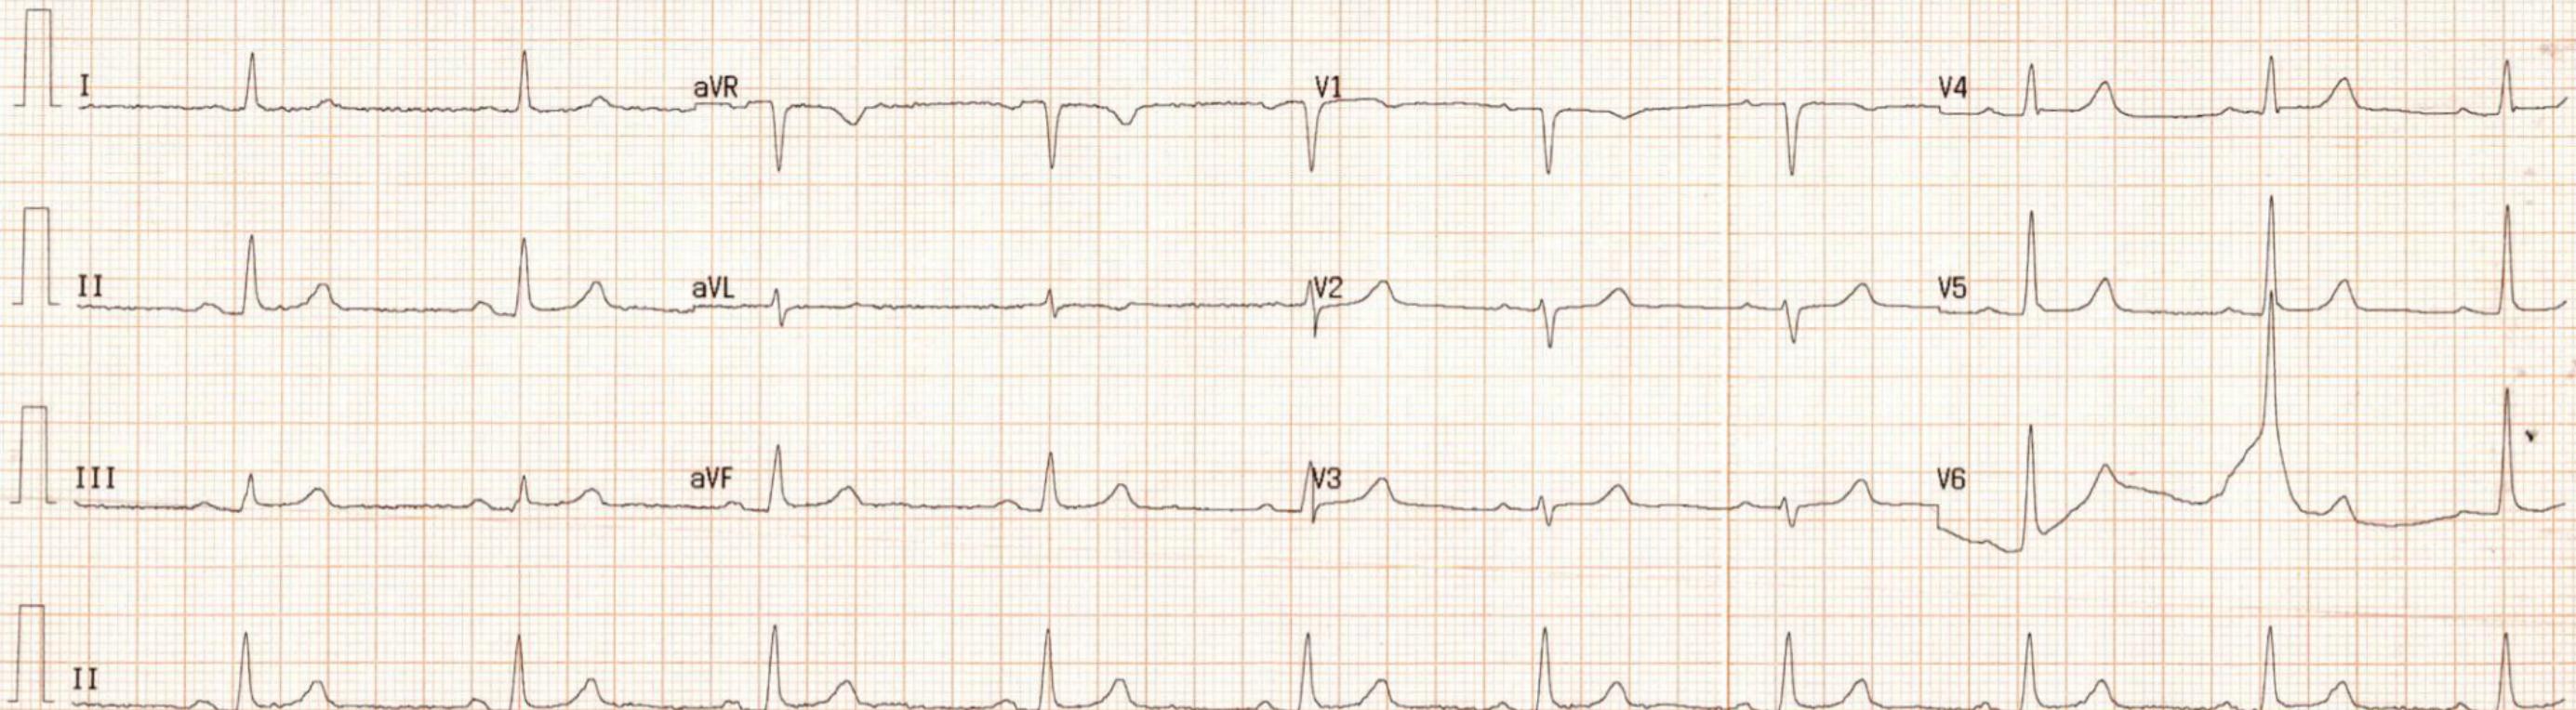

25mm/s 10mm/mV LP: 25Hz AC:50Hz

Cardioline ECG100L 2.01.7025 SN:0628181F

66010055

CARDIOLINE

36.785