

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR TIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

ditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

diologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- ☐ Réclamation : contact@mupras.com
- ☐ Prise en charge : pec@mupras.com
- ☐ Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

N° M21- 0003135

☐ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2769

Société :

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☐ Autre :

Nom & Prénom : BENJIL DRIS

Date de naissance :

Adresse : 38 rue sidi fateh impasse el habacha (A.N)

Tél : 06 05 19 12 06

Total des frais engagés :

Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : 19/07/2021

Nom et prénom du malade : Benjil Driss

Lien de parenté :

☒ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à :

Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
14/07/21		1		 Dr. Mohamed JELLAL 24, Rue de Babouad - CASA Tél. 0522 48 27 08/09

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur

Date

Montant de la Facture

19/07/2021

8.588,40

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue

Date

Désignation des Coefficients

Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien

Date des Soins

Nombre

AM

PC

IM

IV

Montant détaillé des Honoraires

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :


Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées

Nature des
Soins

Coefficient

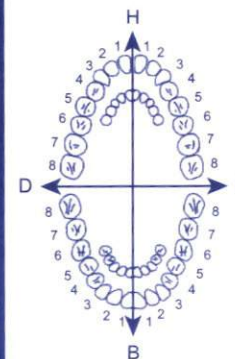

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DEBUT
D'EXECUTION

FIN
D'EXECUTION


O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H
25533412 21433552
00000000 00000000
D 00000000 00000000
35533411 11433553
G
B

(Création, remont, adjonction)

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

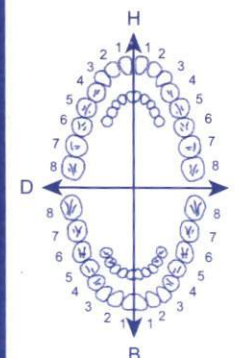

COEFFICIENT
DES TRAVAUX

MONTANTS
DES SOINS

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Mohamed JELLAL

Ex. Assistant C.H.U. St LOUIS Paris

Membre de l'Alfédiem et E.A.S.D.

Diabète - Obésité - Cholestérol - Thyroïde

Tél.: 0522 48 27 88

الدكتور محمد جلال

طبيب سابق بمستشفى سانلويز بباريس

أمراض السكري - السمنة - الكولسترول

الغدة الزرقية

الهاتف: 0522 48 27 88

5590024

5810048

5710026

3130023

3050022

2500022

19800

1500025

8588,40

Inouline Novofix 50

Inouline Novofix 50

Glyric Leo

Modin

Drill niron

Nociceptol gel

Bandette pour plaies

19/07/21

36 u.sur

34 matin

46 midi

2 B6

Casablanca, le

Docteur Mohamed JELLAL
Ex. Assistant C.H.U. St Louis Paris
24, Rue de Bagdad - CASA
Tél. 0522 48 27 88


24، زنقة بغداد (قرب زنقة أكادير ومصطفى المعاني) - الطابق السفلي - الدار البيضاء

24, Rue de Bagdad (ex Damrémont) R.D.C. Angle Rue d'Agadir et Rue Mostafa El Maâni) - Casablanca

BENJIL DRISS

172869


1- insuline novonid





2- insuline novorapid




3- zyloine 200




4- imodium



5 DRILL sirop 25,00



6- Noiceptol



7- Bandelette



EN
- Replace cap immediately.
- Always store strips in container.
- Suitable for self-testing.

ES
- Tape de inmediato después de utilizar.
- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

CZ
- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
Cat. No. : 01GS11

8 809319 390169

PT
- Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

FR
- Refermer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

NL
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

RU
- Незамедлительно закройте крышку после использования.
- Всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

DE
- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

IT
- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

RO
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
- Băndeletele de testare se păstrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

TR
- Kutunun kapagini hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi Kendine testi için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

 0123     2°C (36°F) 32°C (90°F) 

 **25 X 2 TEST**

 Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Donggyeong-daero 1554beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16600,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

  Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR5
Issue date: 2018.05

Blood Glucose Test

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Codefree™

Blood Glucose Test Strip GOLD ELECTRODE

 **SD BIOSENSOR**

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

 / LOT NO.: 90319183
 / MFG DATE: 2019. 09. 18
 / EXP DATE: 2021. 09. 17

EN
- Replace cap immediately.
- Always store strips in container.
- Suitable for self-testing.

ES
- Tape de inmediato después de utilizar.
- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

CZ
- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
Cat. No. : 01GS11

8 809319 390169

PT
- Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

FR
- Refermer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

NL
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

RU
- Незамедлительно закройте крышку после использования.
- Всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

DE
- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

IT
- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

RO
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
- Băndeletele de testare se păstrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

TR
- Kutunun kapagini hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi Kendine testi için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

 0123     2°C (36°F) 32°C (90°F) 

 **25 X 2 TEST**

 Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Donggyeong-daero 1554beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16600,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

  Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR5
Issue date: 2018.05

Blood Glucose Test

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

Codefree™

Blood Glucose Test Strip GOLD ELECTRODE

 **SD BIOSENSOR**

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

 / LOT NO.: 90319183
 / MFG DATE: 2019. 09. 18
 / EXP DATE: 2021. 09. 17

EN
- Replace cap immediately.
- Always store strips in container.
- Suitable for self-testing.

ES
- Tape de inmediato después de utilizar.
- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

CZ
- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
Cat. No. : 01GS11

8 809319 390169

PT
- Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

FR
- Reformer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

NL
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

RU
- Незамедлительно закройте крышку после использования.
- Всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

DE
- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

IT
- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

RO
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
- Băndeletele de testare se păstrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

TR
- Kutunun kapagini hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi Kendine testi için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

 0123     

25 X 2 TEST



Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Donggyeong-daero 1554beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16600,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

ISO 9001

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR5
Issue date: 2018.05

Blood Glucose Test

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Codefree™

Blood Glucose Test Strip GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT / LOT NO.: 90319183
 / MFG DATE: 2019. 09. 18
 / EXP DATE: 2021. 09. 17

EN
- Replace cap immediately.
- Always store strips in container.
- Suitable for self-testing.

ES
- Tape de inmediato después de utilizar.
- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

CZ
- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
Cat. No. : 01GS11

8 809319 390169

PT
- Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

FR
- Reformer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

NL
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

RU
- Незамедлительно закройте крышку после использования.
- Всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

DE
- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

IT
- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

RO
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
- Băndeletele de testare se păstrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

TR
- Kutunun kapagini hemen kapatiniz.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi Kendine test için uygundur.
- Kullanım amacı: Vainiz vucut disı tıbbi tanı.

 0123     

25 X 2 TEST



Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Donggyeong-daero 1554beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16600,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

ISO 13485

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR5
Issue date: 2018.05

Blood Glucose Test

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Codefree™

Blood Glucose Test Strip GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT / LOT NO.: 90319183
 / MFG DATE: 2019. 09. 18
 / EXP DATE: 2021. 09. 17

EN
- Replace cap immediately.
- Always store strips in container.
- Suitable for self-testing.

ES
- Tape de inmediato después de utilizar.
- Guarde siempre las tiras en el envase.
- Apto para el autocontrol.

CZ
- Po otevření ihned uzavřete.
- Uchovávejte v originálním obalu.
- Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
Cat. No. : 01GS11

8 809319 390169

PT
- Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

FR
- Refermer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

NL
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

RU
- Незамедлительно закройте крышку после использования.
- Всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

DE
- Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

IT
- Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

RO
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
- Băndeletele de testare se păstrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

TR
- Kutunun kapagini hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi Kendine testi için uygundur.
- Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

 0123     2°C (36°F) 32°C (90°F) 

25 X 2 TEST



Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Donggyong-daero 1554beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16600,
REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
74, Osongsangmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

 ISO 13485

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR5
Issue date: 2018.05

Blood Glucose Test

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
Codefree™

Blood Glucose Test Strip GOLD ELECTRODE



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

 / LOT NO.: 90319183
 / MFG DATE: 2019. 09. 18
 / EXP DATE: 2021. 09. 17