

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du attestant le Paiement
09/03/2023	MOROCCAN HEART INSTITUTE	1500,00DH	INP : 091026	Driss MBB, FRCS, Chirurgien Vasculaire et Interventionnel 780, Impasse Modiboketa, 0522 85 08 03 - Maroc Tél: 05 22 98 96 96 - Par: 34768459

EXECUTION DES ORDONNANCES			
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Chirurgien Vasculaire et Interventionnel	Montant de la Facture
		Moroccan Heart Institute	Tél: 05 22 98 96 96 - Par: 34768459

ANALYSES - RADIographies


Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Particulier	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

VOLET ADHERENT

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

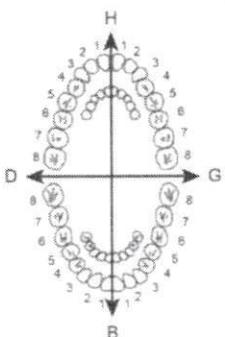

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

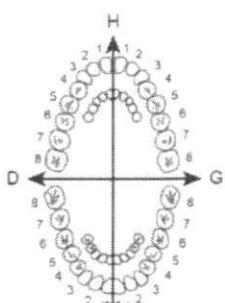

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

H	25533412	21433552
	00000000	00000000
	00000000	00000000
	35533411	11433553
B		

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

COEFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION



المعهد المغربي
لأمراض وجراحة
القلب

CASA LE 08/03/2022

FACTURE N°34/2022

NOM DABJI
PRENOM BOUCHAIB
DATE 08/03/2022
ORGANISME MUPRAS

LIBELLE	Qté	Prix Unitaire	Montant
CONTRÔLE DE PACE MAKER	1	500,00	500,00
TOTAL			500,00

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE:
CINQ CENT DIRHAMS

[Handwritten signature]
MOROCCAN HEART INSTITUTE
780, Impasse Modibo Keita
Tél.: 05 22 83 00 83 / 05 22 85 00 13
Fax : 05 22 98 96 96 - Pat : 34753457



Moroccan Heart Institute 780, Impasse MODIBO KEITA - Casablanca 20520

Tél.: 05 22 85 00 11 / 12 / 13 - Fax : 05 22 83 85 00 - ICE : 001859090000033 - Patente : 34753457 - I.F : 14421718 - CNSS : 9697866

Smartview 3.02 HSO 2.82

08/Mar/2022 - 11.28

Esprit DR W2.92 151ZP0F4

depuis le 31/Août/2012 au 08/Mar/2022

INFORMATIONS GÉNÉRALES**Patient**

Nom	MOROCCAN HEART INSTITUTE 780, Impasse Modibokeita DABJI BOUCHAIB
Sexe	Homme
Date de naissance	20/Juin/1949
Symptôme	Bradycardie
Indication	BAV Complet
Etiologie	Non spécifié
Commentaires	

Implant

Modèle	Esprit DR
Masque	W2.92
Numéro de série	151ZP0F4
Implantation	8/Juin/2012
Centre	


Smartview 3.02 HSO 2.82

08/Mar/2022 - 11:28

Esprit DR W2.92 151ZP0F4

depuis le 31/Août/2012 au 08/Mar/2022

Courbe de pile

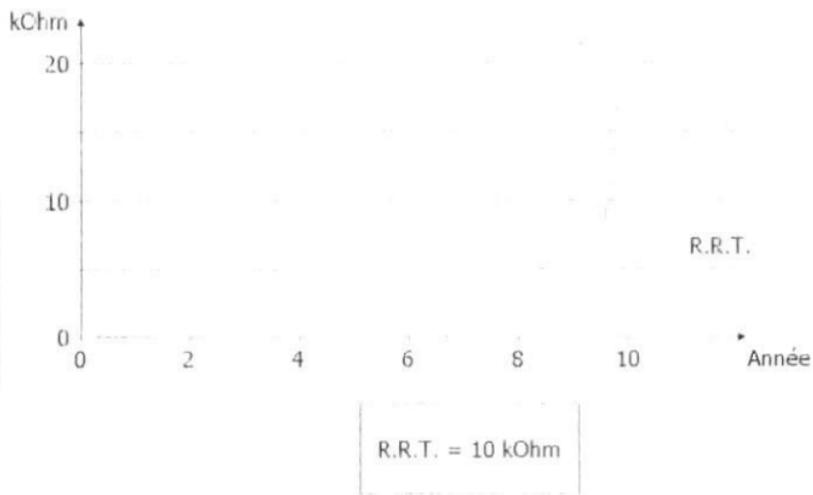

Etat de la pile

Fréquence magnétique	70 min-1
Impédance	22.56 kOhm
R.R.T.	80 min-1
Temps résiduel	<u>Le RRT a été atteint</u>

Smartview 3.02 HSO 2.82
Esprit DR W2.92 151ZP0F4


08/Mar/2022 - 11:28

depuis le 31/Août/2012 au 08/Mar/2022

STATISTIQUES

Statistiques depuis le 31/Août/2012

Ventriculaire

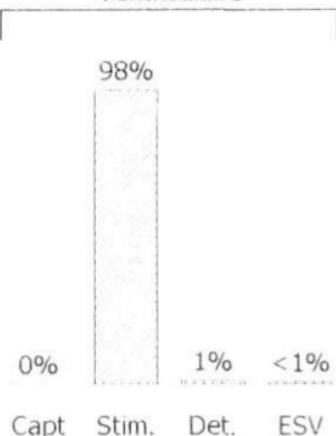

Smartview 3.02 HSO 2.82

08/Mar/2022 - 11:28

Esprit DR W2.92 151ZP0F4

depuis le 31/Août/2012 au 08/Mar/2022

Sondes

	Sonde A	Sonde V
Marque	Oscor Medical	Oscor Medical
Modèle		
Numéro de série	BIUTRF608293	BIU98561
Implantation	8/Juin/2012	8/Juin/2012
Site d'implantation	Non spécifié	Non spécifié

Messages d'avertissements :

Epuisement de la pile détecté

RRT (Indicateur de Remplacement Electif) détecté

Fréquence à l'aimant (min⁻¹) : 70

Ref RA103 La mémoire AIDA n'a pas été activée. Veuillez ouvrir l'écran [Diagnos. AIDA] > [Prog.] pour activer la mémoire AIDA. Les données seront disponibles lors du prochain suivi.

Dr. RAGRAGUI Driss MBBS, FRCS, Ch M.
Chirurgie Cardio-Vasculaire et Interventionnelle
Moroccan Heart Institute
780, Impasse Modibokka - Casablanca
Tél : 05 22 83 00 83 / 05 22 85 00 11
NP : 091119685

Smartview 3.02 HSO 2.82

08/Mar/2022 - 11:28

Esprit DR W2.92 151ZP0F4

depuis le 31/Aout/2012 au 08/Mar/2022

Paramètres de base

	Valeur actuelle	Début de visite
Mode	VV	780 Impasse Modibokeita
Fréq. de base	9 ms	Tél.: 0522 30 00 83 / 0522 85 00 13
Fréquence max	30 ms	Fax: 0522 98 96 96 - Pat: 34753457
Hysteresis	25 mV / Unipolaire	
Sensibilité V	2.5 V / 0.35 ms / Unipolaire	
V Stimulé		
Lissage	Non	
Autosensing A / V	/ Suivi	
Autoseuil V	Non	

MOROCCAN HEART INSTITUTE
780 Impasse Modibokeita
Tél.: 0522 30 00 83 / 0522 85 00 13
Fax: 0522 98 96 96 - Pat: 34753457

Paramètres experts

	Valeur actuelle	Début de visite
Asservissement	Non	

Smartview 3.02 HSO 2.82

08/Mar/2022 - 11:28

Esprit DR W2.92 151ZP0F4

depuis le 31/Août/2012 au 08/Mar/2022

TESTS**Impédance****Impédance****A**376 ohm
31/Août/2012**V**519 ohm
31/Août/2012**Seuil****Seuil****A**0.25 V
31/Août/2012**V**0.35 V
31/Août/2012**Détection****Amplitudes P/R****A**3.56 mV
21/Nov/2021**V**2.82 mV
21/Nov/2021