

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.

Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.

La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.

L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.

En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.

Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.

Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Orthodontie :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.

Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Prothèses :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'entente préalable renseignée sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.

La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.

La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et Atg :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

Réclamation : contact@mupras.com
Prise en charge : pec@mupras.com
Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

N° P19-0034545

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3043 Société : R.A.M.

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : HILALI H. ed

Date de naissance : 23/11/59

Adresse : Imb F8 Apt 213 RSD EL WAHDA

Tél. : 0662097996 Total des frais engagés : 5300,60 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. HAMZA Bachir
Médecine Générale
20, Bd. Hassan II Tissir 1
Tél/Fax: 05 22 32 53 53

Date de consultation : 01/4/2022

Nom et prénom du malade : Hilali Mohamed Age :

Lien de parenté : ☒ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète 2

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : BORDJ le : 01/04/2022

Signature de l'adhérent(e) : [Signature]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
01/04/2022			150,00	Dr. HAMZA Bachir Médecine Générale Bd. Hassan II Tisir 1 Tél/Fax: 05 22 32 53 53

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	04/04/22	5150,00

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX


Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.


Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

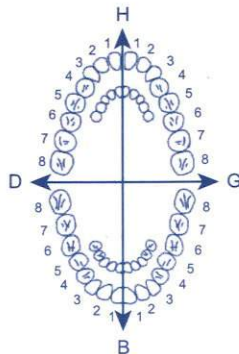SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				COEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE

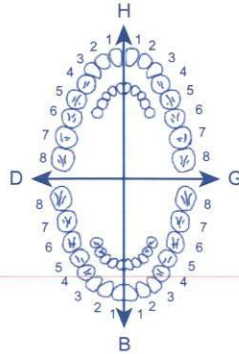	25533412 00000000 00000000 35533411		21433552 00000000 00000000 11433553		
	D		G		

[Création, remont, adjonction]

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXE

Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1
Ain Sebaa 20200 Casablanca
LANTUS SOLISTAR 100U/ml SOL INJ B5
P.P.V. : 744DH00



Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1
Ain Sebaa Casablanca
Lantus Solostar 100U/ml inj
b1 3ty 3ml
P.P.V. : 152,50 DH



Sanofi-aventis Maroc

Route de Rabat - R.P.1
Ain Sebaa Casablanca
Lantus Solostar 100U/ml inj
b1 3ty 3ml
P.P.V. : 152,50 DH



Atelier Médicale
decine du Sport
decine du Travail
certificat Médicale
des Tribunaux

LOT : 719

PER : AUC 2024

PPV : 37 DH 60

الدكتور حم

Tanganil® 500 mg
تاجانيل® 500 مل

30 comprimés - قرص - 30

VTE : MA - PPV : 51DH00



6 118001 183340

ري

الطبية

اضي

غل

لية

المحاكم

728860

6

Berrechid le

برشيد في 2022 / 4

Nom Prénom :

ORDONNANCE

☒ Tanganil® 500 mg

تاجانيل® 500 ملغ

30 comprimés - قرص - 30

VTE : MA - PPV : 51DH00



6 118001 183340

728860

6

Dr. HAMZA Bachir
Médecine Générale
20, Bd. Hassan II Tissir I
Tél/Fax: 05 22 32 53 53

Signé : Dr HAMZA Bachir

20, Bd HASSAN II, Tissir 1

Téléfax: 0522 325353: الهاتف- فاكس

المحمول: 0661 232174

Email : b.hamza55@ gmail.com : البريد الإلكتروني

130x70x67
G0305
6



MAROC



CORÉE DU SUD

Fabriqu  au Maroc par **MediGlobal**®

22 Lot Mauritania, ZI Ain Sebaa
Casablanca Maroc

T l : 05 22 34 32 49 - Fax : 05 22 66.26 53

E-mail : mediglobal@mediglobal.ma

LOT : 190T0108M
EXP : 10/10/2024
REF : MG31-8M100

V rification du bon fonctionnement du dispositif :



1. Faites perler l'insuline (2 unit s) en tenant le stylo vers le haut pour  liminer les bulles d'air.



2. Injectez   angle droit, pour  viter la torsion de l'aiguille, et maintenez l'aiguille sous la peau pendant 10 secondes.

Compatible avec les stylos d'insuline

Certificat Enregistrement : 8243/2018/DMP/02

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

Humalog

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

le l'utilisateur

s/ml KwikPen,
n stylo pré-rempli
lispro

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

vo
l'h
ce
pr
pl
da
• Qui
pas
que
prot
anin
diffi
• Si v
suiv
infirm
- E
- A
- F
• Vos
l'alcool.
• Si vous envisagez de vous rendre à l'étranger, pensez à en informer votre médecin, pharmacien ou personnel infirmier. Le décalage horaire pourrait vous contraindre à modifier vos heures d'injection et de repas par rapport à vos heures habituelles.
• Certains patients avec un diabète de type II ancien et une maladie cardiaque ou un antécédent d'accident vasculaire cérébral, qui étaient traités avec la pioglitazone et l'insuline ont développé une insuffisance cardiaque. Informez votre médecin le plus rapidement possible si vous avez des signes d'insuffisance cardiaque tels qu'un essoufflement inhabituel ou une augmentation rapide de poids ou un gonflement localisé (œdème).
• Il est déconseillé aux personnes aveugles ou malvoyantes d'utiliser ce stylo sans se faire aider par une personne formée à l'utilisation du stylo.

Autres médicaments et Humalog KwikPen

Vos besoins en insuline peuvent être différents si vous prenez

- une pilule contraceptive,
- des corticostéroïdes,
- un traitement substitutif par hormones thyroïdiennes,
- des hypoglycémiantes oraux,
- de l'acide acétylsalicylique,
- des sulfamides antibactériens,
- de l'octréotide,
- des «bêta-», stimulants» (ex. ritrodine, salbutamol ou terbutaline),
- des bêtabloquants ou
- certains antidépresseurs (inhibiteurs de la mono-amine oxydase ou inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine),
- du danazol,
- certains inhibiteurs de l'enzyme de conversion (ex. captopril, énalapril) et
- des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II.

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin (voir rubrique «Avertissements et précautions»).

Grossesse et allaitement

Etes-vous enceinte ou l'envisagez-vous ? Allaitiez-vous ? Les besoins en insuline diminuent généralement durant les trois premiers mois de grossesse et augmentent au cours des six autres mois. Si vous allaitez, l'administration de votre insuline devra peut-être être adaptée ainsi que votre régime alimentaire. Demandez conseil à votre médecin avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Vos capacités de concentration et vos réflexes peuvent être diminués en cas d'hypoglycémie. Vous devez y penser dans toutes les situations où vous pourriez mettre votre vie en danger ou celle d'autres personnes, comme la conduite automobile ou l'utilisation de machines. Vous devez interroger votre médecin sur vos capacités à conduire si vous avez :

- de fréquents épisodes d'hypoglycémie,
- des symptômes annonciateurs d'hypoglycémie diminués ou absents.

3. Comment utiliser Humalog KwikPen

Vérifiez toujours la désignation et le type d'insuline figurant sur

le condi
par votre
d'Humalog

Respecte
de dout
Afin de
doit être

Posolo

- Vous précé
l'injec
la de
Ces
scrup
• Si vo
insuli
pouv
être e
plusie
• Injecte
vous

Prépar

Humalog
mélange
liquide
Vérifiez

Réglage

- Lavez
- Lisez
- remp
- Utilis
- Purg
- perm
- d'air
- est tr

Injecti

- Avan
- instr
- on vi
- l'inje
- de vi
- frotte
- que v
- inject
- d'inje
- d'inje
- Hum
- rap

• Vous ne

Humalog
l'a appris
intraveine
telles qu
votre tau

Après l'ins

- Une fo
- en util
- perme
- empêc
- de l'aig
- stylo, f

Injection

- A cha
- nouve
- Vous
- tenan
- figure
- restan
- Ne mé
- N'utili
- selon

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

LOT D367536H.2
UT AV 01 2024
PPV 111.00 DH

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Humalog®
100 unités/ml
KwikPen™

Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

أكيو-تشيك أكتيف

07124155

٢٠ شريط اختبار



لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

حوالي
٠ ثواني




08996288001 (02)
044x044x080 I

ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

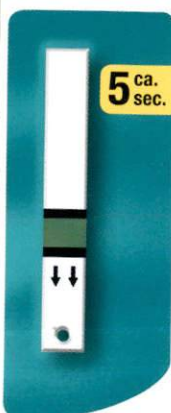

For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active


5 ca.
sec.



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Bandelettes réactives

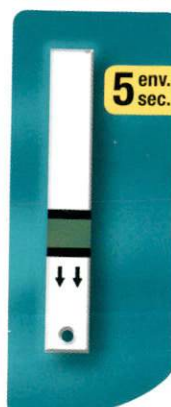

Pour la
détermination
de la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

5 env.
sec.



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 523 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إنش
شارع ساند هوفر ١١٦
٦٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

Roche ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.



+2 °C



REF 07124155019



4 015630 064144

Made in Germany / صنع في ألمانيا
Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



70008057
13
1055875/6111570
FG0010273-122
GD2 350 IV

Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

أكيو-تشيك أكتيف

07124155

٢٠ شريط اختبار



لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

حوالي
٠ ثواني




08996288001 (02)
044x044x080 I

ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

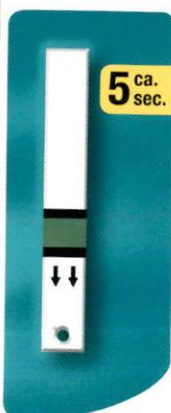

For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active


5 ca.
sec.



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Bandelettes réactives

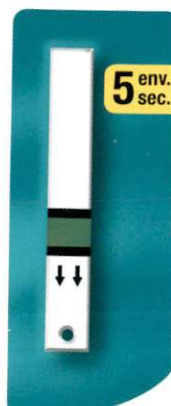

Pour la
détermination
de la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

5 env.
sec.



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 523 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إنش
شارع ساند هوفر ١١٦
١٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

ACCUCHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCUCHEK is a trademark of Roche.

CE 0123



+30 °C
+2 °C

IVD



REF 07124155019



4 015630 064144

Made in Germany / صنع في ألمانيا
Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



70008057
13
1055875/6111570
FG0010273-122
GD2 350 IV

Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

أكيو-تشيك أكتيف

07124155

٢٠ شريط اختبار



لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

حوالي
٠ ثواني




08996288001 (02)
044x044x080 I

ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

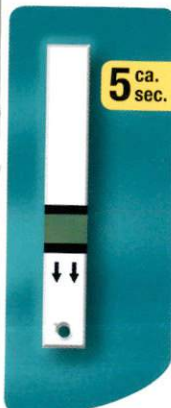

For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active

5 ca.
sec.



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Bandelettes réactives



Pour la
détermination
de la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

5 env.
sec.



70008057
13
1055875/6111570
FG0010273-122
GD2 350 IV



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 523 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إنش
شارع ساند هوفر ١١٦
٦٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

Roche ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.



+30 °C
+2 °C



REF 07124155019



4 015630 064144

Made in Germany / صنع في ألمانيا
Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

أكيو-تشيك أكتيف

07124155

٢٠ شريط اختبار



لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

حوالي
٠ ثواني




08996288001 (02)
044x044x080 I

ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

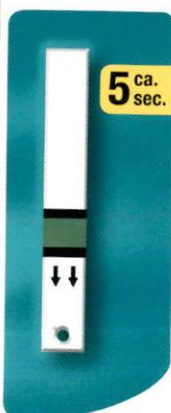

For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active


5 ca.
sec.



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Bandelettes réactives

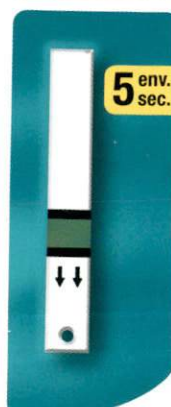

Pour la
détermination
de la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

5 env.
sec.



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 523 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إنش
شارع ساند هوفر ١١٦
١٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

Roche ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.



+2 °C



REF 07124155019



4 015630 064144

Made in Germany / صنع في ألمانيا
Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



70008057
13
1055875/6111570
FG0010273-122
GD2 350 IV

Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

أكيو-تشيك أكتيف

07124155

٢٠ شريط اختبار



لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

حوالي
٠ ثواني




08996288001 (02)
044x044x080 I

ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

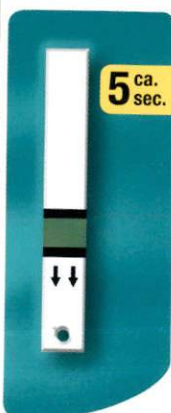

For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active


5 ca.
sec.



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Bandelettes réactives

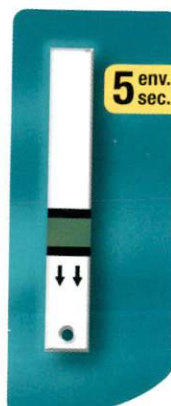

Pour la
détermination
de la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

5 env.
sec.



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 523 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إنش
شارع ساند هوفر ١١٦
١٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

Roche ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.

CE 0123



+2 °C

IVD



REF 07124155019



Made in Germany / صنع في ألمانيا

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



70008057
13
1055875/6111570
FG0010273-122
GD2 350 IV

Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

أكيو-تشيك أكتيف

07124155

٢٠ شريط اختبار



لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف




08996288001 (02)
044x044x080 I

ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

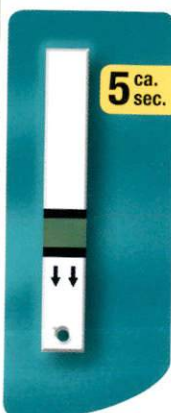


For the
determination
of blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Bandelettes réactives

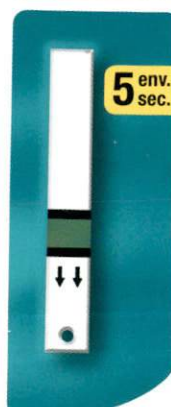

Pour la
détermination
de la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active



70008057
13
1055875/6111570
FG0010273-122
GD2 350 IV



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 523 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إنش
شارع ساند هوفر ١١٦
٦٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

Roche ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.



+2 °C



REF 07124155019



4 015630 064144

Made in Germany / صنع في ألمانيا
Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

أكيو-تشيك أكتيف

07124155

٢٠ شريط اختبار



لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف




08996288001 (02)
044x044x080 I

ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

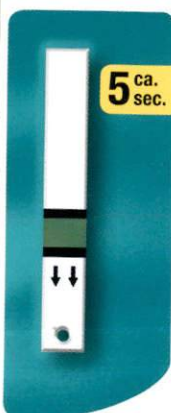


For the
determination
of blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Bandelettes réactives

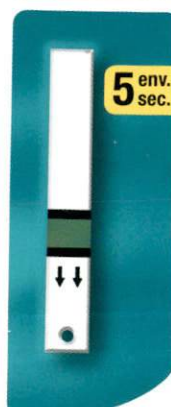

Pour la
détermination
de la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active



70008057
13
1055875/6111570
FG0010273-122
GD2 350 IV



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 523 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إنش
شارع ساند هوفر ١١٦
٦٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.



+2 °C



REF 07124155019



4 015630 064144

Made in Germany / صنع في ألمانيا
Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

أكيو-تشيك أكتيف

07124155

٢٠ شريط اختبار



لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

حوالي
٠ ثواني




08996288001 (02)
044x044x080 I

ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

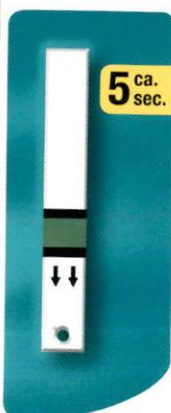

For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active


5 ca.
sec.



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Bandelettes réactives

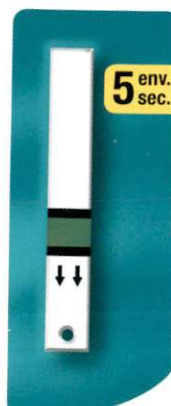

Pour la
détermination
de la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

5 env.
sec.



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 523 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إنش
شارع ساند هوفر ١١٦
١٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

Roche ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.



+2 °C



REF 07124155019



Made in Germany / صنع في ألمانيا

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



70008057
13
1055875/6111570
FG0010273-122
GD2 350 IV

Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

أكيو-تشيك أكتيف

07124155

٢٠ شريط اختبار



لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

حوالي
٠ ثواني




08996288001 (02)
044x044x080 I

ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

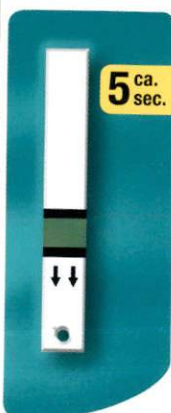

For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active


5 ca.
sec.



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Bandelettes réactives

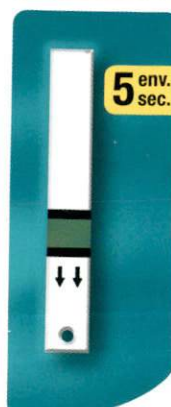

Pour la
détermination
de la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

5 env.
sec.



70008057
13
1055875/6111570
FG0010273-122
GD2 350 IV



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 523 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إنش
شارع ساند هوفر ١١٦
٦٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.



+30 °C
+2 °C



REF 07124155019



Made in Germany / صنع في ألمانيا

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



Close/Re-cap container
tightly immediately after
removing strips.

يرجى إحكام إغلاق العلبة
مباشرة بعد
إخراج شرائط الاختبار.

أكيو-تشيك أكتيف

07124155

٢٠ شريط اختبار



لقياس مستوى
السكر في الدم
مناسب للفحص
الذاتي
يستعمل فقط
مع أكيو-تشيك
أكتيف

حوالي
٠ ثواني




08996288001 (02)
044x044x080 I

ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

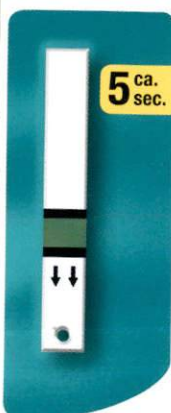

For the
determination of
blood glucose
Suitable for
self-testing
Only for
Accu-Chek® Active


5 ca.
sec.



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Bandelettes réactives

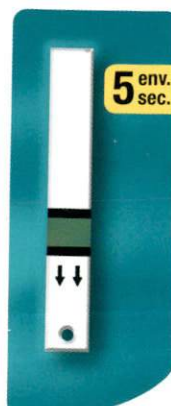

Pour la
détermination
de la glycémie
Utilisable en
autocontrôle
Seulement pour
Accu-Chek® Active

5 env.
sec.



ACCU-CHEK® Active

07124155

25 Test strips

Roche Diabetes Care South Africa (Pty) Ltd.
Hertford Office Park, 90 Bekker Road
Vorna Valley, Midrand
South Africa, 1686
Email: info@accu-chek.co.za
Call Toll Free: 080-34-22-38-37 (SA only);
+254 20 523 0560 (Kenya only);
+27 (11) 504 4677 (Other countries)

روش ديابيتس كير جي إم بي إنش
شارع ساند هوفر ١١٦
٦٨٣٠٠ مانهايم، ألمانيا
www.accu-chek.com

ACCU-CHEK هي علامة تجارية تملكها Roche.
ACCU-CHEK is a trademark of Roche.



+2 °C



REF 07124155019



Made in Germany / صنع في ألمانيا

Roche Diabetes Care GmbH
Sandhofer Strasse 116
68305 Mannheim, Germany
www.accu-chek.com



70008057
13
1055875/6111570
FG0010273-122
GD2 350 IV

04/04/2022



Pharmacie SALIMA

FACTURE N° :1097604-4/2022

hilali mohammed
Tél : 0000000000, BERRECHID

Produit	Date	Qte	Prix unitaire	Total
accuchek 25 test	04/04/2022	10	135.00	1350,00
aiguille 6 mm	04/04/2022	1	170.00	170,00
Prix total				1520.00 Dhs

Pharmacie SALIMA
68, Bd. Lala El Yacout, Tissir II
[Signature]

68,BD LALA YACOUT, TISSIR 2, BERRECHIDE

Tél :05 22 32 85 84

RC : 10094 -- Patente : 40741064 -- CNSS : 8756358 -- ICE : 002007267000019 IF : 93041064