

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
 Prise en charge : pec@mupras.com
 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 [LG] - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

M22- N° 004776

Maladie

Dentaire

Optique

Autres

Cadre réservé à l'adhérent(e)

Matricule : 5079 Société :

Actif Pensionné(e) Autre :

Nom & Prénom : ASSAB ABDALLAH


Date de naissance :

Adresse : 181 LOT HAJ FATEH CASA

Tél. : 0662 207348 Total des frais engagés : 6008,80 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

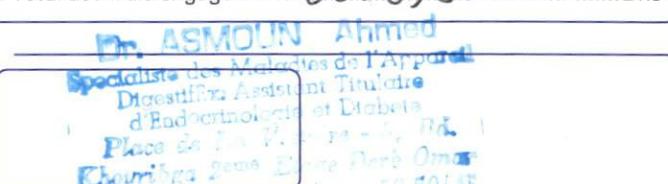

Date de consultation : 19 MAI 2022

Nom et prénom du malade : A 55 ans AL ALLAL Age:

Lien de parenté : Lui-même Conjoint Enfant

Nature de la maladie : Diabète sucré de type 2

Affection longue durée ou chronique : ALD ALC Pathologie :


En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASA Le : 19/05/2022

Signature de l'adhérent(e) :

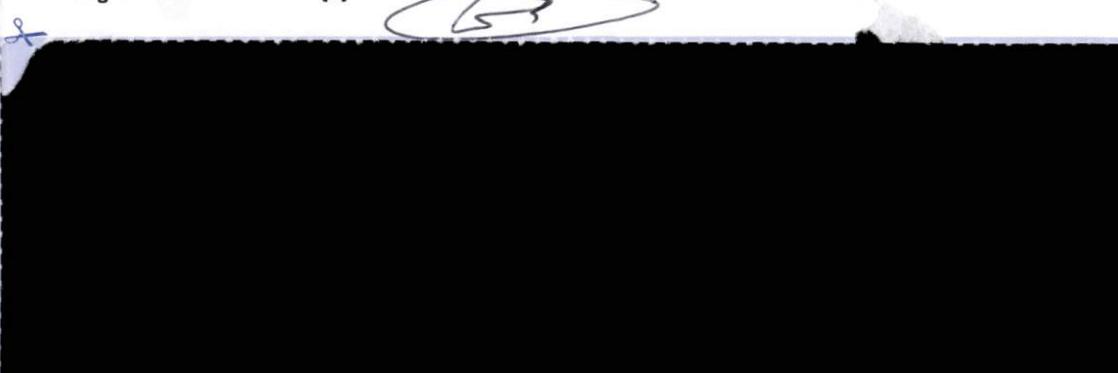

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
10 MAI 2022		4	2000	Dr. ZOUIER Hassan Spécialiste de la Dentisterie et Prostéthique Dentiste à la Clinique de la Dentisterie et Prostéthique Dr. ZOUIER Hassan Rue Lohcen Quadour - Casablanca Tél: 0522 44 37 50

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE LA RESIDENCE Dr. ZOUIER Hassan 149, Anglo-British Residences et Rue Lohcen Quadour - Casablanca Tél: 0522 44 37 50	19/05/2022	5758,80

ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaire, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				Coefficient des travaux
				Montants des soins
				Début d'exécution
				Fin d'exécution
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU COEFFICIENT MASTICATOIRE			
	H 25533412 00000000 35533411	G 21433552 00000000 11433553	B	Coefficient des travaux
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			Montants des soins
				Date du devis
				Date de l'exécution
VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS				VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr ASMOUN Ahmed

SPECIALISTE DES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF

ESTOMAC, FOIE, INTESTIN

Chirurgie anale: Hérmorroïdes, Fistules, Fissures

Endoscopie digestive

Ex ASSISTANT TITULAIRE D'ENDOCRINOLOGIE ET DIABETE

Ex ENSEIGNANT A LA FACULTE DE MEDECINE DE

CASABLANCA

PHARMACIE LA RÉSIDENCE

Dr. ZOUIER Hassan
149, Anglo Bd Hassan II
et Rue Lahcen Ouladier - Casablanca
Tél: 0522 44 37 50

الدكتور أسمون أحمد

إختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي

جراحة المخرج والبواسر

داخلي سابق بقسم أمراض السكر والغدد

مدرس سابق بكلية الطب

بالدار البيضاء

Casablanca le : 19 MAI 2022 الدار البيضاء في :

ASSAD ANAH ALI

$$13,40 \times 4 = 53,60$$

- Levomecy 10 x 30

$$6,80 \times 4 = 27,20$$

- Levomecy 10 x 20

$$571,00 \times 3 = 1713,00$$

- NovoRapid

$$559,00 \times 5 = 2795,00$$

NovoRapid 30 Flux 3ml

30 U/ml

30 U/ml Dr. ASMOUN Ahmed

Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif et Assistant Titulaire

8, Bd Khouribga N° 10 - 2ème Etage Tél : 05 22 31 58 41 / 50 - Fax : 05 22 31 58 50

ICE : 002215254000088

$$97,50 \times 12 = 1170,00$$

Ban de l'île N. 12



en 1 kb, chequ V
4X | |

~~Dr. AEMOUR Ahmed
Spécialiste des Maladies de l'Appareil
Digestif et Anatomie Génitale
d'Endoscopie et Biopsie
Place de l'Indépendance 18, Bd.
Khouribga 9eme étage Dar El Omar
Casablanca Tel: 02.31.58.50.48~~

~~PHARMACIE RÉSIDENCE
Dr. ZOUIER Hassan
149, Anglo Bd de la Résistance
et Rue Ennour Ouarder - Casablanca
Tel: 0522 44 57 50~~



6 118001 102006

Levthyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH



6 118001 102006

Levthyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH



6 118001 102013

Levthyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH



6 118001 102013

Levthyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH



6 118001 102006

Levthyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH



6 118001 102013

Levthyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH



6 118001 102006

Levthyrox® 25 µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 6,80 DH



6 118001 102013

Levthyrox® 50µg,

Comprimés sécables B/30

PPV: 13,40 DH

NovoMix® 30 FlexPen®
100U/ml
Suspension injectable
5 stylos pré-remplis de 3ml
PPV : 559 DH



6 118001 121298

NovoMix® 30 FlexPen®
100U/ml
Suspension injectable
5 stylos pré-remplis de 3ml



6 118001 121298

NovoRapid® FlexPen®
100 U/ml
Solution injectable
5 stylos pré-remplis de 3 ml
PPV : 571,00 DHS



6 118001 121304

NovoMix® 30 FlexPen®
100U/ml
Suspension injectable
5 stylos pré-remplis de 3ml
PPV : 559 DH



6 118001 121298

NovoMix® 30 FlexPen®
100U/ml
Suspension injectable
5 stylos pré-remplis de 3ml
PPV : 559 DH



6 118001 121298

NovoRapid® FlexPen®
100 U/ml
Solution injectable
5 stylos pré-remplis de 3 ml
PPV : 571,00 DHS



6 118001 121304

-- LAPROPHAN --
PPV : 559DH00

8-9670-73-270-2

8-9674-73-270-2

8-9674-73-270-2

8-9674-73-270-2

8-9674-73-270-2

8-9670-73-270-2

8-9670-73-270-2

NovoMix® 30 FlexPen®
100U/ml
suspension injectable
5 stylos pré-remplis de 3ml
PPV : 559 DH



6 118001 121298

NovoRapid® FlexPen®
100 U/ml
Solution injectable
5 stylos pré-remplis de 3 ml
PPV : 571,00 DHS



6 118001 121304

-- groupes de patients --

BIONIME
Blood Glucose Test Strip
Tiras de Análisis para Glucosa en Sangre

Features:

- User friendly design
- Only 1.4 μ L blood sample required
- Less blood means less pain
- Nobel metal Electrode Strip performs high Precision and Accuracy

Características:

- diseño para mejor manejar
- Sólo requiere de una pequeña gota de sangre (1.4 μ L).
- Menos sangre significa menos dolor.
- La Tira de Electrodo de Metal Noble consigue una gran precisión y exactitud.

Use with / Usa con Rightest® GM300

use with GM300 /
usa con GM300

GS300



BIONIME

Blood Glucose Test Strip
Tiras de Análisis para Glucosa en Sangre

Use by 2023-03-14

Lot number 212133119



BIONIME

Blood Glucose Test Strip
Tiras de Análisis para Glucosa en Sangre

**50 PCS (2 vials of 25)
50 piezas(2 frascos de 25)**



Noble Metal Electrode Strip(Smart Code Key included)
Tira Reactiva de Electrodos de Metal Noble
(Clave de Código Inteligente Incluida)

Rightest® GS300

BIONIME

Blood Glucose Test Strip
Tiras de Análisis para Glucosa en Sangre

For *in vitro* diagnostic use
For self-testing and professional use

- Store between temperature 39°F and 86°F (4°C and 30°C)

- Do not freeze
- Read package insert before using
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use


BIONIME
Blood Glucose Test Strip
Tiras de Análisis para Glucosa en Sangre

Para uso diagnóstico *in vitro*
Para autoevaluación y uso profesional

- Almacenar a temperaturas entre 39°F – 86°F (4°C – 30°C)
- No congele
- Leer el instructivo antes de usar
- Utilizar en plazo de 3 meses después de apertura
- No utilizar si la fecha de vencimiento ha pasado
- No utilizar si los sellos están rotos
- Deseche la tira de análisis correctamente después de un solo uso

Rightest® GS300

101-2GS300-148
EN+ES(US)



NHIC (NDC) 08539-0005-01

(10)212133119
(17)230314
(01)00883489001030



BIONIME
Blood Glucose Test Strip
Tiras de Análisis para Glucosa en Sangre

Features:

- User friendly design
- Only 1.4 μ L blood sample required
- Less blood means less pain
- Nobel metal Electrode Strip performs high Precision and Accuracy

Características:

- diseño para mejor manejar
- Sólo requiere de una pequeña gota de sangre (1.4 μ L).
- Menos sangre significa menos dolor.
- La Tira de Electrodo de Metal Noble consigue una gran precisión y exactitud.

Use with / Usa con Rightest® GM300

use with GM300 /
usa con GM300

GS300



BIONIME

Blood Glucose Test Strip
Tiras de Análisis para Glucosa en Sangre

Use by 2023-03-14

Lot number 212133119



BIONIME

Blood Glucose Test Strip
Tiras de Análisis para Glucosa en Sangre

**50 PCS (2 vials of 25)
50 piezas(2 frascos de 25)**



Noble Metal Electrode Strip(Smart Code Key included)
Tira Reactiva de Electrodos de Metal Noble
(Clave de Código Inteligente Incluida)

Rightest® GS300

BIONIME

Blood Glucose Test Strip
Tiras de Análisis para Glucosa en Sangre

For *in vitro* diagnostic use
For self-testing and professional use

- Store between temperature 39°F and 86°F (4°C and 30°C)

- Do not freeze
- Read package insert before using
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use


BIONIME
Blood Glucose Test Strip
Tiras de Análisis para Glucosa en Sangre

Para uso diagnóstico *in vitro*
Para autoevaluación y uso profesional

- Almacenar a temperaturas entre 39°F – 86°F (4°C – 30°C)
- No congele
- Leer el instructivo antes de usar
- Utilizar en plazo de 3 meses después de apertura
- No utilizar si la fecha de vencimiento ha pasado
- No utilizar si los sellos están rotos
- Deseche la tira de análisis correctamente después de un solo uso

Rightest® GS300

101-2GS300-148
EN+ES(US)



NHIC (NDC) 08539-0005-01

(10)212133119
(17)230314
(01)00883489001030



BIONIME
Blood Glucose Test Strip
Tiras de Análisis para Glucosa en Sangre

Features:

- User friendly design
- Only 1.4 μ L blood sample required
- Less blood means less pain
- Nobel metal Electrode Strip performs high Precision and Accuracy

Características:

- diseño para mejor manejar
- Sólo requiere de una pequeña gota de sangre (1.4 μ L).
- Menos sangre significa menos dolor.
- La Tira de Electrodo de Metal Noble consigue una gran precisión y exactitud.

Use with / Usa con Rightest® GM300

use with GM300 /
usa con GM300

GS300



BIONIME

Blood Glucose Test Strip
Tiras de Análisis para Glucosa en Sangre

Use by 2023-03-14

Lot number 212133119



BIONIME

Blood Glucose Test Strip
Tiras de Análisis para Glucosa en Sangre

**50 PCS (2 vials of 25)
50 piezas(2 frascos de 25)**



Noble Metal Electrode Strip(Smart Code Key included)
Tira Reactiva de Electrodos de Metal Noble
(Clave de Código Inteligente Incluida)

Rightest® GS300

BIONIME

Blood Glucose Test Strip
Tiras de Análisis para Glucosa en Sangre

For *in vitro* diagnostic use
For self-testing and professional use

- Store between temperature 39°F and 86°F (4°C and 30°C)

- Do not freeze
- Read package insert before using
- Use within 3 months of opening strip vial
- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken
- Discard test strip properly after single use


BIONIME
Blood Glucose Test Strip
Tiras de Análisis para Glucosa en Sangre

Para uso diagnóstico *in vitro*
Para autoevaluación y uso profesional

- Almacenar a temperaturas entre 39°F – 86°F (4°C – 30°C)
- No congele
- Leer el instructivo antes de usar
- Utilizar en plazo de 3 meses después de apertura
- No utilizar si la fecha de vencimiento ha pasado
- No utilizar si los sellos están rotos
- Deseche la tira de análisis correctamente después de un solo uso

Rightest® GS300

101-2GS300-148
EN+ES(US)



NHIC (NDC) 08539-0005-01

(10)212133119
(17)230314
(01)00883489001030



BIONINE
Blood Glucose Test Strip
2022-09-02
2120A0703

□
[LOT]



BIONINE
Blood Glucose Test Strip

For *in vitro* diagnostic use.

or self-testing and professional use
Store between temperature
4°C and 30°C (39°F and 86°F)

Do not freeze
Read package insert before using

- Use within 3 months of opening strip vial

- Do not use if expiration date has passed

- Do not use if seals are broken

- Discard test strip properly after single use



BIONINE
Blood Glucose Test Strip

Instruction of use GS300

1. Insert the strip into the socket on the top of the meter and wait for the information on the blood glucose meter LCD to appear.

2. After obtaining a blood sample on your finger, gently touch the tip of the strip in order for the blood sample to be absorbed.

BIONINE
Blood Glucose Test Strip

Precision and Accuracy

Features:

- User friendly design
- Only 1 4µL blood sample required
- Less blood means less pain
- Noble metal Electrode Strip performs high precision and accuracy

GS300



BIONINE
Blood Glucose Test Strip
25 PCS (a vial of 25)



BIONINE CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Dading St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +864 22692588
Fax: +864 22617586
<http://www.bionine.com>
E-mail: info@bionine.com



Use with Rightest® GM300

Rightest® GS300



Rightest® GS300

101-265-300-1G2
EN



4 710627 337996

BIONINE
Blood Glucose Test Strip
2022-09-02
2120A0703

□
[LOT]



BIONINE
Blood Glucose Test Strip

For *in vitro* diagnostic use.

or self-testing and professional use
Store between temperature
4°C and 30°C (39°F and 86°F)

Do not freeze
Read package insert before using

- Use within 3 months of opening strip vial

- Do not use if expiration date has passed
- Do not use if seals are broken

- Discard test strip properly after single use



BIONINE
Blood Glucose Test Strip

Instruction of use GS300

1. Insert the strip into the socket on the top of the meter and wait for the information on the blood glucose meter LCD to appear.

2. After obtaining a blood sample on your finger, gently touch the tip of the strip in order for the blood sample to be absorbed.

BIONINE
Blood Glucose Test Strip
Precision and Accuracy

Features:

- User friendly design
- Only 1 4µL blood sample required
- Less blood means less pain
- Noble metal Electrode Strip performs high precision and accuracy

GS300

BIONINE
Blood Glucose Test Strip
25 PCS (a vial of 25)



[Smart Code Key included]



Noble Metal Electrode Strip
[Smart Code Key included]

Rightest™ GS300



BIONINE CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Dading St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +864 22692588
Fax: +864 22617586
<http://www.bionine.com>
E-mail: info@bionine.com



101-265-300-1G2
EN

Use with Rightest™ GM300



BIONINE
Blood Glucose Test Strip
2022-09-02
2120A0703

□
[LOT]



BIONINE
Blood Glucose Test Strip

For *in vitro* diagnostic use.
For self-testing and professional use.
Store between temperature
4°C and 30°C (39°F and 86°F).
Do not freeze.

- Read package insert before using.
- Use within 3 months of opening strip vial.
- Do not use if expiration date has passed.
- Do not use if seals are broken.
- Discard test strip properly after single use.



BIONINE
Blood Glucose Test Strip

Instruction of use GS300

1. Insert the strip into the socket on the top of the meter and wait for the information on the blood glucose meter LCD to appear.

2. After obtaining a blood sample on your finger, gently touch the tip of the strip in order for the blood sample to be absorbed.

BIONINE
Blood Glucose Test Strip

Features:

- User friendly design
- Only 1 4µL blood sample required
- Less blood means less pain
- Noble metal Electrode Strip performs high precision and accuracy

GS300

BIONINE
Blood Glucose Test Strip
25 PCS (a vial of 25)



-
-
-
-
-



Noble Metal Electrode Strip
(Smart Code Key included)

Rightest™ GS300



BIONINE CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Dading St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +864 22692588
Fax: +864 22617586
<http://www.bionine.com>
E-mail: info@bionine.com



101-265-300-1G2
EN

Use with **Rightest™ GM300**



BIONINE
Blood Glucose Test Strip
2022-09-02
2120A0703

□
[LOT]



BIONINE
Blood Glucose Test Strip

For *in vitro* diagnostic use.
For self-testing and professional use.
Store between temperature
4°C and 30°C (39°F and 86°F).
Do not freeze.

- Read package insert before using.
- Use within 3 months of opening strip vial.
- Do not use if expiration date has passed.
- Do not use if seals are broken.
- Discard test strip properly after single use.



BIONINE
Blood Glucose Test Strip

Instruction of use GS300

1. Insert the strip into the socket on the top of the meter and wait for the information on the blood glucose meter LCD to appear.

2. After obtaining a blood sample on your finger, gently touch the tip of the strip in order for the blood sample to be absorbed.

BIONINE
Blood Glucose Test Strip

Features:

- User friendly design
- Only 1 4µL blood sample required
- Less blood means less pain
- Noble metal Electrode Strip performs high precision and accuracy

GS300

BIONINE
Blood Glucose Test Strip
25 PCS (a vial of 25)



-
-
-
-
-



Noble Metal Electrode Strip
(Smart Code Key included)

Rightest™ GS300



BIONINE CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Dading St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +864 22692588
Fax: +864 22617586
<http://www.bionine.com>
E-mail: info@bionine.com



101-265-300-1G2
EN

Use with **Rightest™ GM300**



BIONINE
Blood Glucose Test Strip
2022-09-02
2120A0703

□
[LOT]



BIONINE
Blood Glucose Test Strip

For *in vitro* diagnostic use.
For self-testing and professional use.
Store between temperature
4°C and 30°C (39°F and 86°F).
Do not freeze.

- Read package insert before using.
- Use within 3 months of opening strip vial.
- Do not use if expiration date has passed.
- Do not use if seals are broken.
- Discard test strip properly after single use.



BIONINE
Blood Glucose Test Strip

Instruction of use GS300

1. Insert the strip into the socket on the top of the meter and wait for the information on the blood glucose meter LCD to appear.

2. After obtaining a blood sample on your finger, gently touch the tip of the strip in order for the blood sample to be absorbed.

BIONINE
Blood Glucose Test Strip

Features:

- User friendly design
- Only 1 4µL blood sample required
- Less blood means less pain
- Noble metal Electrode Strip performs high precision and accuracy

GS300

BIONINE
Blood Glucose Test Strip
25 PCS (a vial of 25)



-
-
-
-
-



Noble Metal Electrode Strip
(Smart Code Key included)

Rightest™ GS300



BIONINE CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Dading St., South Dist.,
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +864 22692588
Fax: +864 22617586
<http://www.bionine.com>
E-mail: info@bionine.com



101-265-300-1G2
EN

Use with **Rightest™ GM300**

