

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MUPRAS

Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0010965

☒ Maladie

☐ Dentaire

☐ Optique

☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2069 Société : Royal Air Maroc

☐ Actif

☐ Pensionné(e)

☒ Autre : Retraité

Nom & Prénom : Mr SOUMMIANE Abdessadeq

Date de naissance : 01-01-1949

Adresse : Habituelle

Tél. : 0766 60 67 89
0522 85 65 83

visite diabète : 300Dh + Pharmacie 2016, 90Dh + Para-
Total des frais engagés : - Pharmacie 2016, 90Dh
Total : 4406,90 =

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Dr. Ghita MAMOU
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie Maladies Métaboliques
Nutrition
Espace Soudani 230 Bd. Rouissine Etage N° 19
Casablanca - Tél. : 05 22 23 70 71

Date de consultation :

Nom et prénom du malade : Soummiane Abdessadeq Age :

Lien de parenté :

☐ Lui-même

☐ Conjoint

☐ Enfant

Nature de la maladie : DT2

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Casablanca le 07-11-2022 et Le : 16 / 11 / 2022

Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
16/11/2022	CH		300,00 DH	Dr. Ghita MAHMOUD Spécialiste en Endocrinologie Diabétologie Maladies Métaboliques Espace Roudani 230 Bd. Roudani 4ème Etage N° 19 Casablanca - Tél. : 05 22 23 70 71

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE du 2 MARS Mme. EL ALAOUI Aïcha 575, Av. du 2 Mars Andalous 1 Tél : 05.22.28.57.84 - Casablanca INPE: 092000421	16/11/22	2016,90

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	
	16/11/22					60,90,00

RELEVÉ

La praticien est prié de préciser la de

Important :


Veuillez joindre les radiographies en c

SOINS DENTAIRES

Dents
Traitées


Nature des
Soins

Coefficient

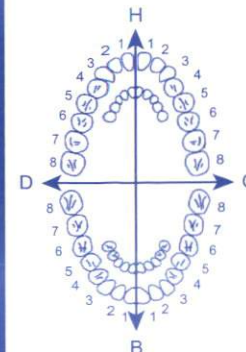

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

DETERMINATION DU CO MASTICATOIRE

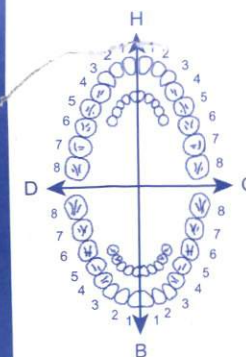

[Création, remont, adj

Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

DATE DU
DEVIS

DATE DE
L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATT

NOCOL 20 mg
60 comprimés pelliculés
Galvus® 50 mg
Boîte de 60 comprimés.
PPV : 390 DH

NOCOL 20 mg
60 comprimés pelliculés
PPV 188DH50

NOCOL 20 mg
30 comprimés pelliculés
97,60

sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Ain Sebaa 20250 - Casablanca
LANTUS SOLOSTAR 100U/ML SOL INJ B5
P.P.V. : 744DH00

Sanofi-aventis Maroc
Route de Rabat - R.P.1
Ain Sebaa Casablanca
Lantus Solostar 100U/ml in
b1 Sty 3ml
P.P.V : 152,50 DH

AMAREL 3MG
CP B30
P.P.V : 92DH10

AMAREL 3MG
CP B30
P.P.V : 92DH10

AMAREL 3MG
CP B30
P.P.V : 92DH10

Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés
28,00

Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés
28,00

Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés
28,00

Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés
28,00

Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés
28,00

Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés
28,00

Glucophage® 1000mg
30 Comprimés pelliculés
28,00

Ghita MAMOU

Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,
Maladies métaboliques et Nutrition

Diabète, Cholestérol, Obésité, Thyroïde, Goitre
Troubles de la croissance et de la puberté
Pathologies surrénaliennes et hypophysaires



الدكتورة غيثة مامو

أخصائية في أمراض الغدد و السكري
أمراض الأيض وطب التغذية

مرض السكري، الكوليستيرول، السمنة
الغدة الدرقية، اختلالات النمو، الغدة النخامية

Casablanca, le : 16/11/2022

Nom : Mr Soummam Abdelaziz

92,10 x 3

Amard 3mg (S.V.)

28000bl 1p le matin

Glucofrase 1g (S.V.)

39000 1 p x 2 JT

Galeus 80 (S.V.)

744,00 1 p JT
152,50

Cantus solus (S.V.)

18850 20 VI le soir

97,60
Nicol 20 (S.V.)
1 p JT

2016,90

PHARMACIE du 2 MARS
Mme. EL ALAOUI Aïcha
575, Av. du 2 Mars Andalous 1
Tél : 05.22.28.57.84 - Casablanca

3mm


Dr. Ghita MAMOU
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie Maladies Métaboliques
Nutrition
Espace Roudani 230 Bd Roudani 4ème Etage N° 19
Casablanca - Tél. : 05 22 23 70 71

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT / LOT NO.: S0321040
 MFG DATE: 2021. 03. 10
 EXP DATE: 2023. 03. 09

10

- Replace cap immediately. **EN**
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- Tape de inmediato después de utilizar. **ES**
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete. **CZ**
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
Cat. No.: 01GS11



- Substituta immediatamente a cápsula. **PT**
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- Refermer immédiatement le bouchon. **FR**
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik. **NL**
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- незамедлительно закройте крышку после использования. **RU**
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- Deckel sofort wieder schliessen. **DE**
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- Richiudere immediatamente il coperchio. **IT**
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Adatto per l'auto test.

- Inchideți recipientul imediat după utilizare. **RO**
 - Bandelele de testare se pastreaza in recipientul original.
 - Se foloseste pentru autotestare.

- Kutunun kapağını hemen kapatınız. **TR**
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine testi için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

CE 0123

IVD

i

⊗

2°C (36°F)

32°C (90°F)

6M

No Coding

Σ 25 X 2 TEST

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
 C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
 Yeongtong-gu, Sewon-si, Gyeonggi-do, 16690,
 REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
 74, Osongsaengmyeong 4-m, Osong-eup,
 Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
 28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

EC REP

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
 Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
 Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021


MB03CF1MLR5
 Issue date: 2018.05

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT / LOT NO.: S0321040
 MFG DATE: 2021. 03. 10
 EXP DATE: 2023. 03. 09

10

- Replace cap immediately. **EN**
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- Tape de inmediato después de utilizar. **ES**
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete. **CZ**
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
Cat. No.: 01GS11



- Substituta immediatamente a cápsula. **PT**
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- Refermer immédiatement le bouchon. **FR**
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik. **NL**
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- незамедлительно закройте крышку после использования. **RU**
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- Deckel sofort wieder schliessen. **DE**
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- Richiudere immediatamente il coperchio. **IT**
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Adatto per l'auto test.

- Inchideți recipientul imediat după utilizare. **RO**
 - Bandelele de testare se pastreaza in recipientul original.
 - Se foloseste pentru autotestare.

- Kutunun kapağını hemen kapatınız. **TR**
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine testi için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

CE 0123

IVD

i

⊗

2°C (36°F)

32°C (90°F)

6M

No Coding

Σ 25 X 2 TEST

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
 C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
 Yeongtong-gu, Seoin-il, Gyeonggi-do, 16690,
 REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
 74, Osongsaengmyeong 4-m, Osong-eup,
 Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
 28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

EC REP

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
 Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
 Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021


M803CF1MLR5
 Issue date: 2018.05

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT / LOT NO.: S0321040
 MFG DATE: 2021. 03. 10
 EXP DATE: 2023. 03. 09

10

- Replace cap immediately. **EN**
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- Tape de inmediato después de utilizar. **ES**
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete. **CZ**
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
Cat. No.: 01GS11



- Substituta immediatamente a cápsula. **PT**
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- Refermer immédiatement le bouchon. **FR**
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik. **NL**
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- незамедлительно закройте крышку после использования. **RU**
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- Deckel sofort wieder schliessen. **DE**
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- Richiudere immediatamente il coperchio. **IT**
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Adatto per l'auto test.

- Inchideți recipientul imediat după utilizare. **RO**
 - Bandelele de testare se pastreaza in recipientul original.
 - Se foloseste pentru autotestare.

- Kutunun kapağını hemen kapatınız. **TR**
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine testi için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

CE 0123

IVD

i

⊗

2°C (36°F) 32°C (90°F)

6M

No Coding

Σ 25 X 2 TEST

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
 C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
 Yeongtong-gu, Sewon-si, Gyeonggi-do, 16690,
 REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
 74, Osongsaengmyeong 4-m, Osong-eup,
 Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
 28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

EC REP

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
 Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
 Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021


M803CF1MLR5
 Issue date: 2018.05

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT / LOT NO.: S0321040
 MFG DATE: 2021. 03. 10
 EXP DATE: 2023. 03. 09

10

- Replace cap immediately. **EN**
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- Tape de inmediato después de utilizar. **ES**
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete. **CZ**
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
 Cat. No.: 01GS11



- Substituta immediatamente a capsula. **PT**
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- Refermer immédiatement le bouchon. **FR**
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik. **NL**
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- незамедлительно закройте крышку после использования. **RU**
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- Deckel sofort wieder schliessen. **DE**
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- Richiudere immediatamente il coperchio. **IT**
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Adatto per l'auto test.

- Inchideți recipientul imediat după utilizare. **RO**
 - Bandelele de testare se pastreaza in recipientul original.
 - Se foloseste pentru autotestare.

- Kutunun kapağını hemen kapatınız. **TR**
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine testi için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

CE 0123

IVD

i

23

32°C (90°F)

6M

No Coding

Σ 25 X 2 TEST

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
 C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
 Yeongtong-gu, Seoin-il, Gyeonggi-do, 16690,
 REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
 74, Osongsaengmyeong 4-m, Osong-eup,
 Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
 28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

EC REP

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
 Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
 Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021


M803CF1MLR5
 Issue date: 2018.05

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT / LOT NO.: S0321040
 MFG DATE: 2021. 03. 10
 EXP DATE: 2023. 03. 09

10

- Replace cap immediately. **EN**
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- Tape de inmediato después de utilizar. **ES**
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete. **CZ**
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
 Cat. No.: 01GS11



- Substituta immediatamente a capsula. **PT**
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- Refermer immédiatement le bouchon. **FR**
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik. **NL**
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- незамедлительно закройте крышку после использования. **RU**
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- Deckel sofort wieder schliessen. **DE**
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- Richiudere immediatamente il coperchio. **IT**
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Adatto per l'auto test.

- Inchideți recipientul imediat după utilizare. **RO**
 - Bandelele de testare se pastreaza in recipientul original.
 - Se foloseste pentru autotestare.

- Kutunun kapağını hemen kapatınız. **TR**
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine testi için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

CE 0123

IVD

i

23

32°C (90°F)

6M

No Coding

Σ 25 X 2 TEST

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
 C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
 Yeongtong-gu, Seoin-il, Gyeonggi-do, 16690,
 REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
 74, Osongsaengmyeong 4-m, Osong-eup,
 Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
 28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

EC REP

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
 Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
 Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021


M803CF1MLR5
 Issue date: 2018.05

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT / LOT NO.: S0321040
 MFG DATE: 2021. 03. 10
 EXP DATE: 2023. 03. 09

10

- Replace cap immediately. **EN**
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- Tape de inmediato después de utilizar. **ES**
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete. **CZ**
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
 Cat. No.: 01GS11



- Substituta immediatamente a capsula. **PT**
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- Refermer immédiatement le bouchon. **FR**
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik. **NL**
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- незамедлительно закройте крышку после использования. **RU**
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- Deckel sofort wieder schliessen. **DE**
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- Richiudere immediatamente il coperchio. **IT**
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Adatto per l'auto test.

- Inchideți recipientul imediat după utilizare. **RO**
 - Bandelele de testare se pastreaza in recipientul original.
 - Se foloseste pentru autotestare.

- Kutunun kapağını hemen kapatınız. **TR**
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine testi için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

CE 0123

IVD

i

23

32°C (90°F)

6M

No Coding

Σ 25 X 2 TEST

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
 C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
 Yeongtong-gu, Seoin-il, Gyeonggi-do, 16690,
 REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
 74, Osongsaengmyeong 4-m, Osong-eup,
 Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
 28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

EC REP

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
 Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
 Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021


M803CF1MLR5
 Issue date: 2018.05

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT / LOT NO.: S0321040
 MFG DATE: 2021. 03. 10
 EXP DATE: 2023. 03. 09

10

- Replace cap immediately. **EN**
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- Tape de inmediato después de utilizar. **ES**
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete. **CZ**
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
 Cat. No.: 01GS11



- Substituta immediatamente a capsula. **PT**
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- Refermer immédiatement le bouchon. **FR**
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik. **NL**
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- незамедлительно закройте крышку после использования. **RU**
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- Deckel sofort wieder schliessen. **DE**
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- Richiudere immediatamente il coperchio. **IT**
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Adatto per l'auto test.

- Inchideți recipientul imediat după utilizare. **RO**
 - Bandelele de testare se pastreaza in recipientul original.
 - Se foloseste pentru autotestare.

- Kutunun kapağını hemen kapatınız. **TR**
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine testi için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

CE 0123

IVD

i

23

32°C (90°F)

6M

No Coding

Σ 25 X 2 TEST

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
 C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
 Yeongtong-gu, Seoin-il, Gyeonggi-do, 16690,
 REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
 74, Osongsaengmyeong 4-m, Osong-eup,
 Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
 28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

EC REP

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
 Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
 Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021


M803CF1MLR5
 Issue date: 2018.05

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT / LOT NO.: S0321040
 MFG DATE: 2021. 03. 10
 EXP DATE: 2023. 03. 09

10

- Replace cap immediately. **EN**
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- Tape de inmediato después de utilizar. **ES**
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete. **CZ**
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
 Cat. No.: 01GS11



- Substituta immediatamente a capsula. **PT**
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- Refermer immédiatement le bouchon. **FR**
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik. **NL**
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- незамедлительно закройте крышку после использования. **RU**
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- Deckel sofort wieder schliessen. **DE**
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- Richiudere immediatamente il coperchio. **IT**
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Adatto per l'auto test.

- Inchideți recipientul imediat după utilizare. **RO**
 - Bandelele de testare se pastreaza in recipientul original.
 - Se foloseste pentru autotestare.

- Kutunun kapağını hemen kapatınız. **TR**
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine testi için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

CE 0123

IVD

i

23

32°C (90°F)

6M

No Coding

Σ 25 X 2 TEST

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
 C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
 Yeongtong-gu, Sewon-si, Gyeonggi-do, 16690,
 REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
 74, Osongsaengmyeong 4-m, Osong-eup,
 Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
 28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

EC REP

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
 Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
 Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021


M803CF1MLR5
 Issue date: 2018.05

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT / LOT NO.: S0321040
 MFG DATE: 2021. 03. 10
 EXP DATE: 2023. 03. 09

10

- Replace cap immediately. **EN**
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- Tape de inmediato después de utilizar. **ES**
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete. **CZ**
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
 Cat. No.: 01GS11



- Substituta immediatamente a capsula. **PT**
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- Refermer immédiatement le bouchon. **FR**
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik. **NL**
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- незамедлительно закройте крышку после использования. **RU**
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- Deckel sofort wieder schliessen. **DE**
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- Richiudere immediatamente il coperchio. **IT**
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Adatto per l'auto test.

- Inchideți recipientul imediat după utilizare. **RO**
 - Bandelele de testare se pastreaza in recipientul original.
 - Se foloseste pentru autotestare.

- Kutunun kapağını hemen kapatınız. **TR**
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine testi için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

CE 0123

IVD

i

⊗

23°C (90°F)

6M

No Coding

Σ 25 X 2 TEST

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
 C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
 Yeongtong-gu, Seoin-il, Gyeonggi-do, 16690,
 REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
 74, Osongsaengmyeong 4-m, Osong-eup,
 Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
 28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

EC REP

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
 Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
 Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021


MB03CF1MLR5
 Issue date: 2018.05

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

CodefreeTM

Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT / LOT NO.: S0321040
 MFG DATE: 2021. 03. 10
 EXP DATE: 2023. 03. 09

10

- Replace cap immediately. **EN**
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- Tape de inmediato después de utilizar. **ES**
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- Po otevření ihned uzavřete. **CZ**
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
Cat. No.: 01GS11

8 809319 390169

- Substituta immediatamente a cápsula. **PT**
 - Guarde sempre as faixas no contentor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- Refermer immédiatement le bouchon. **FR**
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik. **NL**
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.

- незамедлительно закройте крышку после использования. **RU**
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- Deckel sofort wieder schliessen. **DE**
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- Richiudere immediatamente il coperchio. **IT**
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Adatto per l'auto test.

- Inchideți recipientul imediat după utilizare. **RO**
 - Bandelele de testare se pastreaza in recipientul original.
 - Se foloseste pentru autotestare.

- Kutunun kapağını hemen kapatınız. **TR**
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi kendine testi için uygundur.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

CE 0123

IVD

i

⊗

2°C (36°F)

32°C (90°F)

6M

No Coding

Σ 25 X 2 TEST

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
 C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
 Yeongtong-gu, Seoin-il, Gyeonggi-do, 16690,
 REPUBLIC OF KOREA

Manufacturing site
 74, Osongsaengmyeong 4-m, Osong-eup,
 Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
 28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

EC REP

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
 Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
 Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

M803CF1MLR5
 Issue date: 2018.05



Fabriqué au Maroc par **MediGlobal®**

22 Lot Mauritania, ZI Ain Sebaa
Casablanca Maroc

Tél : 05 22 34 32 49 - Fax : 05 22 66 26 53

E-mail : mediglobal@mediglobal.ma

LOT : 01JUL214M
EXP : 07/2026
REF : MG32-4M100

MAROC



CORÉE DU SUD



Medi Fine®

7
mm

32GX100pcs



MediGlobal®

Pour votre bien être

Paroi fine

Sans douleurs

Non toxique

Sans latex

Aiguilles pour stylo d'insuline

أبر قلم الانسولين

Pen needles

Vérification du bon fonctionnement du dispositif :



1. Faites perler l'insuline (2 unités) en tenant le stylo vers le haut pour éliminer les bulles d'air.



2. Injectez à angle droit, pour éviter la torsion de l'aiguille, et maintenez l'aiguille sous la peau pendant 10 secondes.

Compatible avec les stylos d'insuline

PPV: 90.00 DHS

▲ Pull down to dispense ▲
100 Sterile Single Use Lancets

Lancets

Code No. TL30100



Lancets

- Tri bevel tip for a more comfortable sampling
- Universal design fits most lancing devices
- Not made with natural rubber latex

30G

Universal Design
Use Once and Destroy

100 Sterile Single Use Lancets



Lancets


Single Use Only
Sterile Tip

30G

100 Sterile Single Use Lancets



INSTRUCTIONS FOR USE:



1. Wash hands with soap and warm water. Dry thoroughly.
2. Select fingertip site, slightly off-center.
3. Remove protective lancet cover; above (steps 1 & 2).
If seal is already broken discard lancet.
4. Insert lancet into lancing device, use to puncture skin.
5. Apply drop of blood to test strip, wipe excess from finger.
6. Recap lancet, discard in appropriate container.

CE 0123



STERILE R



Shanghai Carelife International Trading Co., Ltd.
1707 Yingqiao Bldg., 58 Jinxin Rd.
201206 Shanghai, CHINA

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537
Hamburg, GERMANY

Made in China



Lancets

LOT: 211018T



: 2026-10-17

WARNING:

Needle is sterile if cap is unopened and undamaged.
Do not use lancet if protective cap have been previously removed.
Do not reuse lancets.
Do not store lancet in lancing device.

100 Sterile Single Use Lancets

▲ Pull down to dispense ▲
100 Sterile Single Use Lancets

Lancets

Code No. TL30100



Lancets

- Tri bevel tip for a more comfortable sampling
- Universal design fits most lancing devices
- Not made with natural rubber latex

30G

Universal Design
Use Once and Destroy

100 Sterile Single Use Lancets



Lancets


Single Use Only
Sterile Tip

30G

100 Sterile Single Use Lancets



INSTRUCTIONS FOR USE:



1. Wash hands with soap and warm water. Dry thoroughly.
2. Select fingertip site, slightly off-center.
3. Remove protective lancet cover; above (steps 1 & 2).
If seal is already broken discard lancet.
4. Insert lancet into lancing device, use to puncture skin.
5. Apply drop of blood to test strip, wipe excess from finger.
6. Recap lancet, discard in appropriate container.

CE 0123



STERILE R



Shanghai Carelife International Trading Co., Ltd.
1707 Yingqiao Bldg., 58 Jinxin Rd.
201206 Shanghai, CHINA

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537
Hamburg, GERMANY

Made in China



Lancets

LOT: 211018T



: 2026-10-17

WARNING:

Needle is sterile if cap is unopened and undamaged.
Do not use lancet if protective cap have been previously removed.
Do not reuse lancets.
Do not store lancet in lancing device.

100 Sterile Single Use Lancets

▲ Pull down to dispense ▲
100 Sterile Single Use Lancets

Lancets

Code No. TL30100



Lancets

- Tri bevel tip for a more comfortable sampling
- Universal design fits most lancing devices
- Not made with natural rubber latex

30G

Universal Design
Use Once and Destroy

100 Sterile Single Use Lancets



Lancets


Single Use Only
Sterile Tip

30G

100 Sterile Single Use Lancets



INSTRUCTIONS FOR USE:



1. Wash hands with soap and warm water. Dry thoroughly.
2. Select fingertip site, slightly off-center.
3. Remove protective lancet cover; above (steps 1 & 2).
If seal is already broken discard lancet.
4. Insert lancet into lancing device, use to puncture skin.
5. Apply drop of blood to test strip, wipe excess from finger.
6. Recap lancet, discard in appropriate container.

CE 0123



STERILE R



Shanghai Carelife International Trading Co., Ltd.
1707 Yingqiao Bldg., 58 Jinxin Rd.
201206 Shanghai, CHINA

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537
Hamburg, GERMANY

Made in China



Lancets

LOT: 211018T



: 2026-10-17

WARNING:

Needle is sterile if cap is unopened and undamaged.
Do not use lancet if protective cap have been previously removed.
Do not reuse lancets.
Do not store lancet in lancing device.

100 Sterile Single Use Lancets

▲ Pull down to dispense ▲
100 Sterile Single Use Lancets

Lancets

Code No. TL30100



Lancets

- Tri bevel tip for a more comfortable sampling
- Universal design fits most lancing devices
- Not made with natural rubber latex

30G

Universal Design
Use Once and Destroy

100 Sterile Single Use Lancets



Lancets


Single Use Only
Sterile Tip

30G

100 Sterile Single Use Lancets



INSTRUCTIONS FOR USE:



1. Wash hands with soap and warm water. Dry thoroughly.
2. Select fingertip site, slightly off-center.
3. Remove protective lancet cover; above (steps 1 & 2).
If seal is already broken discard lancet.
4. Insert lancet into lancing device, use to puncture skin.
5. Apply drop of blood to test strip, wipe excess from finger.
6. Recap lancet, discard in appropriate container.

CE 0123



STERILE R



Shanghai Carelife International Trading Co., Ltd.
1707 Yingqiao Bldg., 58 Jinxin Rd.
201206 Shanghai, CHINA

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537
Hamburg, GERMANY

Made in China



Lancets

LOT: 211018T



: 2026-10-17

WARNING:

Needle is sterile if cap is unopened and undamaged.
Do not use lancet if protective cap have been previously removed.
Do not reuse lancets.
Do not store lancet in lancing device.

100 Sterile Single Use Lancets

▲ Pull down to dispense ▲
100 Sterile Single Use Lancets

Lancets

Code No. TL30100



Lancets

- Tri bevel tip for a more comfortable sampling
- Universal design fits most lancing devices
- Not made with natural rubber latex

30G

Universal Design
Use Once and Destroy

100 Sterile Single Use Lancets



Lancets


Single Use Only
Sterile Tip

30G

100 Sterile Single Use Lancets



INSTRUCTIONS FOR USE:



1. Wash hands with soap and warm water. Dry thoroughly.
2. Select fingertip site, slightly off-center.
3. Remove protective lancet cover; above (steps 1 & 2).
If seal is already broken discard lancet.
4. Insert lancet into lancing device, use to puncture skin.
5. Apply drop of blood to test strip, wipe excess from finger.
6. Recap lancet, discard in appropriate container.

CE 0123



STERILE R



Shanghai Carelife International Trading Co., Ltd.
1707 Yingqiao Bldg., 58 Jinxin Rd.
201206 Shanghai, CHINA

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe)
Eiffestraße 80, 20537
Hamburg, GERMANY

Made in China



Lancets

LOT : 211018T



: 2026-10-17

WARNING:

Needle is sterile if cap is unopened and undamaged.
Do not use lancet if protective cap have been previously removed.
Do not reuse lancets.
Do not store lancet in lancing device.

100 Sterile Single Use Lancets

Dr. Ghita MAMOU

**Spécialiste en Endocrinologie, Diabétologie,
Maladies métaboliques et Nutrition**

Diabète, Cholestérol, Obésité, Thyroïde, Goitre
Troubles de la croissance et de la puberté
Pathologies surrénaliennes et hypophysaires



الدكتورة غيثة مامو

**أخصائية في أمراض الغدد و السكري
أمراض الأيض وطب التغذية**

مرض السكري، الكوليستيرول، السمنة
الغدة الدرقية، اختلالات النمو، الغدة النخامية

Casablanca, le : 16/11/2022

Nom : Dr. Soummane Adesabeg

Agilles olivier f le 1/11 x 3ms

150, Bouteilles de glyc

100x lancettes 6 lancets
2090.00



3ms

Dr. Ghita MAMOU
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie Maladies Métaboliques
Nutrition
Espace Roudani 230 Bd. Roudani 4ème Etage N° 19
Casablanca - Tél. : 05 22 23 70 71

ASSIHA

S.A.R.L

Andalous I, rue 2, N° 10
Bine Lamdoune - Casablanca
Tel : +212 22 85 67 27
Tel / Fax : +212 22 85 09 39

FACTURE N° :2200169

Date :

16/11/2022

SOUMMANE ABDESSADEQ

CASABLANCA

Condition de paiement :

REF	DESIGNATION	QTE	PU T.T.C (Dhs)	Total T.T.C (Dhs)
	SD Bandelette CODE FREE (50U)	10	150,00	1 500,00
	Aiguilles pour stylo à insuline 4mm (bte100U)	1	90,00	90,00
	Lancettes boîte (100U)	5	100,00	500,00

Montant TTC 2 090,00

Arrêtée la présente Facture à la somme de (T.T.C) :
Deux mille quatre vingt dix dirhams

