

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



Déclaration de Maladie

M22- 0024028

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 2769 Société :
☐ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : BENJIL DRIS
Date de naissance :
Adresse : 38 Rue sioufateh impasse El habacha (A.H.)
Tél. : 06-25-19-12-06 Total des frais engagés : Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Docteur Mohamed JELALI
Ex Assistant C.H.U. St Louis Paris
24, Rue de Bagdad - CASABLANCA
Tél. 05 22 48 07 80

Date de consultation : 12/01/2019
Nom et prénom du malade : BENJIL DRIS Age :
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie :
Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le :
Signature de l'adhérent(e) :

Autorisation CNDP N° : A-A-215 / 2019

[illegible]

EXECUTION DES ORDONNANCES		
Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
	21/10/2022	6593,90
	21/10/2022	+ 600,00 = 7193,90

ANALYSES - RADIOGRAPHIES			
Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires
BILOGIE MEDICALE ET RECHERCHES Dr. Hassan II TAZI - Casablanca 0522 26 04 21 0522 27 44 38	24/10/12	B30 + B100 B30 + B30 + S10 S10 + B30 + S10 S10 + B30 + S10	1120,00 1,813



[illegible]

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'ODF.

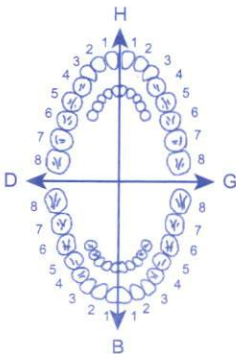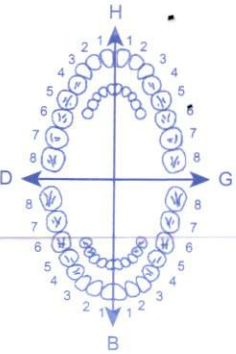SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient														
				COEFFICIENT DES TRAVAUX													
				MONTANTS DES SOINS													
				DEBUT D'EXECUTION													
				FIN D'EXECUTION													
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE			COEFFICIENT DES TRAVAUX													
	<table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">H</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">25533412</td> <td style="text-align: center;">21433552</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">D</td> <td style="text-align: center;">G</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">00000000</td> <td style="text-align: center;">00000000</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">35533411</td> <td style="text-align: center;">11433553</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">B</td> </tr> </table>				H		25533412	21433552	00000000	00000000	D	G	00000000	00000000	35533411	11433553	B
	H																
	25533412	21433552															
	00000000	00000000															
	D	G															
	00000000	00000000															
	35533411	11433553															
	B																
	[Création, remont, adjonction] Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS													
			DATE DU DEVIS														
			DATE DE L'EXECUTION														

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

SOINS DENTAIRES		Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient		
					COEFFICIENT DES TRAVAUX	
					MONTANTS DES SOINS	
					DEBUT D'EXECUTION	
			FIN D'EXECUTION			

O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE	
The diagram shows a top-down view of upper and lower dental arches. Teeth are numbered 1 through 8 on each side, starting from the midline. The upper arch is labeled 'H' at the front and 'D' on the left. The lower arch is labeled 'B' at the front and 'G' on the right.	H 25533412 21433552 00000000 00000000 D ————— G 00000000 00000000 35533411 11433553 B	CCEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession	MONTANTS DES SOINS
		DATE DU DEVIS
		DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur Mohamed JELLAL

Ex. Assistant C.H.U. St LOUIS Paris

Membre de l'Alfédiem et E.A.S.D.

Diabète - Obésité - Cholestérol - Thyroïde

Tél. : **0522 48 27 88**

الدكتور محمد جلال

طبيب سابق بمستشفى سانلويز بباريس

أمراض السكري - السمنة - الكوليسترول

الغدة الدرقية

الهاتف : **0522 48 27 88**

Casablanca, le


PHARMACIE LE PRINTEMPS
Dr. JARMOUNE Ali
0522.26.41.94 / 0522.44.22.79
357 BD TAMAR ALAOUI CASA
INPE: 092049337

Docteur Mohamed JELLAL
Ex. Assistant C.H.U. St Louis Paris
24, Rue de Baghdad - Casablanca
Tél. 0522 48 27 88

24, Rue de Baghdad (ex Damremont) R.D.C. Angle Rue d'Agadir et Rue Mostafa El Maâni) - Casablanca

BENJIL DRISS


insuline novorapid flexpen

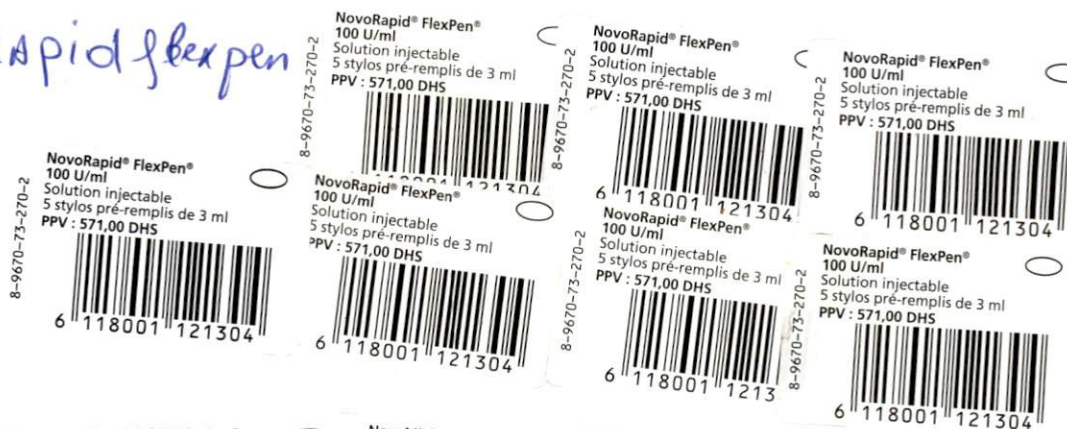

2-insuline novomix 30



3-Zyleric 200



4-Fucidine 250



5-Dipresone

LOT: 645
PER: NOV 2023
PPV: 32 DH 50

6-DRILL

PPV (DH):

PPV (DH):

PPV (DH):

PPV (DH):

↓
25,00

↓
25,00

↓
25,00

↓
25,00

7 Bandelettes



Docteur Mohamed JELLAL

Ex. Assistant C.H.U. St LOUIS Paris

Membre de l'Alfédiem et E.A.S.D.

Diabète - Obésité - Cholestérol - Thyroïde

Tél. : 0522 48 27 88

الدكتور محمد جلال

طبيب سابق بمستشفى سانلويز بباريس

أمراض السكري - السمنة - الكولسترول

الغدة الدرقية

الهاتف : 0522 48 27 88

Casablanca, le

21/10/22

1) 1000 x 4

2) Baudouin

1000 x 4

600,00

Docteur Mohamed JELLAL
Ex. Assistant C.H.U. St Louis Paris
24, Rue de Baghdad - CASA
Tél. 0522 48 27 88

PHARMACIE LE PRINTEMPS
Dr. JARMOUNE Ali
0522.26.47.94 / 0522.44.22.79
357 BD TAHAR ALAOUI CASA
INPE: 092049337

24، زنقة بغداد (قرب زنقة أكادير ومصطفى العاني) - الطابق السفلي - الدار البيضاء

24, Rue de Baghdad (ex Damrémont) R.D.C. Angle Rue d'Agadir et Rue Mostafa El Maâni) - Casablanca

EN Replace cap immediately.
Always store strips in container.
Suitable for self-testing.

ES Tape de inmediato después de utilizar.
Guarde siempre las tiras en el envase.
Apto para el autocontrol.

CZ Po otevření ihned uzavřete.
Uchovávejte v originálním obalu.
Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
Cat. No. : 01GS11



8 809319 390169

PT - Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

FR - Reformer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

NL - Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

RU - незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

DE - Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

IT - Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

RO - Închideți recipientul imediat după utilizare.
- Băndeletele de testare se pastrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

TR - Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine testi için uygundur.
Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.



25 X 2 TEST



Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Oungsaengmyeong 4-ro, Oung-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com



Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLRS
Issue date: 2018.05

OPEN
HERE

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM
Blood Glucose Test Strip

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM
Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT / LOT NO.:

MFG DATE:

EXP DATE:

S0321035
2021. 03. 03
2023. 03. 02

EN Replace cap immediately.
Always store strips in container.
Suitable for self-testing.

ES Tape de inmediato después de utilizar.
Guarde siempre las tiras en el envase.
Apto para el autocontrol.

CZ Po otevření ihned uzavřete.
Uchovávejte v originálním obalu.
Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
Cat. No. : 01GS11



8 809319 390169

PT - Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

FR - Reformer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

NL - Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

RU - незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

DE - Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

IT - Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

RO - Închideți recipientul imediat după utilizare.
- Băndeletele de testare se pastrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

TR - Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine testi için uygundur.
Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.

CE 0123

IVD

i

2°C (36°F)

32°C (90°F)

RoHS

25 X 2 TEST



Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Oungsaengmyeong 4-ro, Oung-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com



Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLRS
Issue date: 2018.05

OPEN
HERE

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM
Blood Glucose Test Strip

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM
Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT / LOT NO.:

MFG DATE:

EXP DATE:

S0321035
2021. 03. 03
2023. 03. 02

EN Replace cap immediately.
Always store strips in container.
Suitable for self-testing.

ES Tape de inmediato después de utilizar.
Guarde siempre las tiras en el envase.
Apto para el autocontrol.

CZ Po otevření ihned uzavřete.
Uchovávejte v originálním obalu.
Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
Cat. No. : 01GS11



8 809319 390169

PT - Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

FR - Reformer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

NL - Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

RU - незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

DE - Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

IT - Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

RO - Închideți recipientul imediat după utilizare.
- Băndeletele de testare se pastrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

TR - Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine testi için uygundur.
Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.



25 X 2 TEST



Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Oungsaengmyeong 4-ro, Oung-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com



Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLRS
Issue date: 2018.05

OPEN
HERE

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM
Blood Glucose Test Strip

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM
Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT / LOT NO.:

MFG DATE:

EXP DATE:

S0321035
2021. 03. 03
2023. 03. 02

EN Replace cap immediately.
Always store strips in container.
Suitable for self-testing.

ES Tape de inmediato después de utilizar.
Guarde siempre las tiras en el envase.
Apto para el autocontrol.

CZ Po otevření ihned uzavřete.
Uchovávejte v originálním obalu.
Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
Cat. No. : 01GS11



8 809319 390169

PT - Substitua imediatamente a cápsula.
- Guarde sempre as faixas no contentor.
- Adequado para o autocontrolo.

FR - Reformer immédiatement le bouchon.
- Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
- Utilisable en autocontrôle.

NL - Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
- Bewaar teststrips altijd in het buisje.
- Geschikt voor zelftesten.

RU - незамедлительно закройте крышку после использования.
- всегда храните полоски в контейнере.
- подходит для самотестирования.

DE - Deckel sofort wieder schliessen.
- Streifen immer in Dose aufbewahren.
- Geeignet zur Eigenanwendung.

IT - Richiudere immediatamente il coperchio.
- Conservare sempre le strisce nel contenitore.
- Adatto per l'auto test.

RO - Închideți recipientul imediat după utilizare.
- Băndeletele de testare se pastrează în recipientul original.
- Se folosește pentru autotestare.

TR - Kutunun kapağını hemen kapatınız.
- Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
- Kendi kendine testi için uygundur.
Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.



Σ 25 X 2 TEST

No Coding



Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-4th&5th, 16, Deogyong-daero 1556beon-gil,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Oungsaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com



Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021

MB03CF1MLR5
Issue date: 2018.05

OPEN
HERE

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM
Blood Glucose Test Strip

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodefreeTM
Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT / LOT NO.:

MFG DATE:

EXP DATE:

S0321035
2021. 03. 03
2023. 03. 02

Docteur Mohamed JELLAL

Ex. Assistant C.H.U. St LOUIS Paris

Membre de l'Alfédiem et E.A.S.D.

Diabète - Obésité - Cholestérol - Thyroïde

Tél.: 0522 48 27 88

الدكتور محمد جلال

طبيب سابق بمستشفى سانلويز بباريس

امراض السكري - السمعة - الكولسترول

الغدة الدرقية

الهاتف: 0522 48 27 88

Casablanca, le

21/10/22

☒ Glycémie à jeun

☒ Glycémie Post-Prandiale
(2 heures après le repas)

☒ Hémoglobine glyquée (Hb A1C)

☐ Fructosamine

☐ Triglycerides

☐ Cholesterol total

HDL

LDL

☒ Urée

☒ Créatinine

☐ Miroalbuminurie sur les urines de 24h

☐ ECBU

☒ TGO/TGP/GGT

☐ Sérologie Hépatite B et C

☒ NFS

☐ Uricémie

☒ PSA

☐ TSH_{U-S}

☐ T₄L

T₃L

☐ Anticorps anti TPO

☐ Anticorps anti recepteurs TSH

☒ Cortisol libre Urinaire

☐ Cortisolémie -8h.....

-16h.....

☐ Prolactinémie à - 10h.....

☐ FSH ☐ LH

☐ IGF₁


☐ Anticorps anti gliadine
antiendomysium

☐ Testosteronémie

☐ 17 OH Progesterone

☐ Dérivés Methoxylées

☒ Calcémie ☒ Phosphoremie

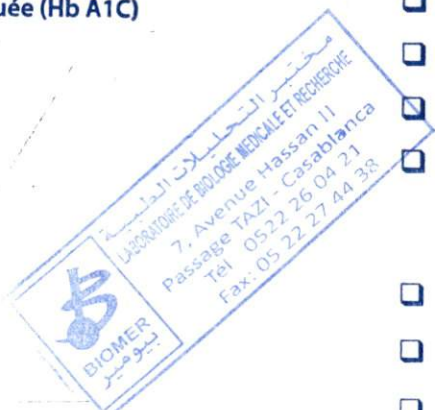

Docteur Mohamed JELLAL
Ex. Assistant C.H.U. St Louis Paris
24, Rue de Baghdad - CASAB
Tél. 0522 48 27 88

24، زنقة بغداد (قرب زنقة أكادير ومصطفى المعاني) - الطابق السفلي - الدار البيضاء

24, Rue de Baghdad (ex Damrémont) R.D.C. Angle Rue d'Agadir et Rue Mostafa El Maâni - Casablanca



مختبر التحليلات الطبية

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE ET RECHERCHE

Dr. BENHAYOUN S. Azzeddine : Pharmacien Biologiste - Ancien Interne des Hôpitaux de REIMS

Membre de la S.F.B.C. - C.E.S. : Hématologie - Bactériologie & Virologie - Immunologie - Parasitologie & Mycologie

Biochimie Clinique - Pathologie Médicale - Biologie de la reproduction Humaine : IAC - Fécondation In Vitro - ICSI

Assurance Qualité Paris V

Facture n° 21X11823

CASABLANCA LE : 24/10/2022

Analyses effectuées le: 24/10/2022

Pour.....: **Mr. BENJLIL DRISS**

Sur prescription du: Dr JELLAL MOHAMED

Code.....: BA5920

Organisme.....: **RAM**



093000123

Bilan:


GLY HBG UREE CREA GOT GPT GGT NFS AU
PST CAL PHOS

Cotation : (B 040)

Montant Net : 1120.00 Dh

ARRETEE LA PRESENTE FACTURE A LA SOMME DE :

MILLE CENT VINGT Dhs 00 Cts



مختبر التحليلات الطبية

LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE ET RECHERCHE

Dr. BENHAYOUN S. Azzeddine : Pharmacien Biologiste - Ancien Interne des Hôpitaux de REIMS
Membre de la S.F.B.C. - C.E.S. : Hématologie - Bactériologie & Virologie - Immunologie - Parasitologie & Mycologie
Biochimie Clinique - Pathologie Médicale - Biologie de la reproduction Humaine : IAC - Fécondation In Vitro - ICSI
D.U Assurance Qualité Paris V

Dossier ouvert le : 24/10/2022

Prélèvement reçu à: 09:18

Edition du : 24/10/2022



Mr. BENJLIL DRISS

Code Patient BA5920 Réf.: 210240641

Médecin: Dr. JELLAL MOHAMED

BIOCHIMIE

INTEGRA 400.ROCHE

Analyses	Résultats	Unités	Normes	Antécédents
Glycémie à jeun	3.12	g/l	(0.70 à 1.10)	2.68g/ (0
ou	17.32	mmol/l	(3.88 à 6.12)	14.87mm (
Hemoglobine Glycosylée	8.6	%	(4.8 A 5.9)	
- UREE.....	0.57	G/L	VN:0.16-0.45 G/L	
ou	9.50	mmol/l	(3.88 à 6.12)	8.16mm (0
Créatinine	18	mg/l	VN :0.27 A 4.20	14mg (04/
ou	159.3	μmol/l	(6 à 13)	123.9μm (
			(52.8 à 114.4)	
Transaminases SGOT	16	UI/l	(< à 49)	18U (01/0
Transaminases SGPT	24	UI/l	(< à 47)	12U (01/0
Gamma G.T.....	19	UI/l	(VN.H JUSQU'A 55UI/L	
			(11 - 48 U/L)	
Acide Urique	30	mg/l	H:34-70 mg/l / f 25-	44mg (04/
ou.....	179.	nmol/l		
Calcium	94	mg/l	(86-104)	
ou	2.35	mmol/l	(2.25 à 2.60)	
Phosphorémie	35	mg/l	(25 à 45)	
ou	1.12	μmol/l	(0.80 à 1.35)	

