

# RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS.

## Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

## Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

## Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu [sous pli confidentiel] doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

## Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

## Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

## Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

## Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

## Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

M22- 0058724

168/88

Optique

Autres

Maladie

Dentaire

### Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 3413

Société :

Actif

Pensionné(e)

Autre :

Nom & Prénom :

GHAOUTA ABDELLOUAHAB

Date de naissance :

01-01-1958

Adresse :

Lotissement El WATAN N° H 91

Tél. 0663.01.90.69

Total des frais engagés : 660,00 Dhs

### Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :

Date de consultation : ..... / ..... / .....

Nom et prénom du malade : ..... Age : .....

Lien de parenté :

Lui-même

Conjoint

Enfant

Nature de la maladie :

Affection longue durée ou chronique :  ALD  ALC Pathologie : .....

En cas d'accident préciser les causes et circonstances : .....

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : 11/07/2023 Le : 11/07/2023

Signature de l'adhérent(e) :



### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes

### EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
<i>LA BOUTIQUE PHARMACEUTIQUE</i> N° DE SÉRIE : 062024810	10/07/23	660.00

### ANALYSES - RADIGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

### AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

### RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

#### Important :

Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	CŒFFICIENT DES TRAVAUX
				<input type="text"/>
<img alt="Diagram of a dental arch with numbered teeth from 1 to 8 in both upper and lower arches				

# LA PHARMACIE REGIONALE

DEROUA

## FACTURE

Pour Mr : Ghaouia Abdellouahab  
 Facture N° : 198841

Date : 10/07/2023


Art	Désignation	Quantité	Prix Unitaire	Montant
1	Kit Bionime <b>S.V</b>	1	120.00	120.00
2	Bionime (Bt 25) <b>S.V</b>	3	60.00	180.00

LA PHARMACIE REGIONALE  
 Imm. 94, Lot NAIT N° 4 - DEROUA Tél: 05 22 51 47 07 • N° du Registre du Commerce 19700 Tribunal de Ber  
 • N° de la Taxe Professionnelle : 55840311 • N° d'Identification Fiscale : 152048858 • N° d'Affiliation à la CNSS : 43492

INPF.06/07/2023 14810

Montant	660.00
T.V.A	
TOTAL T.T.C	660.00

Arrête la présente facture à la somme de :

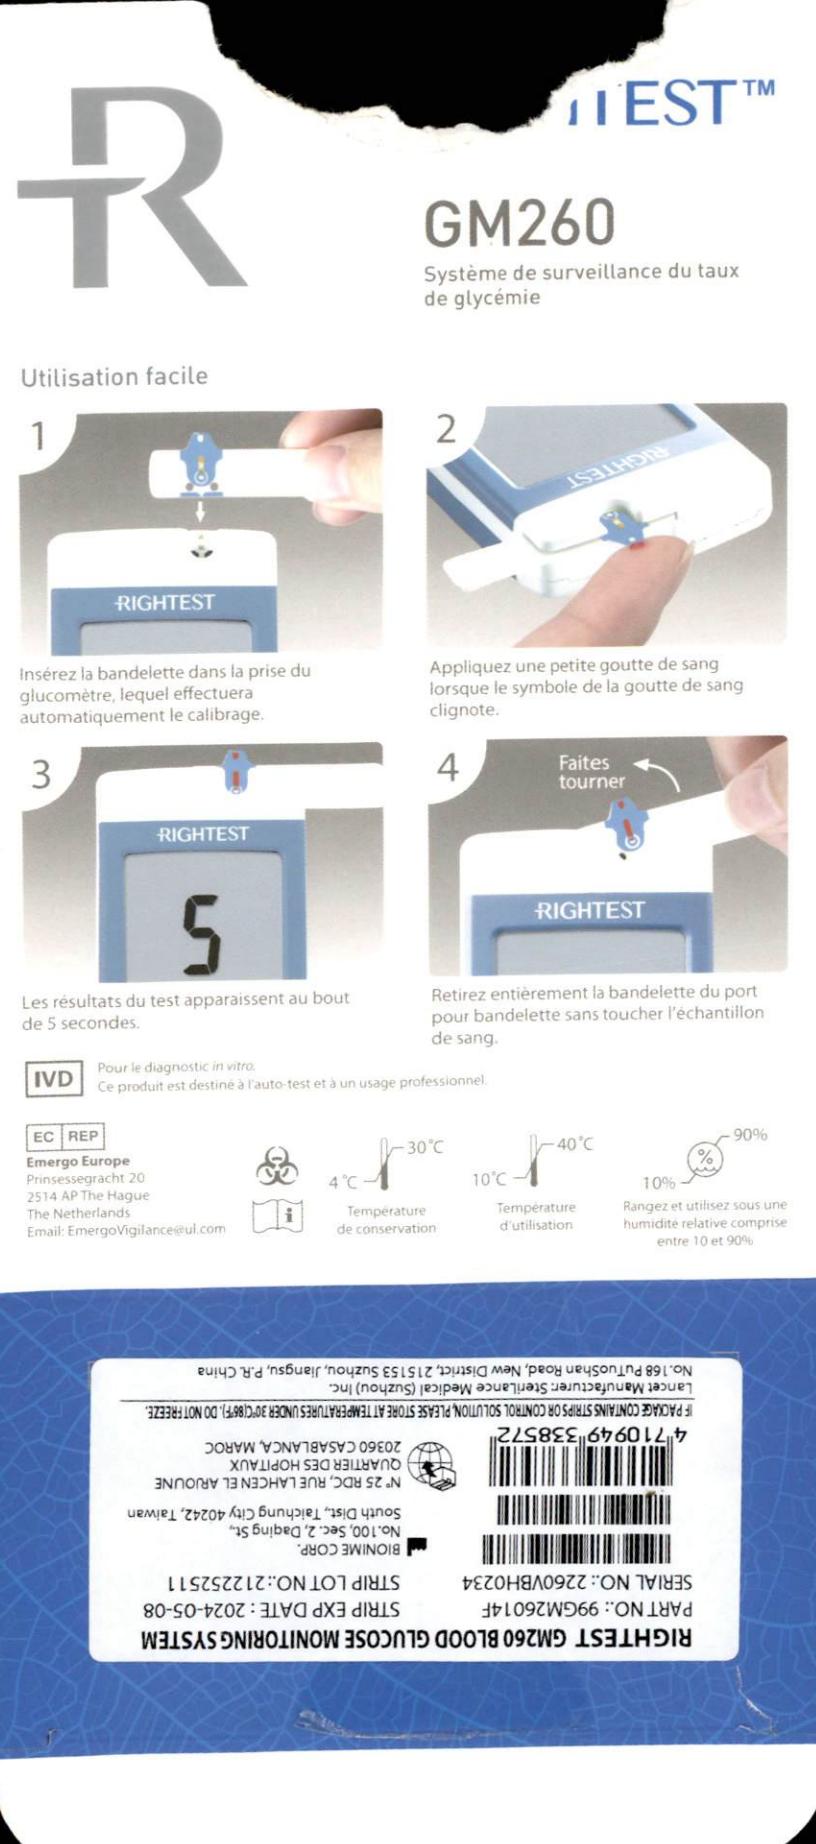

Bandes-test de glycémie

GS260

**RIGHTEST™**

212250509

2024-04-18

LOT

2



**RIGHTEST™**

GS260

Bandes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.



Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

4 710949 1338596



20360 CASABLANCA, MAROC

QUARTIER DES HOPITAUX

N° 25 RDc RUE LALACHEN EL AROUNE



**RIGHTEST™**

GS260

Bandes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daping St., South Dist,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +886 4 23692388  
Fax: +886 4 22617586  
Email: [info@bionime.com](mailto:info@bionime.com) [www.bionime.com](http://www.bionime.com)



bionime.com



0197

BIONIME

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: [EmergoVigilance@ul.com](mailto:EmergoVigilance@ul.com)

Bandes-test de glycémie



**RIGHTEST™**

GS260

Bandes-test de glycémie

25 pcs  
(1 flacon de 25)



**RIGHTEST™**

GS260

Bandes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de la flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 10%

101-2GS260-0R0  
FR(MA)

Bandes-test de glycémie

GS260

**RIGHTEST™**

212250509

2024-04-18

LOT  
2



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de  
glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et  
l'appareil de mesure effectuera  
automatiquement le cryptage  
automatique.



Appliquez une petite goutte de  
sang lorsque le symbole de la  
goutte de sang clignote.

4 710949 1338596

20360 CASABLANCA, MAROC

OUATEUR DES HOPITALS

N° 25 RDc RUE LALACHEN EL AROUNE



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daping St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +886 4 23692388  
Fax: +886 4 22617586  
Email: [info@bionime.com](mailto:info@bionime.com) [www.bionime.com](http://www.bionime.com)



bionime.com



0197

BIONIME

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: [EmergoVigilance@ul.com](mailto:EmergoVigilance@ul.com)

Bandes



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de glycémie

25 pcs  
(1 flacon de 25)



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un  
usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de la flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 10%

101-2GS260-0R0  
FR(MA)

Bandes-test de glycémie

GS260

**RIGHTEST™**

212250509

2024-04-18

LOT

2



**RIGHTEST™**

GS260

Bandes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.



Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

4 710949 1338596



20360 CASABLANCA, MAROC

QUARTIER DES HOPITAUX

N° 25 RDc RUE LALACHEN EL AROUNE



**RIGHTEST™**

GS260

Bandes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daping St., South Dist,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +886 4 23692388  
Fax: +886 4 22617586  
Email: [info@bionime.com](mailto:info@bionime.com) [www.bionime.com](http://www.bionime.com)



bionime.com



0197

BIONIME

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: [EmergoVigilance@ul.com](mailto:EmergoVigilance@ul.com)

Bandes-test de glycémie



**RIGHTEST™**

GS260

Bandes-test de glycémie

25 pcs  
(1 flacon de 25)



**RIGHTEST™**

GS260

Bandes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de la flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 10%

101-2GS260-0R0  
FR(MA)

Bandes-test de glycémie

GS260

**RIGHTEST™**

212250509

2024-04-18

LOT

2



**RIGHTEST™**

GS260

Bandes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.



Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

4 710949 1338596



20360 CASABLANCA, MAROC

QUARTIER DES HOPITAUX

N° 25 RDc RUE LALACHEN EL AROUNE



**RIGHTEST™**

GS260

Bandes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daping St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan

Tel: +864 23692388

Fax: +864 22617586

Email: [info@bionime.com](mailto:info@bionime.com)

[www.bionime.com](http://www.bionime.com)



bionime.com



0197

BIONIME

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: [EmergoVigilance@ul.com](mailto:EmergoVigilance@ul.com)

Bandes



**RIGHTEST™**

GS260

Bandes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)



**RIGHTEST™**

GS260

Bandes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de la flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 10%

101-2GS260-0R0  
FR(MA)

Bandes-test de glycémie

GS260

**RIGHTEST™**

212250509

2024-04-18

LOT

2



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de  
glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et  
l'appareil de mesure effectuera  
automatiquement le cryptage  
automatique.



Appliquez une petite goutte de  
sang lorsque le symbole de la  
goutte de sang clignote.

4 710949 1338596



20360 CASABLANCA, MAROC

QUARTIER DES HOPITAUX

N° 25 RDc RUE LALACHEN EL AROUNE



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daping St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +886 4 23692388  
Fax: +886 4 22617586  
Email: [info@bionime.com](mailto:info@bionime.com) [www.bionime.com](http://www.bionime.com)



bionime.com



0197

BIONIME

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: [EmergoVigilance@ul.com](mailto:EmergoVigilance@ul.com)

Bandes-test de glycémie



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un  
usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de la flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 10%

101-2GS260-0R0  
FR(MA)

Bandes-test de glycémie

GS260

**RIGHTEST™**

212250509

2024-04-18

LOT

2



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de  
glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et  
l'appareil de mesure effectuera  
automatiquement le cryptage  
automatique.



Appliquez une petite goutte de  
sang lorsque le symbole de la  
goutte de sang clignote.

4 710949 1338596



20360 CASABLANCA, MAROC

QUARTIER DES HOPITAUX

N° 25 RDc RUE LALACHEN EL AROUNE



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daping St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +886 4 23692388  
Fax: +886 4 22617586  
Email: [info@bionime.com](mailto:info@bionime.com) [www.bionime.com](http://www.bionime.com)



bionime.com



0197

BIONIME

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: [EmergoVigilance@ul.com](mailto:EmergoVigilance@ul.com)

Bandes



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un  
usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de la flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 10%

101-2GS260-0R0  
FR(MA)

Bandes-test de glycémie

GS260

**RIGHTEST™**

212250509

2024-04-18

LOT

2



**RIGHTEST™**

GS260

Bandes-test de glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.



Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

4 710949 1338596



20360 CASABLANCA, MAROC

QUARTIER DES HOPITAUX

N° 25 RDc RUE LALACHEN EL AROUNE



**RIGHTEST™**

GS260

Bandes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daping St., South Dist,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +886 4 23692388  
Fax: +886 4 22617586  
Email: [info@bionime.com](mailto:info@bionime.com) [www.bionime.com](http://www.bionime.com)



bionime.com



0197

BIONIME

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: [EmergoVigilance@ul.com](mailto:EmergoVigilance@ul.com)

Bandes-test de glycémie



**RIGHTEST™**

GS260

Bandes-test de glycémie

25 pcs  
(1 flacon de 25)



**RIGHTEST™**

GS260

Bandes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de la flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 10%

101-2GS260-0R0  
FR(MA)

Bandes-test de glycémie

GS260

**RIGHTEST™**

212250509

2024-04-18

LOT  
2



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de  
glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et  
l'appareil de mesure effectuera  
automatiquement le cryptage  
automatique.



Appliquez une petite goutte de  
sang lorsque le symbole de la  
goutte de sang clignote.

4 710949 1338596

20360 CASABLANCA, MAROC

OUA

RTER

ES

HTPA

N° 25 RDG RUE LALACHEN EL AROUNE



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daping St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +886 4 23692388  
Fax: +886 4 22617586  
Email: [info@bionime.com](mailto:info@bionime.com) [www.bionime.com](http://www.bionime.com)



bionime.com



0197

BIONIME

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: [EmergoVigilance@ul.com](mailto:EmergoVigilance@ul.com)

Bandes



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de  
glycémie

25 pcs  
(1 flacon de 25)



**RIGHTEST™**

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un  
usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de la flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 10%

101-2GS260-0R0  
FR(MA)

Bandes-test de glycémie

GS260

**RIGHTEST™**

212250509

2024-04-18

LOT

2



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de  
glycémie

Utilisation facile



Insérez la bandelettes-test et  
l'appareil de mesure effectuera  
automatiquement le cryptage  
automatique.



Appliquez une petite goutte de  
sang lorsque le symbole de la  
goutte de sang clignote.

4 710949 1338596



20360 CASABLANCA, MAROC

QUARTIER DES HOPITAUX

N° 25 RDc RUE LALACHEN EL AROUNE



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de glycémie  
À utiliser avec le glucomètre  
RIGHTEST GM260

**BIONIME CORPORATION**

No. 100, Sec. 2, Daping St., South Dist.,  
Taichung City 40242, Taiwan  
Tel: +886 4 23692388  
Fax: +886 4 22617586  
Email: [info@bionime.com](mailto:info@bionime.com) [www.bionime.com](http://www.bionime.com)



bionime.com



0197

BIONIME

EC REP

Emergo Europe  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands  
Email: [EmergoVigilance@ul.com](mailto:EmergoVigilance@ul.com)

Bandes



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de glycémie

25 pcs  
(1 flacon de 25)



**RIGHTEST™**

GS260  
Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*.  
Ce produit est destiné à l'auto-test et à un  
usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de la flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 10%

101-2GS260-0R0  
FR(MA)