RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Réclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge
Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com

Autorisation CNDP N° : A-A-215 /2019

MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance & d'Actions Sociales de Royal Air Maroc

Déclaration de Maladie

M22- 0059440

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 5079 Société : 281661

☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :

Nom & Prénom : ASSAB ABDALLAH

Date de naissance :

Adresse : 182 LOT HAJ FATEH CASA

Tél. : 0662107348 Total des frais engagés : 4413,20 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin : Dr. ASMOUN Ahmed Spécialiste Diplômé d'Etat Place de l'Oratoire Khouribga 2ème Etage Derb Omar Casablanca Tél: 022.31.58.50/48

Date de consultation : 17 / 08 / 23

Nom et prénom du malade : ASSAB Abdallah Age:

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant

Dr ASMOUN Ahmed

Nature de la maladie : Diabète, endocrinologie, nutrition

Affection longue durée ou chronique : ☐ ALD ☐ ALC Pathologie :

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

07 NOV. 2023

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : CASABLANCA **Le :** 17 / 08 / 2023

Signature de l'adhérent(e) :

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Cœfficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
17-08-23	G	1	[illegible]	Dr. ASMOUN Ahmed Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif, Assistant Universitaire Endocrinologie et Diabète 8, Bd. Place de La Victoire 2ème Etage Derb Omar Khouribga Casablanca Tél: 022.31.58.50/41

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
PHARMACIE RÉSIDENTIELLE Dr. ZOUHAIR Hassan 149, Avenue de la Résistance et Rue Lehdaouidder - Casablanca Tél: 0522 44 57 50	17/08/23	4413,20

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Cœfficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		A M	P C	I M	I V	

RELEVE DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canalaires, ainsi que le bilan de l'ODF.

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Cœfficient

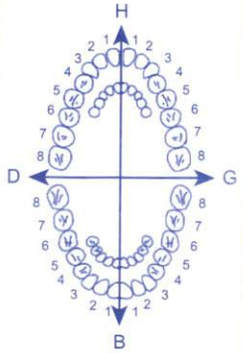

CŒFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DEBUT D'EXECUTION

FIN D'EXECUTION

O.D.F PROTHESES DENTAIRES

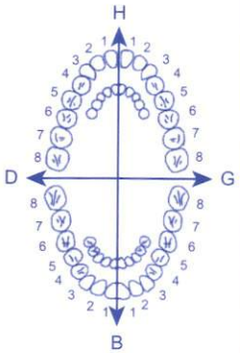

DETERMINATION DU CŒFFICIENT MASTICATOIRE

H

25533412	21433552
00000000	00000000
00000000	00000000
35533411	11433553

D — G

B

(Création, remont, adjonction)
Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession

CŒFFICIENT DES TRAVAUX

MONTANTS DES SOINS

DATE DU DEVIS

DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Dr ASMOUN Ahmed

SPECIALISTE DES MALADIES DE L'APPAREIL DIGESTIF
ESTOMAC, FOIE, INTESTIN
Chirurgie anale: Hémorroïdes, Fistules, Fissures
Endoscopie digestive
Ex ASSISTANT TITULAIRE D'ENDOCRINOLOGIE ET DIABETE
Ex. ENSEIGNANT A LA FACULTE DE MEDECINE DE CASABLANCA

الدكتور أسمون أحمد

إختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي
جراحة المخرج والبواسير
داخلي سابقا بقسم أمراض السكر والغدد
مدرس سابقا بكلية الطب
بالدار البيضاء

PHARMACIE LA RESIDENCE
Dr. ZOUHAIR Hassan
149, Angle Bd Hassan II Résistance
et Rue Lahcen Lyoudi Casablanca
Tél: 05 22 99 87 60

Casablanca le : 17-08-23 الدار البيضاء في :

ASSAB Abdellah

559,00x3=1677,00
S.V Novorapid 30 FlexPen

30 UI matin

571,00x2=1142,00 UI soir
S.V Novorapid

13,40x3=40,20 Levothyrox 50
S.V

6,80x3=20,40 mg
S.V Levothyrox 50

NovoRapid® FlexPen®
100 U/ml
Solution injectable
5 stylos pré-remplis de 3 ml
PPV : 571,00 DHS
8-9670-73-270-2
6 118001 121304

NovoRapid® FlexPen®
100 U/ml
Solution injectable
5 stylos pré-remplis de 3 ml
PPV : 571,00 DHS
8-9670-73-270-2
6 118001 121304

6 118001 102013
Levothyrox® 50µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH
7862160336

6 118001 102013
Levothyrox® 50µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 13,40 DH
7862160336

8, Bd Khouribga N° 10 - 2ème Etage T
ICE : 0022152540

B an Lylilla N. 15

99,50x15 = 1492,50

S.V. cm 1m 3M,

41,10 S.V. Bronchokod

1413 M,

4413,20

Dr. ASMOUN Ahmed
Spécialiste des Maladies de l'Appareil Digestif, Assistant Universitaire d'Endocrinologie et Diabète
Place de la Victoire - 8, Bd. Khouribga 2ème Etage Derb Omar
Casablanca Tél. 022.31.58.50/41

PHARMACIE LA RESIDENCE
Dr. ZOUITNI Hassan
149, Angle Bd de la Résistance et Rue Lehoria Guiddor - Casablanca
Tél. 0522 44 97 50

6 118001 102006
Levothyrox® 25 µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 6,80 DH
7862160335

6 118001 102006
Levothyrox® 25 µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 6,80 DH
7862160335

bronchokod
sans sucre
Adultes
LOT:1170
PER:09/24
PPV:22,90DH

6 118001 102006
Levothyrox® 25 µg,
Comprimés sécables B/30
PPV: 6,80 DH
7862160335

2024-04-18

LOT 212250509

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile

1

Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

2

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

4 710949 338596

N° 25 RDC, RUE LAHCEN EL ARJOUNE
QUARTIER DES HOPITAUX
20360 CASABLANCA, MAROC

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., Sou
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigil

2024-04-18

LOT 212250509

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile

1

Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

2

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

4 710949 338596

N° 25 RDC, RUE LAHCEN EL ARJOUNE
QUARTIER DES HOPITAUX
20360 CASABLANCA, MAROC

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., Sou
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigil

2024-04-18

LOT 212250509

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile

1

Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

2

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

4 710949 338596

N° 25 RDC, RUE LAHCEN EL ARJOUNE
QUARTIER DES HOPITAUX
20360 CASABLANCA, MAROC

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., Sou
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigil

2024-04-18

LOT 212250509

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile

1

Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

2

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

4 710949 338596

N° 25 RDC, RUE LAHCEN EL ARJOUNE
QUARTIER DES HOPITAUX
20360 CASABLANCA, MAROC

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., Sou
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigil

2024-04-18

LOT 212250509

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile

1

Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

2

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

4 710949 338596

N° 25 RDC, RUE LAHCEN EL ARJOUNE
QUARTIER DES HOPITAUX
20360 CASABLANCA, MAROC

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., Sou
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigil

2024-04-18

LOT 212250509

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile

1

Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

2

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

4 710949 338596

N° 25 RDC, RUE LAHCEN EL ARJOUNE
QUARTIER DES HOPITAUX
20360 CASABLANCA, MAROC

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., Sou
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigil

2024-04-18

LOT 212250509

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile

1

Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

2

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

4 710949 338596

N° 25 RDC, RUE LAHCEN EL ARJOUNE
QUARTIER DES HOPITAUX
20360 CASABLANCA, MAROC

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., Sou
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigil

2024-04-18

LOT 212250509

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile

1

Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

2

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

4 710949 338596

N° 25 RDC, RUE LAHCEN EL ARJOUNE
QUARTIER DES HOPITAUX
20360 CASABLANCA, MAROC

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., Sou
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigil

2024-04-18

LOT 212250509

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile

1

Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

2

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

4 710949 338596

N° 25 RDC, RUE LAHCEN EL ARJOUNE
QUARTIER DES HOPITAUX
20360 CASABLANCA, MAROC

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., Sou
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigil

2024-04-18

LOT 212250509

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile

1

Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

2

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

4 710949 338596

N° 25 RDC, RUE LAHCEN EL ARJOUNE
QUARTIER DES HOPITAUX
20360 CASABLANCA, MAROC

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., Sou
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigil

2024-04-18

LOT 212250509

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile

1

Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

2

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

4 710949 338596

N° 25 RDC, RUE LAHCEN EL ARJOUNE
QUARTIER DES HOPITAUX
20360 CASABLANCA, MAROC

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., Sou
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigil

2024-04-18

LOT 212250509

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile

1

Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

2

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

4 710949 338596

N° 25 RDC, RUE LAHCEN EL ARJOUNE
QUARTIER DES HOPITAUX
20360 CASABLANCA, MAROC

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., Sou
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigil

2024-04-18

LOT 212250509

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile

1

Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

2

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

4 710949 338596

N° 25 RDC, RUE LAHCEN EL ARJOUNE
QUARTIER DES HOPITAUX
20360 CASABLANCA, MAROC

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., Sou
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigil

2024-04-18

LOT 212250509

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile

1

Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

2

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

4 710949 338596

N° 25 RDC, RUE LAHCEN EL ARJOUNE
QUARTIER DES HOPITAUX
20360 CASABLANCA, MAROC

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., Sou
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigil

2024-04-18

LOT 212250509

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

25 pcs

(1 flacon de 25)

BIONIME

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Destiné aux épreuves diagnostiques *in vitro*. Ce produit est destiné à l'auto-test et à un usage professionnel.

- Conserver sous une température comprise entre 4 et 30°C (39 et 86°F) et sous une humidité relative comprise entre 10 et 90%
- Ne pas congeler
- Lisez la notice incluse dans l'emballage avant utilisation
- Utilisez les bandelettes dans les 3 mois suivant l'ouverture de le flacon
- Ne pas utiliser passé la date d'expiration
- Ne pas utiliser si l'emballage est ouvert ou endommagé
- Éliminez les bandelettes-tests correctement après usage unique

4°C 30°C IVD 10% 90%

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

Utilisation facile

1

Insérez la bandelettes-test et l'appareil de mesure effectuera automatiquement le cryptage automatique.

2

Appliquez une petite goutte de sang lorsque le symbole de la goutte de sang clignote.

BIONIME

4 710949 338596

N° 25 RDC, RUE LAHCEN EL ARJOUNE
QUARTIER DES HOPITAUX
20360 CASABLANCA, MAROC

RIGHTEST™

GS260

Bandelettes-test de glycémie

À utiliser avec le glucomètre RIGHTEST GM260

BIONIME CORPORATION
No. 100, Sec. 2, Daqing St., Sou
Taichung City 40242, Taiwan
Tel: +886 4 23692388
Fax: +886 4 22617586
Email: info@bionime.com
www.bionime.com

EC REP

Emergo Europe
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands
Email: EmergoVigil

NovoMix® 30 FlexPen®
100U/ml
Suspension injectable
5 stylos pré-remplis de 3ml
PPV : 559 DH

8-9674-73-270-2

6 118001 121298

NovoMix® 30 FlexPen®
100U/ml
Suspension injectable
5 stylos pré-remplis de 3ml
PPV : 559 DH

8-9674-73-270-2

6 118001 121298

NovoMix® 30 FlexPen®
100U/ml
Suspension injectable
5 stylos pré-remplis de 3ml
PPV : 559 DH

8-9674-73-270-2

6 118001 121298