

ACC

 MIL: 512
 0619449632

DEVIS N° 02/24

DATE DU DEVIS:

18/01/2024

DEVIS ÉMIS PAR
LINX Technologie

ICE : 002818625000027

54, 1er étage, avenue Mohammed V Tabriquet, SALE


RC : 33883 - IF : 50287043 - TP : 29001887

DESTINATAIRE
MR EL MOUMI MOULAY ABDESLAM
Agence

DÉSIGNATION	QUANTITÉ	TVA (%)	PRIX UNIT. HT	REMISE (%)	TOTAL HT
ART0052 MASQUE	1	20.00	1,250.00	0.00	1,250.00
			Total HT		1,250.00
			TVA (20%)		250.00
			Total TTC		1,500.00

ARRÊTER LE PRÉSENT DEVIS À LA SOMME DE

MILLE CINQ CENTS DIRHAMS

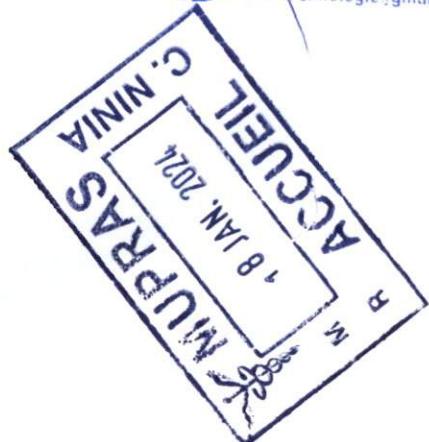
 LINX TECHNOLOGIE
 54 AVENUE MOHAMMED V.
 TABRIQUET SALE
 0537856198 / 0660550179
 Linxtechnologie@gmail.com


Docteur Mustapha TOUHAMI

Professeur titulaire

ORL et Chirurgie cervico-faciale
Chirurgie maxillo-faciale

Diplômé de la faculté de médecine de Bordeaux
Ancien Médecin Chef de l'hôpital d'Orteils
Ex-Chef du service de chirurgie maxillo-faciale
et ORL de Casablanca.

الدكتور مصطفى النهامي

أستاذ

أمراض وجراحة الأنف والحنجرة
وتحريحة المعنق والوجه

مصح كتبة الطب بيورن لافرب


رئيس مادر لمستشفى الأمان ورئيس مدرسة طب التخصصية
للتلف والوجه بالمركز الاستشاري والجامعي بدار البيضاء

Casablanca le : 17/01/2024

MR EL MOUMI MOULAY ABDESLAM

Syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil

Masque de CPAP

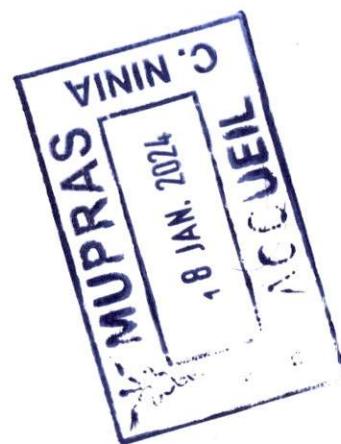

Docteur Mustapha Touhami
ORL et Chirurgie cervico-faciale
Chirurgie maxillo-faciale
76, Bd Abdellmoumen - Casablanca
Tel 0522 09 82 02

Résidence Koutoubia - 76, Bd. Abdellmoumen - 4ème Etage - Casablanca
إقامة التكفيية - 76 شارع عبد المومن - الطابق الرابع - الدار البيضاء
Tél: 0522 09 82 02 / 0522 09 49 24 - E-mail : motouhami@gmail.com
Patente : 24776408 - Identifiant Fiscale : 42600044 - ICF : 001697905000026

Le 28/12/2023

Rapport de l'observance et de l'efficacité de traitement par PPC

Nom : EL MOUMI
Prénom : Moulay Abdeslam
IAH avant la mise sous PPC: 15,2/h – IAH dorsale 48,5/h.
Index des apnée-hypopnées résiduelles sous PPC : 5,3/h.

Appareil PPC : EcoStar Auto³ 1184R19502446
Logiciel : DreamStar Analyze Version 5.2.0


- Premier réglage et mise en place le 13/06/2022.
- Début de l'utilisation de l'appareil le 13/06/2022.
- 1^{er} période d'analyse de 13/06/2022 au 30/06/2022.

-Bonne observance :

Durée moyenne d'utilisation (h/j) : 6 h 45.

% de jours d'utilisation >= 4 h/j : 100 %

-Index des apnée-hypopnées obstructives résiduelles sous PPC : 5,3/h.

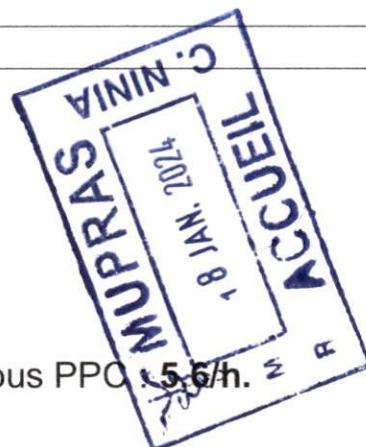

Le patient a présenté une sécheresse buccale.

Changement de l'appareil par un appareil avec humidificateur.

Appareil PPC : AirSense 10 AutoSet avec humidificateur 23202179832
Logiciel : ResScan v5.5.0.9285

- 2^{ème} période d'analyse de 30/06/2022 au 13/07/2022.

-Bonne observance :

Durée moyenne d'utilisation (h/j) : 6 h 26.

% de jours d'utilisation >= 4 h/j : 86 %

-Index des apnée-hypopnées obstructives résiduelles sous PPC : 8,6/h.

- 3^{ème} période d'analyse de 05/01/2023 au 06/09/2023.

-Bonne observance :

Durée moyenne d'utilisation (h/j) : 6 h 58.

% de jours d'utilisation >= 4 h/j : 92 %

-Index des apnée-hypopnées résiduelles sous PPC : 4,7/h.

-4^{ème} période d'analyse de 07/09/2023 au 26/12/2023.

-Bonne observance :

Durée moyenne d'utilisation (h/j) : 6 h 28.

% de jours d'utilisation >= 4 h/j : 91 %

-Index des apnée-hypopnées résiduelles sous PPC : 5,3/h.

Statistiques

07/09/2023 - 26/12/2023

Réglages de l'appareil

Mode de traitement : **AutoSet**

Activer EPR: **ON**

Durée de rampe: **20,0 minutes**

Pression minimale : **4,0 cmH2O**

Pression - cmH2O

Médian(e) : **9,7**

Fuites - l/min

Médian(e) : **0,0**

Événements respiratoires - événements/h

Index d'apnée : **3,6**

Obstructive: **2,5**

% temps en RCS : **0,0**

Utilisation totale

Jours employés >= 4 heures : **102**

Jours de non-utilisation : **5**

Util. médiane quot.: **6:54**

Appareil : AirSense 10 AutoSet (S/N: 23202179832)

EPR: **FULL_TIME**

Activation EPR patient: **ON**

Accès limité: **ON**

Pression maximale : **14,0 cmH2O**

Au 95ème centile : **13,9**

Au 95ème centile : **4,8**

Index d'hypopnée : **1,8**

Centrale: **0,4**

Jours employés < 4 heures : **4**

Nbr. total de jours : **111**

Util. moyenne quot.: **6:28**

Niveau EPR: **3,0 cmH2O**

Activation de rampe: **RAMP_ON**

Réponse: **STANDARD**

Maximal(e) : **13,9**

Maximal(e) : **43,8**

AHI: **5,3**

Non qualifiée: **0,1**

% Jours employés >= 4 heures : **91**

Nbr. total d'heures d'utilisation :


718:30

Graphiques de données de synthèse


07/09/2023 - 26/12/2023

Appareil : AirSense 10 AutoSet (S/N: 23202179832)


Pression

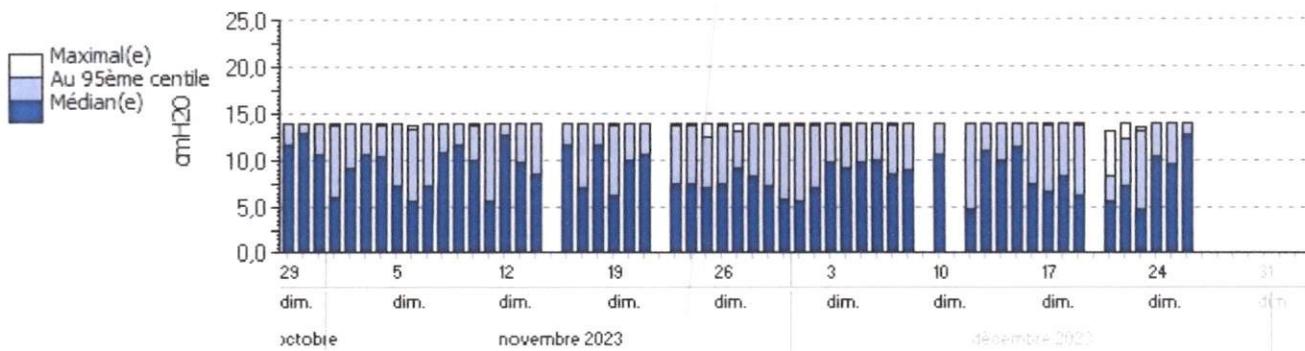

Fuites

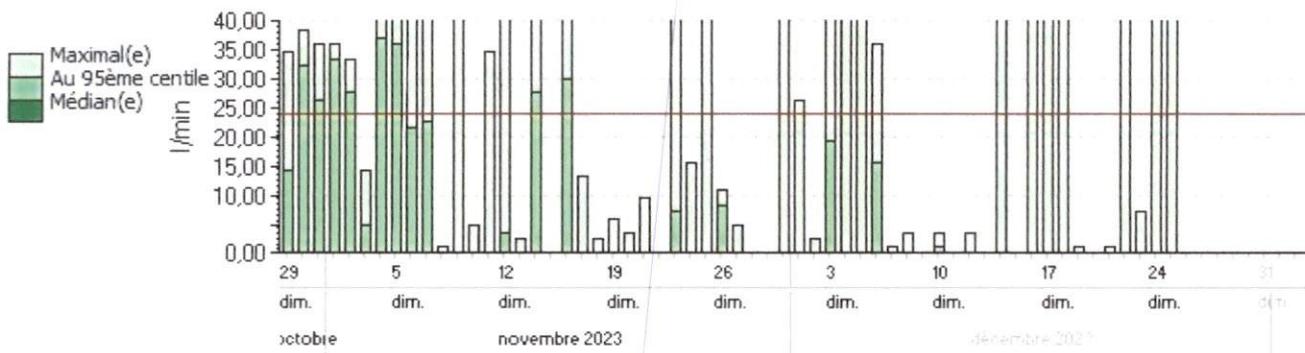

IAH & IA

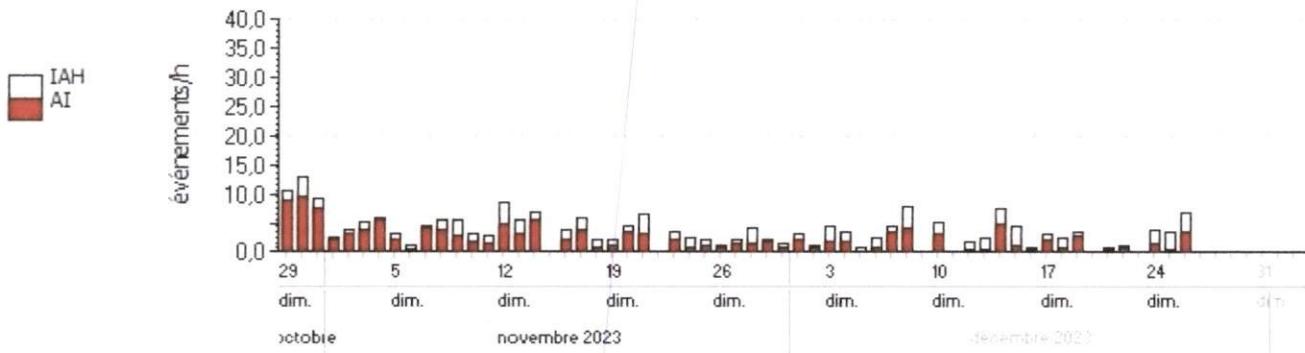

Utilisation

