

Mlle

07 69

AUDOUNE

Espace De Conseil Auditif

DEVIS

Patiente : Mme RAFIK FATIMA

Numéro: 03AB/24

Date : 14/02/2024

195309

Désignation	Qté	Prix HT	Prix Total HT
Prothèse Auditif Numérique Haute Technologie :			
<u>ANAM : FA100001</u>	2	9000.00	18 000.00
• 2 Ans d garantie • Contrôle gratuit • Service après-vente gratuit.			

Total HT : 18 000.00

TVA 0% : 00.00

Total TTC : 18000.00

Arrêter le présent devis à la somme de DIX HUIT milles dirhams.

Sté AUDOUNE SARL
Siège Social: Av. Abou Hassane
El Marini Rce Amira 2 5^e Etage
Bureau N° 15 MEKNES

Siege Social: Bv Abou Hassan elmarini Rsd Amira 2; 5^eme Etage Bureau N°15
-IF :18752858 -RC :40873 -Patente :17191621 -CNSS :4769131 -ICE :001580986000071



ECA

ESPACE DE CORRECTION AUDITIVE

me 769

Veuillez Procéder à :

L'Appareillage

O.D. ☒

O.G. ☒

La Fabrication d'embouts

Anti-eau ☐

Anti-bruit ☐

La Réparation de prothèse

☐

L'Adaptation de pothèse

☐

De Mr.

Mr. RAKIF Fata

Observation :

SP Sidel

Pr. A. BENGHALEM
Professeur Agrégé
Chirurgie ORL et Otorhinolaryngologie
38, Bd. Rochd Casablanca 20190
Tél : 05.22.20.84.93 - GSM : 06.69.70.88.89
ICE : 00171102400057 - INPE : 091022103

Cachet

www.espaceauditif.com

104, Beau Sejour, Boulevard Sidi Abderrahman, 3^{ème} Etage N° 5 - Casablanca

Tél/Fax : 05.22.39.94.59 / GSM : 06.69.70.88.89

40, Rue des Hôpitaux 3^{ème} Etage, Appt N° 13, En face du centre de diagnostic de l'hôpital Ibn Rochd Porte 28 (à 2 min de la station Tramway Wafasalaf) - Casablanca

Tél/Fax : 05.22.20.84.93

N. Dossier:
Nom de famille:
Prénom:



Interacoustics A/S
Audiometer Allé 1
5500 Middelfart



Interacoustics

22/01/2024 23:04:24

Tonale

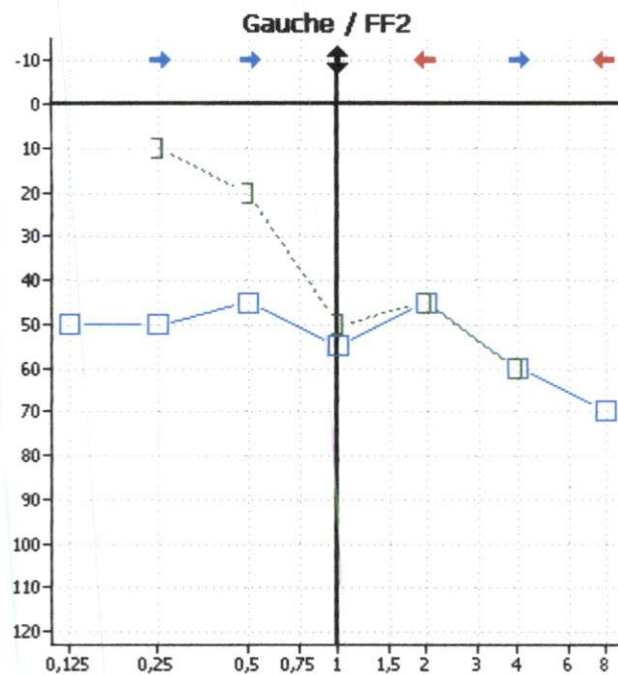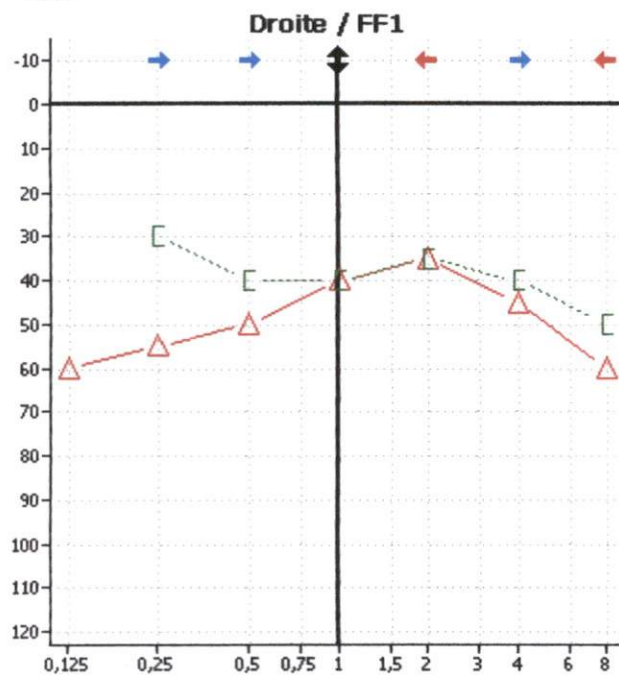

Présentation des symboles

	Droite		Gauche		fibrateur		fibrateur		FF1	FF2
HL	O	△	X	□	<	>	]	[	O	△
UCL	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮	▮

ASSR

Pr. A. BENGHALEM
Professeur Agrégé
Chirurgie ORL & Maxillo-Faciale
58, Bd. Rachidi Casa - Tél: 05 22 48 63 65
ICE: 001711024000057 - INPE/091022103

N° Dossier:
Nom de famille:
Prénom:

RAKIF
ATINA

Interacoustics A/S
Drejervænget 8
5610 Assens



Interacoustics


mlc 769

22/01/2024 18:19:15


Droite
226 Hz

Tymp 226 Hz

Gauche
226 Hz


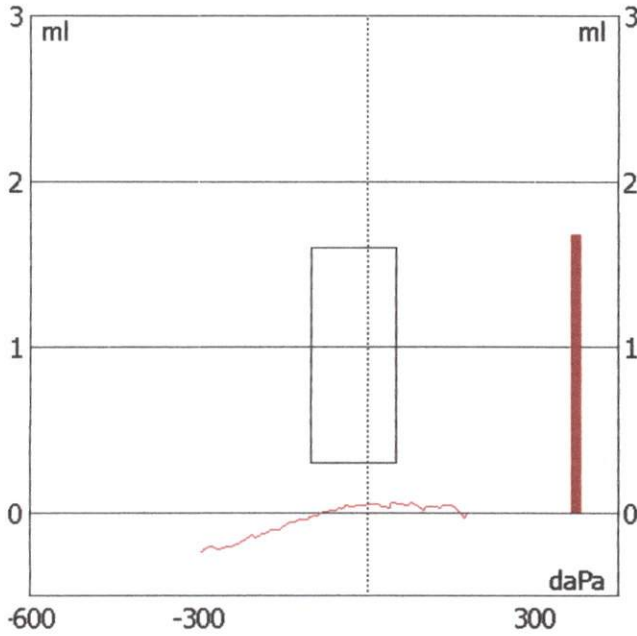


Volume (ml) 1,68 Pression (daPa) -
Compliance (ml) - Gradient (daPa) -


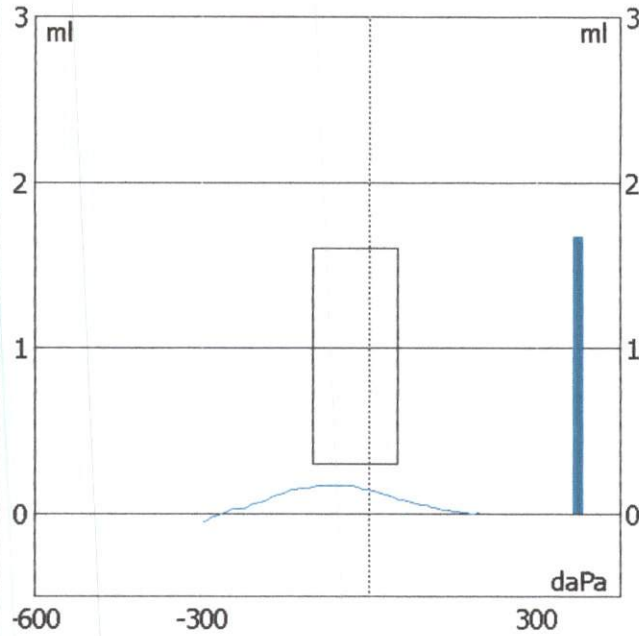


Volume (ml) 1,67 Pression (daPa) -65
Compliance (ml) 0,17 Gradient (daPa) 241

Reflexe ipsi

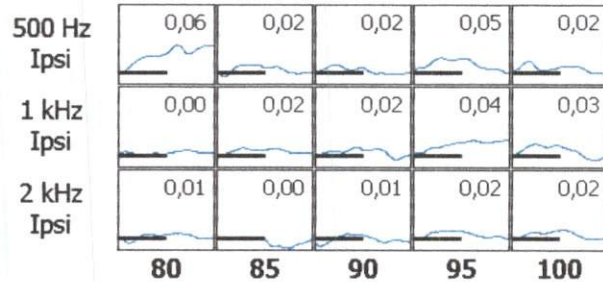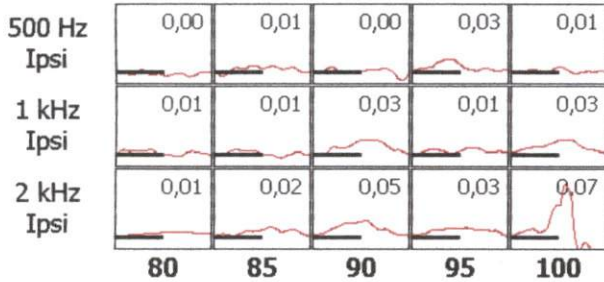

Réflexe contro

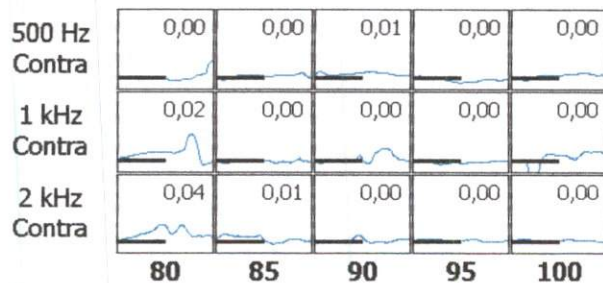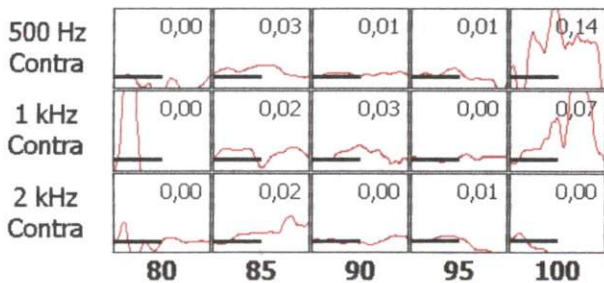

Pr. A. BENGHALEM

Professeur Agrégé
Chirurgie ORL & Maxillo-Faciale
58, Bd. Rachidi-Casa-Alger 05 22 48 63 65
ICE : 00171102400007 - INPE : 091022103