

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR OBTENIR LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Informations générales :

Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Biologie et Biologie :

La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

En cas de prothèses ou de traitement canalaires, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canalaires.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- Reclamation : contact@mupras.com
- Prise en charge : pec@mupras.com
- Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge Casablanca 20000 - Tél. : 05 22 20 45 45 (LG) - Fax : 05 22 22 78 18 - www.mupras.com



MLD

Déclaration de Maladie : N° P19- 0023094

☒ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autres

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 4673 Société : RAM
☐ Actif ☒ Pensionné(e) ☐ Autre :
Nom & Prénom : BAIRA Ali Date de naissance : 08-02-1953
Adresse : 12 Rte. Oued Ziane Hay Tassim
Tél. : 0661215936 Total des frais engagés : 300,00 + 1411,70 Dhs

Cadre réservé au Médecin

Cachet du médecin :
Docteur BENLALLA ELGHORFI Fatima
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition
Bd Al Ouds, Rés les Rosiers, App. 121
Ain Chock, Casablanca - Tél. : 0522 870 890
Date de consultation : 29/08/19
Nom et prénom du malade : M. BAIRA Ali Age :
Lien de parenté : ☐ Lui-même ☐ Conjoint ☐ Enfant
Nature de la maladie : diabète
En cas d'accident préciser les causes et circonstances :
Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : 08/09/2019
Signature de l'adhérent(e) :

Chabing

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
29/08/19			300 PH	Docteur BENLALLA ELGHORFI Fatima Spécialiste en Endocrinologie Diabétologie et Nutrition Bd Al Oudj, Rés les Rosiers, Appt 121 Ain Chock, Casablanca - Tél : 0522 870 890

EXECUTION DES ORDONNANCES

Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
LA PHARMACIE REGIONALE Dr. Saad BENJELLOUN Imm. 94, Lot Nait M. Tél : 0522 51 47 07	29-08-19	1411,70

ANALYSES - RADIOGRAPHIES

Cachet et signature du Laboratoire et du Radiologue	Date	Désignation des Coefficients	Montant des Honoraires

AUXILIAIRES MEDICAUX

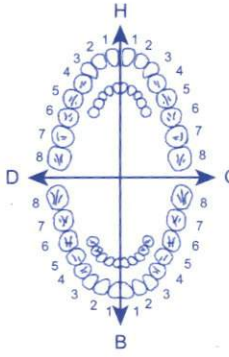
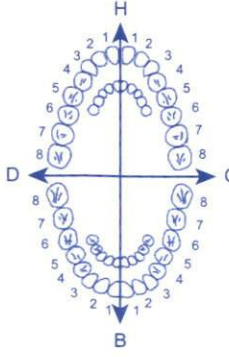
Cachet et signature du Praticien	Date des Soins	Nombre				Montant détaillé des Honoraires
		AM	PC	IM	IV	

RELEVÉ DES FRAIS ET HONORAIRES

Le praticien est prié de préciser la dent traitée, l'acte pratiqué en indiquant la nature des soins.

Important :

Veillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan

SOINS DENTAIRES	Dents Traitées	Nature des Soins	Coefficient	
				CCEFFICIENT DES TRAVAUX
				MONTANTS DES SOINS
				DEBUT D'EXECUTION
				FIN D'EXECUTION
O.D.F PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE H 25533412 21433552 00000000 00000000 D G 00000000 00000000 35533411 11433553 B			CCEFFICIENT DES TRAVAUX
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel, Thérapeutique, nécessaire à la profession			MONTANTS DES SOINS
				DATE DU DEVIS
				DATE DE L'EXECUTION

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition

إختصاصية في أمراض الغدد
و السكري و التغذية

Sur Rendez-Vous

بالموعد

Casablanca, le

29/08/19

الدار البيضاء في

Mme

BAHRA RKIA

REGIME SANS SUCRE ET SANS GRAS

26.90x3 GEPRID 1

= 201.70

1 comprimé

le matin

43.30 ADO 1G

1 comprimé

à midi

49.50 D CURE FORTE

1 ampoule

1 fois par 2 mois

79.40 CHOLESTIN 10

le soir

x3 = 238.20 1 comprimé

100x10 BANDELETTES A GLYCEMIE A RAISON DE 2 GLYCEMIES / J

TRAITEMENT DE 3 MOIS

Docteur BENLALLA EL GHORFI Fatima
Spécialiste en Endocrinologie
Diabétologie et Nutrition
Bd Al Qods, Rés les Rosiers, Apt. 121
Ain Chock, Casablanca - Tél : 0522 870 890

LA PHARMACIE REGIONALE
Dr. Saad BENJELLOUN
Imm. 94, Lot N° 4
Tél : 0522 51 47 07

LA PHARMACIE REGIONALE
Dr. Saad BENJELLOUN
Imm. 94, Lot N° 4
Tél : 0522 51 47 07

T. svp ---

P.P.V. : 26DH90

P.P.V. : 26DH90

P.P.V. : 26DH90

43,30

PPU: 49,50 DH
LOT: 2E15/B
EXP: 05/2022

LOT: N03
PER: 06-2021
PPU: 79,40 DH

LOT: N03
PER: 06-2021
PPU: 79,40 DH

rimés

LOT: N03
PER: 06-2021
PPU: 79,40 DH

rimés

Handwritten text, likely a signature or date, located at the bottom right of the page.

Pharmacie REGIONALE - Deroua



LA PHARMACIE REGIONALE
Dr. Saad BENJELOUN
Imm. 94, Lot. Nait N° 4
Tél : 0522 51 47 07 - GSM : 0673 28 30 04

Facture N° 20190907-738

Date de vente : 29/08/2019

Médecin traitant :

Bahra rkia

Maroc

Produit	Qté.	P.U	TVA	Total
BAYER CONTOUR PLUS BANDELETTES REACTIVES B25	10	100,00	TVA (20.00%)	1 000,00

LA PHARMACIE REGIONALE
Dr. Saad BENJELOUN
Imm. 94, Lot. Nait N° 4
Tél : 0522 51 47 07 - GSM : 0673 28 30 04

Total HT	833,33 DHS
TVA	166,67 DHS
Total	1 000,00 DHS

Arrêté la présente facture à la somme de : mille DHS

فقط برای استفاده تشخیصی در شرایط آزمایشگاهی [IVD]. استعمال خارجی، از یلغیدن آن خودداری کنید.
خطر زیستی بالقوه: متخصصان مراقبت‌های بهداشتی باید افرادی که از این سیستم بر روی چندین بیمار استفاده می‌کنند، باید روند کنترل عفونت را به گونه‌ای که بعد از تأیید سازمان بهداشت جهانی، در دسترس باشد، پیگیری کنند.

ContourTM plus

نوار تست قند خون

برای استفاده با تمام دستگاه‌های
تست قند خون CONTOURTMPLUS
(کنتور پلاس)



مورد مصرف: نوارهای تست CONTOURTMPLUS (کنتور پلاس) برای خود پایشی توسط افراد مبتلا به دیابت و متخصصان مراقبت‌های بهداشتی در نظر گرفته شده‌اند تا غلظت گلوکز را در خون کامل اندازه‌گیری کنند.

خلاصه: نوار تست CONTOUR PLUS (کنتور پلاس) برای استفاده با تمام دستگاه‌های اندازه‌گیری گلوکز خون CONTOURTMPLUS (کنتور پلاس) در نظر گرفته شده است. این تست در همه دستگاه‌های اندازه‌گیری CONTOUR PLUS (کنتور پلاس) مقدار عددی گلوکز را نشان می‌دهد.

نگهداری و استفاده:

15-30°C

ContourTM plus

کونطور پلاس / کنتور پلاس

For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide.

Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

لمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بيانات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

برای راهنمایی بیشتر، لطفاً به اطلاعات تماس در صفحه آخر راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Damoun Tajlaji Teh Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
Vahd-e-Asr Ave.,
Tehran, 196785637
Iran
Phone : +98 21 26218306

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascensia.com

صنع في اليابان

ASCENSIA
Diabetes Care

ContourTM plus

کونطور پلاس / کنتور پلاس

Blood Glucose Test Strips

Bandelettes réactives de glycémie

شرائط اختبار جلوكوز الدم

نوارهای تست قند خون

25
Test Strips
Bandelettes
réactives
شریط اختبار
نوار تست



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة. Contour (كونطور) علامة تجارية وسجل براءة اختراع لـ Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. تمامی حقوق محفوظ است. Contour (کنتور) نشان تجاری ثبت شده شرکت Ascensia Diabetes Care Holdings AG است.

www.patents.ascensia.com

85157701

Rev. 02/16

توجه: این دستگاه برای استفاده با تمام دستگاه‌های تست قند خون CONTOURTMPLUS (کنتور پلاس) طراحی شده است. نتایج کنترل باید در محدوده 39-138 mg/dL باشد. اگر نتایج خارج از این محدوده باشد، ممکن است نیاز به بررسی مجدد دستگاه یا نوار تست داشته باشید.

CONTROL N 107-138 mg/dL

CONTROL L 39-50 mg/dL

CONTROL H 318-413 mg/dL

LOT DP7G9HC32F

EXP 2019-07

اطلاعات درباره ایمنی

- فقط برای استفاده تشخیصی در شرایط آزمایشگاهی [IVD]. استعمال خارجی، از بی‌اعتمادی آن خودداری کنید.
- خطر زیستی بالقوه: متخصصان مراقبت‌های بهداشتی یا افرادی که از این سیستم بر روی چندین بیمار استفاده می‌کنند، باید روند کنترل عفونت را به گونه‌ای که مورد تأیید سازمان مربوطه باشد طی کنند. باید با تمام محصولات با اشتراک که با جعبه، استراحت در.



ContourTM plus

نوار تست قند خون

برای استفاده با تمام دستگاه‌های
تست قند خون CONTOURTMPLUS
(کنتور پلاس)



مورد مصرف: نوارهای تست CONTOURTMPLUS (کنتور پلاس) برای خود پایشی توسط افراد مبتلا به دیابت و متخصصان مراقبت‌های بهداشتی در نظر گرفته شده‌اند تا غلظت گلوکز را در خون کامل اندازه‌گیری کنند.

خلاصه: نوار تست CONTOUR PLUS (کنتور پلاس) برای استفاده با تمام دستگاه‌های اندازه‌گیری گلوکز خون CONTOURTMPLUS (کنتور پلاس) در نظر گرفته شده است. این تست در همه دستگاه‌های اندازه‌گیری CONTOUR PLUS (کنتور پلاس) مقدار عددی گلوکز را نشان می‌دهد.

نگهداری و استفاده:

15-30°C

ContourTM plus

کونطور پلاس / کنتور پلاس

For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide.

Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

لمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بيانات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

برای راهنمایی بیشتر، لطفاً به اطلاعات تماس در صفحه آخر راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Damoun Tajlaji Teh Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
Vahd-e-Asr Ave.,
Tehran, 196785637
Iran
Phone : +98 21 26218306

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascensia.com



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة. CONTOUR (کونطور) علامة تجارية وسجلت لعلامة تجارية مسجلة لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. تمامی حقوق محفوظ است. CONTOUR (کنتور) نشان تجاری ثبت شده شرکت Ascensia Diabetes Care Holdings AG است.

www.patents.ascensia.com

85157701

Rev. 02/16

نوار تست قند خون
نوار تست قند خون

نوار تست قند خون

نوار تست قند خون

نوار تست قند خون



CONTROL N 107-138 mg/dL

CONTROL L 39-50 mg/dL

CONTROL H 318-413 mg/dL

LOT DP7G9HC32F

EXP 2019-07

اطلاعات درباره ایمنی

- فقط برای استفاده تشخیصی در شرایط آزمایشگاهی [IVD]. استعمال خارجی، از بی‌اعتمادی آن خودداری کنید.
- خطر زیستی بالقوه: متخصصان مراقبت‌های بهداشتی یا افرادی که از این سیستم بر روی چندین بیمار استفاده می‌کنند، باید روند کنترل عفونت را به گونه‌ای که مورد تأیید سازمان مربوطه باشد طی کنند. باید با تمام محصولات با اشتراک که با هم: اشتراک در: ه اند، در غیر این صورت تا زمانی که مشکل را حل نکرده‌اید، از:

- فقط برای استفاده تشخیصی در شرایط آزمایشگاهی [IVD]. استعمال خارجی، از بلعیدن آن خودداری کنید.
- خطر زیستی بالقوه: متخصص مراقبت‌های بهداشتی باید افرادی که از این سیستم بر روی چندین بیمار استفاده می‌کنند، باید روند کنترل عفونت را به گونه‌ای که مورد تأیید سازمان بهداشت جهانی است، دنبال کنند. برای اطلاعات بیشتر، لطفاً به راهنمای کاربر مراجعه کنید.

فقط برای استفاده تشخیصی در شرایط آزمایشگاهی [IVD]. استعمال خارجی، از بلعیدن آن خودداری کنید.
خطر زیستی باقی‌مانده: متخصص مراقبت‌های بهداشتی باید افرادی که از آن سیستم بر روی چندین بیمار استفاده می‌کنند، باید روند کنترل عفونت را به گونه‌ای که مورد تأیید سازمان بهداشتی جهانی است، دنبال کنند. از تماس با آب و سایر مایعات بدن اجتناب کنید.

Contour™ plus

نوار تست قند خون

برای استفاده با تمام دستگاه‌های
تست قند خون CONTOUR™PLUS
(کنتور پلاس)



مورد مصرف: نوارهای تست CONTOUR™PLUS (کنتور پلاس) برای خود پایشی توسط افراد مبتلا به دیابت و متخصصان مراقبت‌های بهداشتی در نظر گرفته شده‌اند تا غلظت گلوکز را در خون کامل اندازه‌گیری کنند.

خلاصه: نوار تست CONTOUR PLUS (کنتور پلاس) برای استفاده با تمام دستگاه‌های اندازه‌گیری گلوکز خون CONTOUR™PLUS (کنتور پلاس) در نظر گرفته شده است. این تست در همه دستگاه‌های اندازه‌گیری CONTOUR PLUS (کنتور پلاس) مقدار عددی گلوکز را نشان می‌دهد.

نگهداری و استفاده:

۲-۳۰°C

Contour™plus

کنتور پلاس / کنسور پلاس

For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide.

Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

لمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بيانات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

برای راهنمایی بیشتر، لطفاً به اطلاعات تماس در صفحه آخر راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Damoun Tajlaji Teh Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
Vahd-e-Asr Ave.,
Tehran, 196785637
Iran
Phone : +98 21 26218306

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascensia.com

ASCENSIA
Diabetes Care

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة. CONTOUR (كونتور) علامة تجارية وسجولة لعلامة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. تمامی حقوق محفوظ است. CONTOUR (کنتور) نشان تجاری ثبت شده شرکت Ascensia Diabetes Care Holdings AG است.

www.patents.ascensia.com

85157701

Rev. 02/16

نوار تست قند خون
نوار تست قند خون

نوار تست قند خون

نوار تست قند خون

نوار تست قند خون



CONTROL N 107-138 mg/dL

CONTROL L 39-50 mg/dL

CONTROL H 318-413 mg/dL

LOT DP7G9HC32F

EXP 2019-07

اطلاعات درباره ایمنی

- فقط برای استفاده تشخیصی در شرایط آزمایشگاهی [IVD]. استعمال خارجی، از بی‌اعتمادی آن خودداری کنید.
- خطر زیستی بالقوه: متخصصان مراقبت‌های بهداشتی یا افرادی که از این سیستم بر روی چندین بیمار استفاده می‌کنند، باید روند کنترل عفونت را به گونه‌ای که مورد تأیید سازمان مربوطه باشد طی کنند. باید با تمام محصولات با اشتراک که با هم: اشتراک در: ه اند، در غیر این صورت تا زمانی که مشکل را حل نکرده‌اید، از:



Contour™ plus

نوار تست قند خون

برای استفاده با تمام دستگاه‌های
تست قند خون CONTOUR™PLUS
(کنتور پلاس)



مورد مصرف: نوارهای تست CONTOUR™PLUS (کنتور پلاس) برای خود پایشی توسط افراد مبتلا به دیابت و متخصصان مراقبت‌های بهداشتی در نظر گرفته شده‌اند تا غلظت گلوکز را در خون کامل اندازه‌گیری کنند.

خلاصه: نوار تست CONTOUR PLUS (کنتور پلاس) برای استفاده با تمام دستگاه‌های اندازه‌گیری گلوکز خون CONTOUR™PLUS (کنتور پلاس) در نظر گرفته شده است. این تست در همه دستگاه‌های اندازه‌گیری CONTOUR PLUS (کنتور پلاس) مقدار عددی گلوکز را نشان می‌دهد.

نگهداری و استفاده:

۲-30°C

Contour™plus

کونتور پلاس / کنسور پلاس

For further assistance, please see contact information on the last page of the User Guide.

Pour obtenir une assistance, voir les coordonnées sur la dernière page du manuel d'utilisation.

لمزيد من المساعدة يرجى مراجعة بيانات الاتصال الموجودة في الصفحة الأخيرة من دليل المستخدم.

برای راهنمایی بیشتر، لطفاً به اطلاعات تماس در صفحه آخر راهنمای کاربر مراجعه کنید.

Damoun Tajlaji Teh Co.
#14, 5th floor, No. 33, Syed Reza Saeedi St.,
Vahd-e-Asr Ave.,
Tehran, 196785637
Iran
Phone : +98 21 26218306

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

www.diabetes.ascensia.com

ASCENSIA
Diabetes Care

Contour™plus

کونتور پلاس / کنسور پلاس

Blood Glucose Test Strips

Bandelettes réactives de glycémie

شرائط اختبار جلوكوز الدم

نوارهای تست قند خون

25
Test Strips
Bandelettes
réactives
شرائط اختبار
نوار تست

NO CODING
SANS CODAGE



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. All rights reserved. Contour is a trademark and/or registered trademark of Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Contour est une marque de commerce et une marque déposée d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. جميع الحقوق محفوظة. Contour (كونتور) علامة تجارية وسجلت لعلامة تجارية مسجلة لشركة Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. تمامی حقوق محفوظ است. Contour (کنتور) نشان تجاری ثبت شده شرکت Ascensia Diabetes Care Holdings AG است.

www.patents.ascensia.com

85157701

Rev. 02/16

نوار تست قند خون
نوار تست قند خون

نوار تست قند خون
نوار تست قند خون

نوار تست قند خون
نوار تست قند خون

نوار تست قند خون
نوار تست قند خون

CONTROL N 107-138 mg/dL

CONTROL L 39-50 mg/dL

CONTROL H 318-413 mg/dL

LOT DP7G9HC32F

EXP 2019-07

اطلاعات درباره ایمنی

- فقط برای استفاده تشخیصی در شرایط آزمایشگاهی [IVD]. استعمال خارجی، از بی‌اعتمادی آن خودداری کنید.
- خطر زیستی بالقوه: متخصصان مراقبت‌های بهداشتی یا افرادی که از این سیستم بر روی چندین بیمار استفاده می‌کنند، باید روند کنترل عفونت را به گونه‌ای که مورد تأیید سازمان مربوطه باشد طی کنند. باید با تمام محصولات با اشتراک که با هم: اشتراک در: ه اند، در غیر این صورت تا زمانی که مشکل را حل نکرده‌اید، از: