

RECOMMANDATIONS IMPORTANTES A LIRE POUR ACTIVER LES REMBOURSEMENTS ET EVITER LES REJETS

Conditions générales :

- Le cadre réservé à l'adhérent doit être dûment renseigné.
- Le cadre réservé au médecin doit être renseigné par le praticien lui-même notamment la nature de la maladie.
- La validité de la feuille de soins est limitée à 3 mois à compter de la première consultation.
- L'entente préalable est exigée pour toute hospitalisation médicale, chirurgicale, soins dentaires spéciaux, extractions multiples, parodontie orthodontie, prothèses dentaires, prothèses auditives ou orthopédiques ainsi que pour tous les actes effectués en série.
- En cas d'accident, une déclaration précisant les causes et circonstances de l'accident est à joindre à la feuille de soins.

Pharmacie :

- Les vignettes des médicaments doivent être obligatoirement jointes aux ordonnances.
- Pour les médicaments sans vignettes une facture de la pharmacie doit être jointe.

Radiologie et Biologie :

- La facture ainsi qu'une copie des résultats des analyses ou du compte rendu (sous pli confidentiel) doivent être jointes à l'ordonnance médicale pour toute demande de remboursement.
- Un pli confidentiel du médecin prescripteur des analyses ou radios peut être demandé par le médecin conseil de la mutuelle.

Optique :

- L'ordonnance du médecin prescripteur et la facture de l'opticien sont à joindre à la feuille de soins.

Rééducation :

- L'entente préalable renseignée par le médecin prescripteur est exigée avant le début des séances de rééducations.
- Pour le remboursement, la facture et le calendrier des séances effectuées sont à joindre à la feuille de soins.

Dentaire :

- En cas de prothèses ou de traitement canaux, l'accord préalable renseigné sur la feuille de soins est obligatoire avant le début de traitement.
- La facture doit être jointe à la feuille de soins pour toute demande de remboursement.
- La radio-après soins est obligatoire en cas de prothèses ou de traitement canaux.

Maladie et Affection Longue Durée ALD et ALC :

- La déclaration de maladie chronique doit être renseignée par le médecin prescripteur et renouvelée tous les 6 mois.

Adresses Mails utiles

- 0 Réclamation : contact@mupras.com
- 0 Prise en charge : pec@mupras.com
- 0 Adhésion et changement de statut : adhesion@mupras.com

La MUPRAS garantit le respect de la loi n° 09-08 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel.

MUPRAS : Centre Allal Ben Abdellah - 6ème Etage Angle Rue Mohamed Fakir et Rue Allal Ben Abdellah - Quartier de l'Horloge



MUPRAS
Mutuelle de Prévoyance
& d'Actions Sociales
de Royal Air Maroc

N° W19-437133

☐ Maladie ☐ Dentaire ☐ Optique ☐ Autre

Cadre réservé à l'adhérent (e)

Matricule : 10282 Société : Mutuelle de Prévoyance & d'Actions Sociales de Royal Air Maroc

☒ Actif ☐ Pensionné(e) ☐ Autre

Nom & Prénom : CHABARI A. KHALIL

Date de naissance : 1960

Adresse : hab. tacile

Tél. : 0522 76 6042 Total des frais engagés : 0

Cadre réservé au Médecin

Docteur KHLATA M. HAMMAM
Médecin Spécialiste
En Diabétologie - En Endocrinologie
En Maladies Nutritionnelles
Diplômé de l'Université René Descartes Paris
13 rue Baghdad - 12r (tél : 0521 37 04 44)

Cachet du médecin :

Date de consultation : 30/07/2015

Nom et prénom du malade : JAMALI Leila Age : 47

Lien de parenté : ☐ Lui-même ☒ Conjoint ☐ Enfant

Nature de la maladie : Diabète - Coréone Viscerale

En cas d'accident préciser les causes et circonstances :

Dans le cas où la maladie aurait un caractère confidentiel, communiquer les renseignements sous pli confidentiel à l'attention du médecin conseil de la Mutuelle.

J'atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur la présente déclaration. Je déclare avoir pris connaissance de la clause relative à la protection des données personnelles.

Fait à : Le : / /

Signature de l'adhérent(e) :

VOLET ADHERENT

Déclaration de maladie

N° W19-437133

Remplissez ce volet, découpez le et conservez-le.
Il sera nécessaire de le présenter pour toute réclamation ultérieure.

Matricule : 10282

Nom de l'adhérent(e) : Leila

Total des frais engagés :

RELÈVE DES FRAIS ET HONORAIRES				
Dates des Actes	Natures des Actes	Nombre et Coefficient	Montant détaillé des Honoraires	Cachet et signature du Médecin attestant le Paiement des Actes
21/07/13	a	n	200.00	INP 098108553 Dr. KHALIFA MOHAMMED Médecin Spécialiste En Dermatologie et Vénéréologie Diplômé de l'Université de Tunis 13 rue Bachat


Cachet du Pharmacien ou du Fournisseur	Date	Montant de la Facture
 PHARMACIE GHOFRANE Dr. HRIDOUA LAÏLA Rue 2 N° 116 Bloc (C) Al Qods Sidi Bernoussi Casablanca	31/07/19	 PHARMACIE GHOFRANE Dr. HRIDOUA LAÏLA Rue 2 N° 116 Bloc (C) Quartier Al Qods Sidi Bernoussi Casablanca

[illegible][illegible]

* Il est entendu que le règlement est conditionné par la fourniture de tous les justificatifs exigés par la Mutuelle.

Important :
Veuillez joindre les radiographies en cas de prothèses ou de traitement canaux, ainsi que le bilan de l'OD

[illegible]

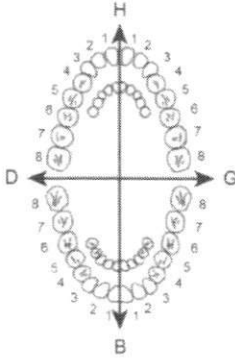O.D.F. PROTHESES DENTAIRES	DETERMINATION DU CCEFFICIENT MASTICATOIRE		CCEFFICIENT DES TRAVAUX										
	<table border="1"> <tr><td colspan="2">H</td></tr> <tr> <td>25533412 00000000</td> <td>21433552 00000000</td> </tr> <tr><td>D</td><td>G</td></tr> <tr> <td>00000000 35533411</td> <td>00000000 11433553</td> </tr> <tr><td colspan="2">B</td></tr> </table>		H		25533412 00000000	21433552 00000000	D	G	00000000 35533411	00000000 11433553	B		
	H												
	25533412 00000000	21433552 00000000											
	D	G											
	00000000 35533411	00000000 11433553											
	B												
	(Création, remont, adjonction) Fonctionnel. Thérapeutique, nécessaire à la profession		MONTANTS DES SOINS										
		DATE DU DEVIS											
		DATE DE L'EXECUTION											

VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT LE DEVIS VISA ET CACHET DU PRATICIEN ATTESTANT L'EXECUTION

Docteur KHLAFA Mohamed

Diplôme d'Endocrinologie
Diabétologie - Maladies Nutritionnelles
Diplômé de l'Université
René Descartes
Paris

الدكتور خلافة محمد

إختصاصي في أمراض الغدد
أمراض السكري
أمراض التغذية
خريج جامعة روني ديكرت
باريس

Mohammedia, le 31/07/18 المحمدية، في

Jamel
Laila

2,32

98,40 X7

Aïche Selsbi

08 - 08 - 08

Lentus Selsbi

14 el tori

36,7

- Anxiol = 0.0.1/2

siguelle shts (Ew)

270.00 X3

Boudella Tel

2 test / y

13. زنقة بغداد الطابق الأول - الهاتف : 05 23 32 04 44 - المحمدية

13, Rue Baghdad 1^{er} étage - Tél. : 05 23 32 04 44 - Mohammedia - Email : doc.khlafamohamed@gmail.com

1770 X8

- Metformin Wa PR

2.0.1

49.60

- Deux fois 100.000

100.000 / 15 jours - 100.000

Inb. le (23) This
Mois

1770.60

Docteur KHLATA MOHAMMED
Medecin Généraliste
En Collaboration En Dérégulation
Diplômé de l'Université René Descartes Paris
13 rue Barchad - 1er étage tel : 0223 72 14 24

PHARMACIE CHOPRANE
Dr. HIRIOU LAILA
N° 2 N° 146 Btic (C)
Quartier Al Qods Sidi Belmoussi
Casablanca

PRU: 19.50 DH
LOT: 18K20/B
EXP: 11/2021

3 ampoules buvables

D-CURE® FORTE

انكسيول

برومازينايم
6

عن طريق الفم



LOT: 8MA032
EXP: 10/2021
METFORMINEWIN 850MG
CP PEL B30
P.P.V.: 17DH10
118000062134

LOT: 8MA038
EXP: 11/2021
METFORMINEWIN 850MG
CP PEL B30
P.P.V.: 17DH10
118000062134

LOT: 8MA038
EXP: 11/2021
METFORMINEWIN 850MG
CP PEL B30
P.P.V.: 17DH10
118000062134

LOT: 8MA037
EXP: 11/2021
METFORMINEWIN 850MG
CP PEL B30
P.P.V.: 17DH10
118000062134

صيدلية الغفران PHARMACIE GHOFRANE

الزقة 2 الرقم 116 بلوك «س» حي القدس سيدي البرنوصي - الهاتف: 022 73 26 31 - الدار البيضاء

Mme HRIOUA Laïla
Docteur en Pharmacie
Diplômée de la Faculté
de TOURS en France



السيدة أهريوة ليلي
دكتورة في الصيدلة
خريجة كلية تور بفرنسا

Casa, le 31/07/20

FACTURE N° 909005

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	PRIX TOTAL
Aiguilles BD microfine 4.30	1	280,-	280,-
Bandelette code free	3	210,00	630,00
			910,00

La Présente Facture est Arrêtée à la somme de :

Signature
PHARMACIE GHOFRANE
Dr. HRIOUA LAÏLA
Rue 2 N° 116 Bloc (C)
Quartier Al Qods Sidi Bernoussi
Casablanca

Cachet

Blood Glucose
CodeFree
SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

OPEN
HERE

- PT**
- Substituta imediatamente a cápsula.
 - Garde sempre as faixas no contendor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- FR**
- Reformer immédiatement le bouchon.
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- NL**
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.


- RU**
- незамедлительно закройте крышку после использования.
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- DE**
- Deckel sofort wieder schliessen.
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- IT**
- Richiudere immediatamente il coperchio.
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Adatto per l'auto test.

- RO**
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
 - Băndețele de testare se pastrează în recipientul original.
 - Se folosește pentru autotestare.

- TR**
- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi Kendine Testiğini uygulayınız.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.



25 X 2 TEST

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-404050, 16, Deogyeong-dae 1556beon-gil,
Yongtong-gu, Seongju-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021


MB03CF1MLR5
Issue date: 2018.05

No
Coding

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodeFreeTM

Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT NO.: S0319037
/ MFG DATE: 2019. 03. 04
/ EXP DATE: 2021. 03. 03

Glucose Test Strip

- EN**
- Replace cap immediately.
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- ES**
- Tape de inmediato después de utilizar.
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- CZ**
- Po otevření ihned uzavřete.
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
Cat. No.: 01GS11



8 809319 390169

Blood Glucose
CodeFree
SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

OPEN
HERE

- PT**
- Substituta imediatamente a cápsula.
 - Garde sempre as faixas no contendor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- FR**
- Reformer immédiatement le bouchon.
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- NL**
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.


- RU**
- незамедлительно закройте крышку после использования.
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- DE**
- Deckel sofort wieder schliessen.
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- IT**
- Richiudere immediatamente il coperchio.
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Adatto per l'auto test.

- RO**
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
 - Băndețele de testare se pastrează în recipientul original.
 - Se folosește pentru autotestare.

- TR**
- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi Kendine Testiğini kullanınız.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.



25 X 2 TEST

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-404050, 16, Deogyeong-dae 1556beon-gil,
Yongtong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021


MB03CF1MLR5
Issue date: 2018.05

No
Coding

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodeFreeTM

Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT NO.: S0319037
/ MFG DATE: 2019. 03. 04
/ EXP DATE: 2021. 03. 03

Glucose Test Strip

- EN**
- Replace cap immediately.
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- ES**
- Tape de inmediato después de utilizar.
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- CZ**
- Po otevření ihned uzavřete.
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.

REF 01GS11
Cat. No.: 01GS11



8 809319 390169

Blood Glucose
CodeFree
SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM

OPEN
HERE

- PT**
- Substituta imediatamente a cápsula.
 - Garde sempre as faixas no contendor.
 - Adequado para o autocontrolo.

- FR**
- Reformer immédiatement le bouchon.
 - Toujours laisser les bandelettes dans leur boîte.
 - Utilisable en autocontrôle.

- NL**
- Sluit de deksel van het buisje direct na gebruik.
 - Bewaar teststrips altijd in het buisje.
 - Geschikt voor zelftesten.


- RU**
- незамедлительно закройте крышку после использования.
 - всегда храните полоски в контейнере.
 - подходит для самотестирования.

- DE**
- Deckel sofort wieder schliessen.
 - Streifen immer in Dose aufbewahren.
 - Geeignet zur Eigenanwendung.

- IT**
- Richiudere immediatamente il coperchio.
 - Conservare sempre le strisce nel contenitore.
 - Adatto per l'auto test.

- RO**
- Inchideți recipientul imediat după utilizare.
 - Bănețele de testare se pastrează în recipientul original.
 - Se folosește pentru autotestare.

- TR**
- Kutunun kapağını hemen kapatınız.
 - Stripleri her zaman kutusunda muhafaza ediniz.
 - Kendi Kendine Testiğini uygulayınız.
 - Kullanım amacı: Yalnız vücut dışı tıbbi tanı.



25 X 2 TEST

Manufactured by
SD Biosensor, Inc.

Head office
C-404050, 16, (Deogyeong-dae) 1556beon-gil,
Yongtong-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, 16690,
REPUBLIC OF KOREA
Manufacturing site
74, Osongsaengmyeong 4-ro, Osong-eup,
Heungdeok-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do,
28161, REPUBLIC OF KOREA
www.sdbiosensor.com

Authorized Representative
MT Promed Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80 D-66386 St. Ingbert Germany
Phone: +49 6894 581020, Fax: +49 6894 581021


MB03CF1MLR5
Issue date: 2018.05

No
Coding

NEW

SD BLOOD GLUCOSE MONITORING SYSTEM
CodeFreeTM

Blood Glucose Test Strip **GOLD ELECTRODE**



SD BIOSENSOR

SD Biosensor is not related to Alere Inc. or to Standard Diagnostics, Inc.

LOT NO.: S0319037
/ MFG DATE: 2019. 03. 04
/ EXP DATE: 2021. 03. 03

Glucose Test Strip

- EN**
- Replace cap immediately.
 - Always store strips in container.
 - Suitable for self-testing.

- ES**
- Tape de inmediato después de utilizar.
 - Guarde siempre las tiras en el envase.
 - Apto para el autocontrol.

- CZ**
- Po otevření ihned uzavřete.
 - Uchovávejte v originálním obalu.
 - Vhodný pro sebetestování.


REF 01GS11
Cat. No.: 01GS11



8 809319 390169

8 5985088

8mm



Aghí per penna
Agujas para plumas
Βελόνη για πένα

BD Micro-Fine[™]

E' compatibile con tutte le penne per il trattamento del diabete • Compatible con todas las plumas para el tratamiento de la diabetes • Compatível com todas as canetas para o tratamento de diabetes • Συμβατό με όλες τις πένες για την αντιμετώπιση του διαβήτη

Sanofi	ClikSTAR, SoloSTAR, OptiClik, OptiPen Pro, OptiSet, Lyxumia JuniorSTAR, AllSTAR
Lilly	KwikPen, HumaPen Memoir, HumaPen Luxura, Humalog Pen Humulin Pen, Savvio
AstraZeneca	Byetta Pen
Novo Nordisk	Victoza Pen, FlexPen, NovoPen, InnoLet, FlexTouch
Owen Mumford	AutoPen
B.Braun	Omnican Pen
Ypsomed	Ypsopen

Compatibili anche con • También compatibles con • Também compatíveis com
• Επίσης συμβατό με: Forsteo & HumatroPen 3 (Lilly), Genotonorm Pen & Genotropin Pen (Pfizer)

REF 320593 LOT 7080571 2022-03

EN ISO 11608-2

(gr) Να μην χρησιμοποιείται αν η συσκευασία έχει υποστεί φθορές. Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης της πένα.



0,25mm
(31G) x

8mm

STERILE R

CE 0050

PRIVO DI LATTICE
SIN LÁTEX
SEM LATEX
ΕΛΕΥΘΕΡΟ LATEX
C.N: 330258.6

0,25mm (31G)
x 8mm

BD



BD Micro-Fine™ Plus

BD Микро-Файн Плюс®

Pen Needles

إبر قلم الأنسولين

Aiguilles à stylos


Қаламсап-пісекке

арналған инелер

Agulhas para canetas

Иглы для шприц-ручки

Голки для шприц-ручки



4mm / 4мм

100 0,23mm (32G) x 4mm / 0,23мм (32G) x 4мм



Becton, Dickinson and Company
1 Becton Drive
Franklin Lakes, NJ 07417
USA

Уполномоченная организация:
ООО "Бектон Дикинсон Восток"
127018, РФ, Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1

Вироблено в Ірландії на заводі:
Becton Dickinson and Company, Pottery Road,
Dun Laoghaire, Co Dublin, Ірландія

Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично. Для однократного применения.
Стерильно. Апиrogenно. Нетоксично. Для одноразового застосування.
Зарарсыздандырылған. Апиrogenді. Уытты емес. Біржолғы пайдалануға арналған.

BD, BD Logo and BD Micro-Fine are trademarks of Becton, Dickinson and Company. ©2012 BD
All other brands are trademarks of their respective owners.

BD, BD logo и BD Микро-Файн Плюс являются торговыми знаками Becton, Dickinson and Company. ©2012 BD.
Все остальные торговые марки и знаки являются собственностью соответствующих компаний-производителей.

Бектон Дикинсон энд Компани
США, Нью Джерси,
Франклин Лейкс 07417,
Бектон Драйв, 1

Представництво в Україні:
«Форт Медікал Фертріб ГмбХ»
Україна, 03039 Київ, вул. Голосіївська, 7

Бектон Дікінсон энд Компані
США, Нью Джерси,
Франклин Лейкс 07417,
Бектон Драйв, 1



BD Medical - Diabetes Care
Becton Dickinson France S.A.S.
11, rue Aristide Bergès - BP 4
38801 Le Pont de Claix Cedex
France



BD Micro-Fine™ Plus

BD Микро-Файн Плюс®

(en) Suggested injection technique:
Inject straight in, without pinch up.

(ar) الطريقة المقترحة للحقن:
الحقن مباشرة بدون أن تضغط على موضع الحقن

(fr) Technique d'injection suggérée:
Injection à 90° sans pli cutané.

(kk) Ұсынылған ине салу әдісі:
Инені қатты баспай, тіке салыңыз.

(pt) Técnica de injeção recomendada:
Injecte a direito, sem prega.

(ru) Рекомендуется выполнять инъекции под
прямым углом к поверхности кожи
без формирования кожной складки.

(uk) Рекомендується виконувати ін'єкції під
прямим кутом до поверхні шкіри без
формування шкірної складки.

0,23mm (32G) x 4mm


BD Micro-Fine™

Aghi per penna
Agujas para plumas

Agulhas para canetas
Βελονάκια για πένα



- Migliore flusso di insulina
- Flujo de insulina mejorado
- Fluxo da insulina melhorado
- Βελτιωμένη ροή ινσουλίνης



8mm

100

0,25mm (31G) x 8mm

EC REP

BD Medical - Diabetes Care
Becton Dickinson France S.A.S.
11, rue Aristide Bergès - BP 4
38801 Le Pont de Claix Cedex
France

www.bd.com/diabetes



BD, BD Logo and BD Micro-Fine are trademarks of BD.
All other brands are trademarks of their respective owners.

Made in Ireland

BD Micro-Fine™



- Il riutilizzo può danneggiare la punta dell'ago e indurire lo strato di grasso al di sotto della cute. Ciò può alterare l'assorbimento dell'insulina, rendendo più difficoltoso il controllo glicemico.
- La reutilización puede despuntar la aguja y estar asociada a un endurecimiento del tejido adiposo debajo de la piel. Esto puede modificar la absorción de la insulina dificultando el control glucémico.
- A reutilização pode danificar a agulha e estar relacionada com o endurecimento da gordura debaixo da pele. Isto pode modificar a absorção da insulina, dificultando o controlo da glicose.
- Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να προξενήσει βλάβη στη μύτη της βελόνας και να οδηγήσει σε σχηματισμό λιποδιατροφικών στο δέρμα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην απορρόφηση της ινσουλίνης, δυσκολεύοντας έτσι την ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης στο αίμα.

0,25mm (31G) x 8mm

- ① Non utilizzare se la singola confezione è danneggiata. Consultare le istruzioni per l'uso della penna utilizzata.
- ② No utilice el producto si el envase unitario está deteriorado. Consulte las instrucciones de uso de la pluma.
- ③ Não utilize se a embalagem estiver danificada. Consulte as instruções de utilização do injector da caneta.